

Пирометр CellaCast **PA 8x**

Артикул №: 106 7200 10/2018



Любое копирование, обработка и передача содержания текста, чертежей или изображений, также в образовательных целях, разрешается законом об авторских правах исключительно в заранее согласованных случаях. Это правило распространяется на все формы копирования, в том числе запись и хранение данных на бумаге, плёнке, дисках, а также других носителях.

ВНИМАНИЕ!

Если данная инструкция не содержит других указаний, изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений, обусловленных техническим прогрессом.

© 2010 KELLER HCW GmbH
Carl - Keller - Straße 2 - 10
D - 49479 Ibbenbüren – Laggenbeck
Germany
www.keller.de/its

Содержание

1	Общие положения	2
1.1	Использование инструкции	2
1.2	Значение символов	2
1.3	Ответственность и гарантийные условия	2
1.4	Охрана авторских прав	3
2	Меры безопасности	3
2.1	Использование по назначению	3
2.2	Ответственность пользователя	4
2.3	Правила техники безопасности	4
2.4	Защита от радиопомех, ЭМС	4
2.5	Система обеспечения качества	5
3	Общее описание	5
3.1	Встроенный цифровой дисплей	7
4	Подготовка к работе Краткая инструкция	8
4.1	Схема соединений PA 80 / 83	8
4.2	Схема соединений PA 81	8
4.3	Монтаж оптоволоконного кабеля (PA 81)	9
4.4	Электропитание	9
4.5	Аналоговые выходы 0/4-20 мА	10
4.6	Цифровые (переключаемые) входы и выходы	11
5	Ввод в эксплуатацию	12
5.1	Общие указания	12
5.2	Настройка пирометра после монтажа	12
5.2.1	Конструкция со сквозным видеоискателем (PA 80 / 83)	12
5.2.2	Конструкция с видеокамерой (PA 80 / 83)	13
5.2.3	Фокусировка PA 81	13
5.2.4	Конструкция с лазерным целеуказателем (PA 8x)	14
5.3	Техника безопасности	14
5.3.1	Лазерный луч	14
5.3.2	Мощность лазера	15
5.3.3	Предупреждающая табличка	15
5.4	Настройка пирометра PA 83	16
5.5	Первоначальная регулировка параметров	16
5.6	Настройка коэффициента излучения (Режим спектрального соотношения) ..	18
5.7	Калибровка токовых выходов	19
5.8	Контроль калибровки и передачи температурного значения посредством моделирования тока	19
6	Принцип действия пирометра	20
6.1	Внутренняя обработка сигналов	20
7	Ввод в эксплуатацию Дополнительные функции	21
7.1.1	Контроль затухания сигнала / контроль загрязнения (Режим спектрального соотношения)	21
7.1.2	Сегментированная линеаризация температуры	22
7.1.3	Фильтр для усреднения сигнала	22
8	Функция АРТ «Автоматическая Регистрация Температуры»	23
8.1	Измерение струи жидкого металла	23
8.1.1	Глобальная настройка прибора	26
8.1.2	Исходные параметры пирометра PA 83	26
8.1.3	Настраиваемые параметры в зависимости от материала	27
8.2	Дополнительная конфигурация функции АРТ	28
8.2.1	Конфигурация предельных значений цифровых выходов	28
8.3	Измерение в желобе или в плавильной печи	29
8.4	Конфигурация аналогового входа для внешней настройки соотношения коэффициентов излучения ϵ_1/ϵ_2	30
9	Конфигурация I/O (входов / выходов)	31
9.1	Калибровка аналоговых выходов	31

9.2	Переключаемые выходы	32
9.2.1	Логическая функция включения „Level“	34
9.2.2	Логическая функция включения „Range“	35
9.3	Переключаемые входы	36
9.4	Аналоговый вход для регулирования коэффициента излучения (Режим спектрального соотношения)	36
9.5	Общие функции (Кодовая страница с 0 1 1)	37
9.5.1	Функция зелёного светодиода	37
9.5.2	Включение лазерного целеуказателя	37
9.5.3	Регулировочные функции для камеры	38
9.5.4	Включение интерфейса	38
9.6	Моделирование выходных сигналов и температуры Ao1 и Ao2 (Кодовая страница с 1 0 0)	39
10	Настройка параметров в приборе	40
10.1	Описание кодовых страниц	40
10.1.1	Регистрация результатов измерений Канал соотношения коэффициентов излучения (Кодовая страница: с 0 0 1)	40
10.1.2	Регистрация результатов измерений Спектральные каналы 1 и 2 (Кодовые страницы: с 0 0 2 и с 0 0 3)	42
10.1.3	Конфигурация I/O «входы / выходы» (Кодовая страница: с 0 1 0)	44
10.1.4	Общие функции (Кодовая страница: с 0 1 1)	47
10.1.5	Индикация внутренних измеренных значений (Кодовая страница: с 0 2 0)	48
10.1.6	Моделирование выходных сигналов Ao1 и Ao2 (Кодовая страница: с 1 0 0)	49
11	Программное обеспечение CellaView	49
12	Установка параметров через терминал (последовательный интерфейс)	50
12.1	Основное меню Обзор	51
12.2	Параметры / Обзор диагностики	51
12.3	Описание подчинённых меню («Подменю»)	52
12.3.1	Регистрация результатов измерений Канал соотношения коэффициентов излучения [Q]	52
12.3.2	Регистрация результатов измерений Спектральный канал 1	52
12.3.3	Регистрация результатов измерений Спектральный канал 2	53
12.3.4	Быстрое переключение Коэффициент излучения / Фильтр / Калибровка Ao 153	53
12.3.5	Конфигурация I/O	53
12.3.6	Автоматическая выдача измерительных значений:	55
12.3.7	Дополнительная калибровка в лаборатории	55
13	Экранирование и заземление	57
13.1	Выравнивание потенциала	57
14	Примеры контактных выводов	59
14.1	Соединение с помощью кабеля Тип VK 02/A	59
15	Принцип бесконтактного измерения температуры	60
15.1	Преимущества бесконтактного измерения температуры	60
15.2	Измерения температуры абсолютно чёрного тела	60
15.3	Измерения температуры реально существующих объектов	61
16	Коммуникационные интерфейсы	62
16.1	Последовательный интерфейс USB 2.0	62
16.2	Виртуальный порт COM	63
16.3	Серийный интерфейс RS 485	64
16.4	Последовательная передача измеренных значений	65
16.5	Последовательный интерфейс RS 485	66
17	Уход и техническое обслуживание	67
17.1	Чистка линзы объектива	67
18	Технические характеристики PA 80 AF 6	68
18.1	Диаграмма поля зрения PA 80 AF 6	69
19	Технические характеристики PA 81 AF 11	70
19.1	Диаграмма поля зрения PA 81 AF 11	71

20	Общие технические характеристики PA 83.....	72
20.1	Диаграмма поля зрения PA 83 (750 – 2400 °C)	73
21	Габариты	77
21.1	Пирометр PA 80 / 83.....	77
21.2	Пирометр PA 81.....	77
21.4	Измерительная головка PA 41.01 (M 30).....	78
22	Технические характеристики видеокамеры.....	79
23	Дополнительное оборудование	81
23.1	Регулируемый монтажный уголок PA 11 / K	81
23.2	Крепёжный кронштейн PA 11 / U	82
23.4	Прозрачная насадка с кварцевым стеклом PA 20 / I.....	83
23.5	Кабель VK 02 / A.....	84
23.6	Видеокабель VK 02 / F	85
24	Монтажные комплекты	86
24.1	Монтажный комплект PA 83-002	86
24.2	Монтажный комплект PA 83-003	87
25	Глоссарий.....	88
26	Транспортировка, упаковка и утилизация.....	89
26.1	Доставка / Осмотр	89
26.2	Упаковка	89
26.3	Утилизация старых приборов.....	89
27	Информация о лицензиях	90
28	Стандартная конфигурация PA 83	91
28.1	Регистрация результатов измерений Канал соотношения коэффициентов излучения [Q] (Кодовая страница: с 00 I).....	91
28.2	Регистрация результатов измерений Спектральный канал 1 и 2 (Кодовая страница: с 002 и с 003)	92
28.3	Конфигурация I/O ввод / вывод (Кодовая страница: с 0 IO).....	93
28.4	Общие функции (Кодовая страница: с 0 I I)	95
29	Стандартная конфигурация PA 80 / 81	96
29.1	Регистрация результатов измерений Канал соотношения коэффициентов излучения [Q] (Кодовая страница: с 00 I).....	96
29.2	Регистрация результатов измерений Спектральный канал 1 и 2 (Кодовая страница: с 002 и с 003)	97
29.3	Конфигурация I/O ввод / вывод (Кодовая страница: с 0 IO).....	98
29.4	Общие функции (Кодовая страница: с 0 I I)	100

1 Общие положения

1.1 Использование инструкции

Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для правильной установки пирометра и необходимых для измерения принадлежностей.

Перед подготовкой прибора к работе необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, уделив особое внимание разделу безопасности обслуживания! Следует строго соблюдать указания инструкции по эксплуатации, особенно необходимые для данной области применения предписания по обеспечению безопасности и предупреждению несчастных случаев!

1.2 Значение символов

Важные указания в данной инструкции по эксплуатации обозначены следующими символами:



ВНИМАНИЕ!

Этот символ обозначает указания, несоблюдение которых может привести к повреждению, отказу или выходу прибора из строя.



УКАЗАНИЕ!

Этот символ содержит информацию и советы, которые необходимо соблюдать для эффективного и безотказного обслуживания прибора.

1.3 Ответственность и гарантийные условия

Вся информация, содержащаяся в инструкции по эксплуатации, составлена в соответствии с действующими предписаниями, с учётом новейшего уровня техники, а также на основе многолетнего опыта и знаний.



УКАЗАНИЕ!

Перед началом обслуживания прибора, особенно перед вводом прибора в эксплуатацию, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации! Изготовитель не несёт ответственности за те повреждения, которые возникли в результате её несоблюдения.

Инструкция по эксплуатации должна быть доступна всем лицам, которые обслуживают прибор.

1.4 Охрана авторских прав

Обращение с инструкцией по эксплуатации должно носить строго конфиденциальный характер. Данная инструкция предназначена только для лиц, обслуживающих пирометр. Передача инструкции по эксплуатации третьим лицам без письменного разрешения изготовителя недопустима. В случае необходимости следует обратиться к изготовителю.



УКАЗАНИЕ!

Содержание, тексты, чертежи, фотографии, а также другие изображения защищены авторским правом. Нарушение авторских прав преследуется законом.

Любое копирование, обработка или передача содержания без письменного разрешения изготовителя запрещены. Нарушители несут ответственность за причинённый ущерб. Изготовитель сохраняет за собой право на предъявление прочих претензий.

2 Меры безопасности

В этом разделе отражены все важнейшие аспекты для оптимальной защиты персонала, а также для безопасной и бесперебойной работы прибора.

2.1 Использование по назначению

Пирометр предназначен исключительно для описанных в инструкции по эксплуатации целей. Надёжность эксплуатации обеспечивается лишь в случае применения прибора по назначению.



ВНИМАНИЕ!

Любое использование прибора не по назначению и/или в других целях запрещено и считается применением не по назначению.

Производитель несет ответственность только за повреждения, возникшие при использовании по назначению. При этом любая ответственность налагается при условии, что причиной ущерба является дефектный продукт, и что дефект продукта возник по вине производителя

2.2 Ответственность пользователя

Прибор следует эксплуатировать только в безупречном и безопасном состоянии.

2.3 Правила техники безопасности

Данный прибор рассчитан на низкое напряжение +24 В. Напряжение, необходимое для работы, должно поступать от отдельного источника питания. Блок питания должен соответствовать нормам DIN IEC 61010.

2.4 Защита от радиопомех, ЭМС

Приборы соответствуют требованиям директив ЕС 89/336/ЕЭС с поправками, содержащимися в 91/263/ЕС, 92/31/ЕС, 93/68/ЕС, касающимися электромагнитной совместимости (Закон ЭМС).

Европейские Нормы:



EN 61000 - 6 - 4
EN 61000 - 6 - 2
EN 55011

При подключении к источнику питания необходимо обеспечить соответствие блока питания вышеуказанным нормативам. При смежном подключении вместе с другими периферийными устройствами, не защищёнными от помех, могут возникнуть радиопомехи, что в каждом отдельном случае потребует принятия мер по дополнительному подавлению помех.

2.5 Система обеспечения качества

Система обеспечения качества компании «Келлер ХЦВ ГМБХ» отвечает требованиям DIN EN ISO 9001:2009 и DIN EN ISO 14001/50001 по конструкции, изготовлению и сервису бесконтактных инфракрасных приборов для измерения температуры.



3 Общее описание

Серия пирометров PA 8x разработаны специально для измерения температуры жидкого металла. Интегрированная в приборе функция АРТ обнаруживает в автоматическом режиме начало нового литейного процесса и запускает процесс измерения. После завершения измерения на дисплея отображается температурное значение а на выходы и на интерфейс выдаётся измеренное значение для дальнейшей обработки. Помехи, возникающие при выполнении измерений, из-за образования пламени или каплюющей струи жидкого металла, подавляются благодаря наличию функции АРТ. При циклических процессах измеренное значение рассчитывается и отображается для каждой разливке металла. При выполнении непрерывных измерений на разливочном желобе или при продолжительных процессах литья регистрация измеренных значений температуры и их запоминание выполняются периодически.

Пирометр CellaCast PA 8x измеряет температуру объекта по величине соотношения сигналов от двух датчиков, работающих на разных длинах волн. Даже при появлении в поле зрения пирометра таких помех, как пыль и дым, вплоть до 95 %-го ослабления сигнала, двухспектральный способ измерения позволяет получать точные значения температуры.

Для маркировки измеряемого пятна пирометры на выбор могут быть оснащены сквозным видеоискателем, встроенной цветной видеокамерой или лазерным целеуказателем.

Чрезвычайно прочный корпус из высококачественной и нержавеющей стали позволяет использовать приборы в крайне сложных промышленных условиях. Брызгозащищенность пирометров соответствует требованиям IP65 (DIN 40050).

Все пирометры имеют два аналоговых выхода, переключаемых между 0...20 мА или 4...20 мА. Ток на выходе линейно пропорционален измеряемой температуре. Желаемый диапазон измерений можно произвольно регулировать.

Для обеспечения безопасности прибора при температуре окружающей среды, превышающей допустимый предел, значение тока на выходе автоматически переключается на >20,5 мА.

Кроме того, у пирометров существует аналоговый потенциальный вход, который можно альтернативно использовать вместо аналогового выхода 2. Через данный вход возможны как корректирующее регулирование коэффициента излучения, так и компенсация фонового излучения.

С помощью двух последовательных интерфейсов USB и RS485 во время эксплуатации прибора возможно изменение всех рабочих параметров, таких как, например, коэффициент излучения, диапазон измерений, функция сглаживания или калибровка выходного тока.

Кроме того, можно включить непрерывную выдачу температурных значений, а также отрегулировать время каждого цикла.

Все пирометры серии PA 8x оснащены фокусируемой сменной оптикой, лазерным целеуказателем или встроенной цветной видеокамерой. Приборы со сквозным видеоискателем и маркировкой измерительного пятна быстро и очень просто наводятся на объект измерения. Приборы с лазерным целеуказателем также без проблем наводятся на объект измерения с помощью лазерной точки. Пирометры со встроенной цветной видеокамерой передают стандартный видеосигнал PAL на подключаемый монитор, благодаря чему можно легко проверить фокусировку и правильную


наводку прибора на цель без необходимости смотреть сквозь прибор.

3.1 Встроенный цифровой дисплей

Элементы управления и дисплей


На обратной стороне приборов CellaCast PA расположены 4-значный дисплей и 3 клавиши. При выполнении измерений на дисплее появляется актуальное температурное значение, а при конфигурировании на приборе посредством клавиш - соответствующий параметр.

При появлении на дисплее настраиваемых параметров светодиод F1 высвечивается жёлтым цветом. Функция светодиода F2 (зелёного цвета) является параметрируемой. При поставке она показывает статус готовности (Ready) выхода Do1 (см. раздел 10.1.4).

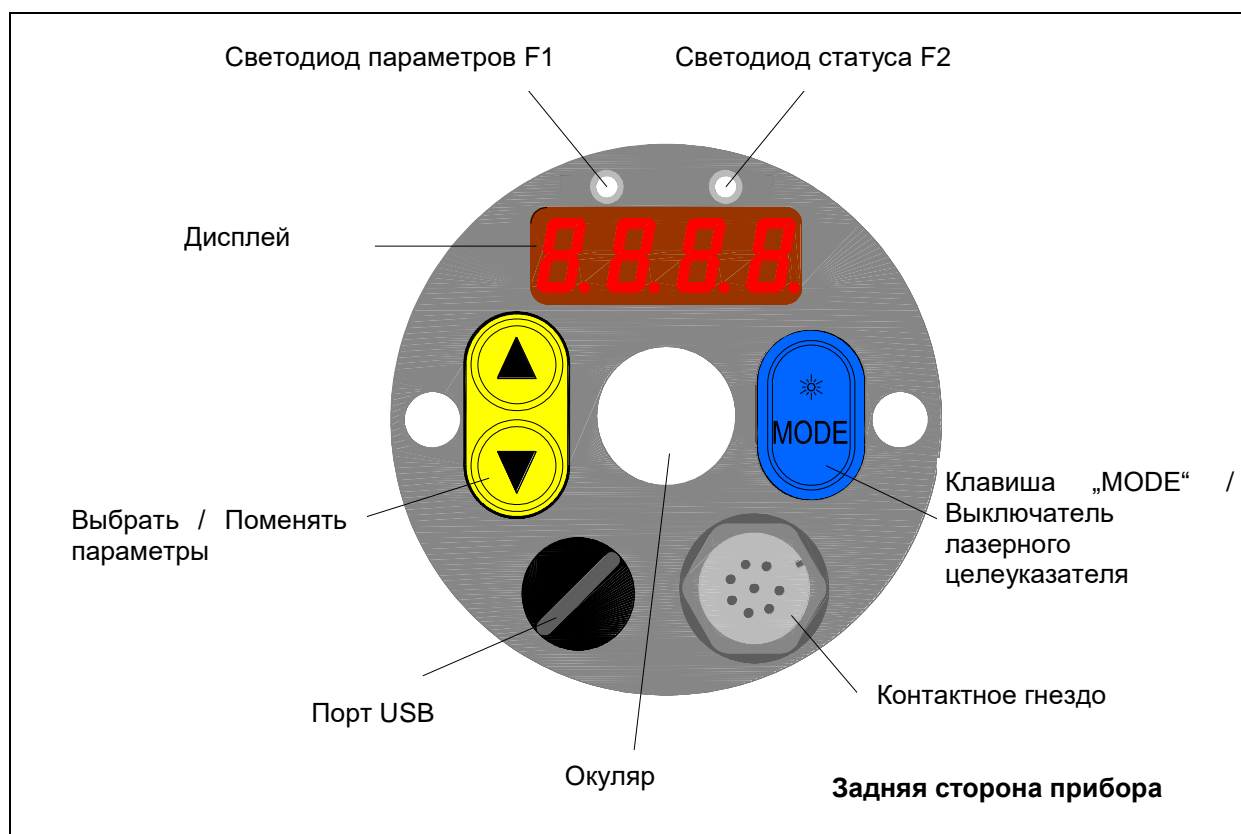


4 Подготовка к работе Краткая инструкция

4.1 Схема соединений PA 80 / 83

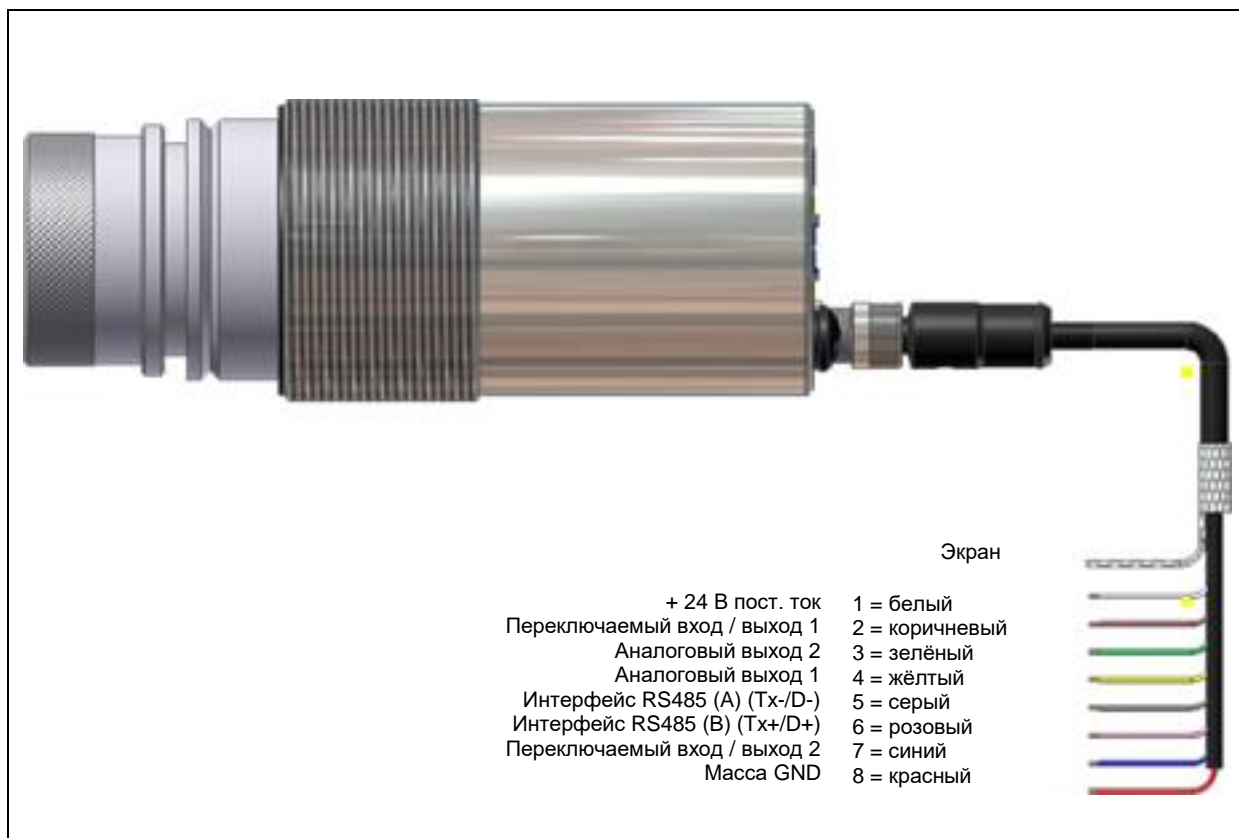

4.2 Схема соединений PA 81

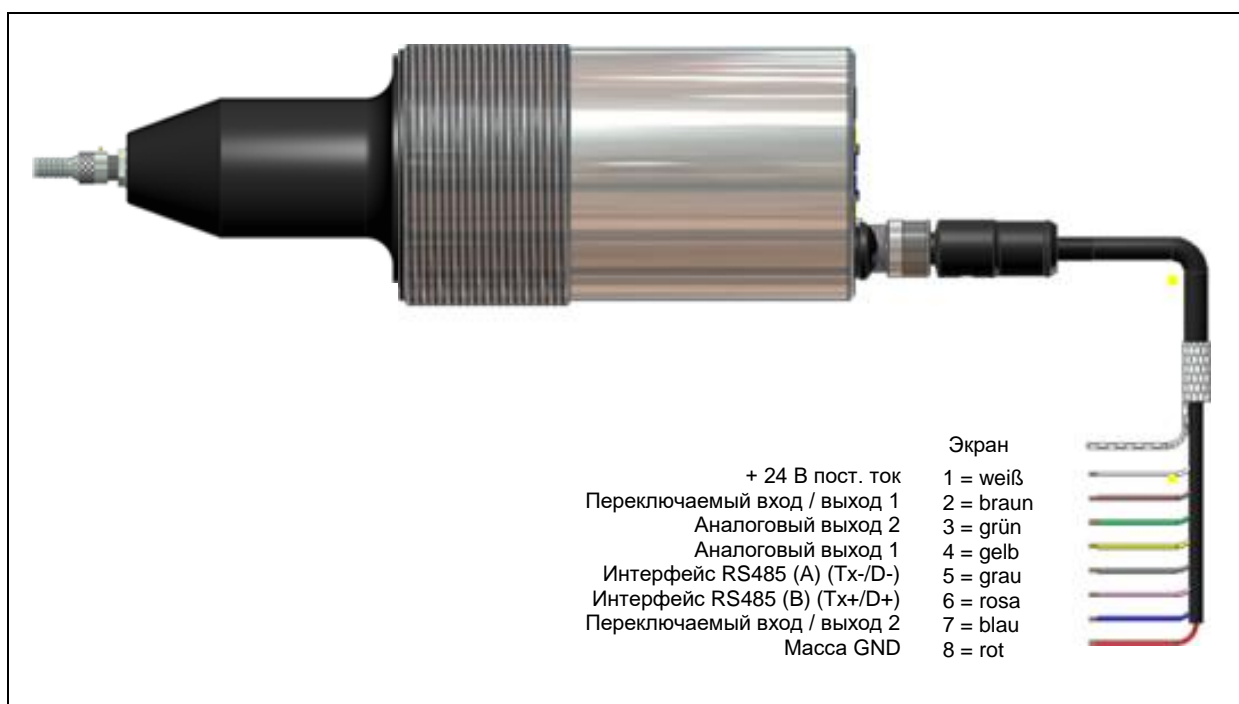

**ВНИМАНИЕ!**

Примечание:

Корпус пирометра соединён через конденсатор 0,1µФ/50В с экраном.

Неиспользуемые жилы должны быть изолированы во избежание искажения показаний на дисплее.

4.3 Монтаж оптоволоконного кабеля (РА 81)

Оптоволоконный кабель на одном конце имеет типовую табличку с серийным номером соответствующего базисного прибора. Следует прикрутить этот конец к базисному прибору. Для правильной стыковки кабелей стрелки на указательных табличках оптоволоконного кабеля и базисного прибора должны указывать друг на друга.

На измерительной головке также указан серийный номер, который должен соответствовать базисному прибору.

Указание!

Оптоволоконный кабель нельзя растягивать и изгибать. Минимальный радиус изгиба составляет при толщине оптоволоконна 200 мкм 15,2 мм а при 400 мкм 36,5 мм.

Минимальная высота установки прибора, включая кабель, составляет: измерительная головка 72 мм + защита от изгиба 52 мм + радиус изгиба кабеля 60 мм (итого - 184 мм).

4.4 Электропитание

Приборы CellaCast PA рассчитаны на источник питания постоянного тока +24 В. Необходимое для эксплуатации напряжение должно поступать от отдельного блока питания, соответствующего нормам DIN IEC 61010.

Потребление тока составляет ≤ 135 мА (≤ 150 мА с лазерным целеуказателем или 175 мА со встроенной цветной видеокамерой). Пирометр оснащён защитой против инверсии полярности. Напряжение и ток на аналоговых выходах подключены к общему

заземлению, находящемуся на 8 контактом штифте соединительного штекера.

После включения выполняется самотестирование. На дисплее появляется версия программного обеспечения, а затем отрегулированный коэффициент излучения. После проверки пирометр готов к эксплуатации и на дисплее появляется фактическое измеренное значение.



УКАЗАНИЕ!


Время установления термостабильного состояния пирометра составляет около 10 минут (с камерой 20 минут). В установленном состоянии пирометр выдаёт самые точные результаты измерений.

Рекомендуется защитить питающий кабель пирометра слаботочным предохранителем, рассчитанным на 250 мА.

4.5 Аналоговые выходы 0/4-20 мА

Прибор CellaCast PA имеет два аналоговых выхода. Оба выхода являются активными источниками линейного выходного тока. Их можно отрегулировать в диапазоне 4...20 мА или 0...20 мА. Максимально возможная вторичная нагрузка: 500 Ω.

При поставке аналоговые выходы настроены на 4...20 мА

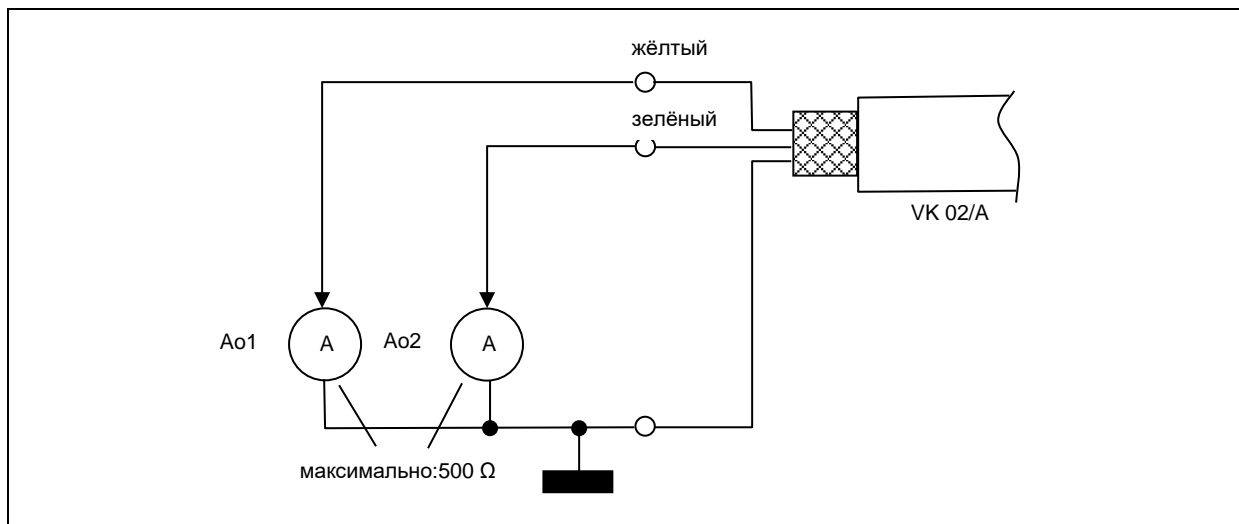

Токовые выходы устойчивы к короткому замыканию и подключены к общему заземлению (штифт 8).


Оба выхода можно изменять по-отдельности и регулировать с помощью дисплея или интерфейса.

При использовании только одного выхода следует использовать токовый выход 1 (штифт 4).

4.6 Цифровые (переключаемые) входы и выходы

Пирометры серии CellaCast PA имеют 2 переключаемых выхода, которые можно альтернативно использовать в качестве входа.

Выходы представляют собой "открытый коллектор" и рассчитаны на +24 В. Для обработки сигнала можно заложить резистор, "утягивающий вниз", так называемый „Pull Down“, в соответствии с заземлением (GND) напряжения питания. Максимальный ток каждого аналогового выхода составляет 30 мА.

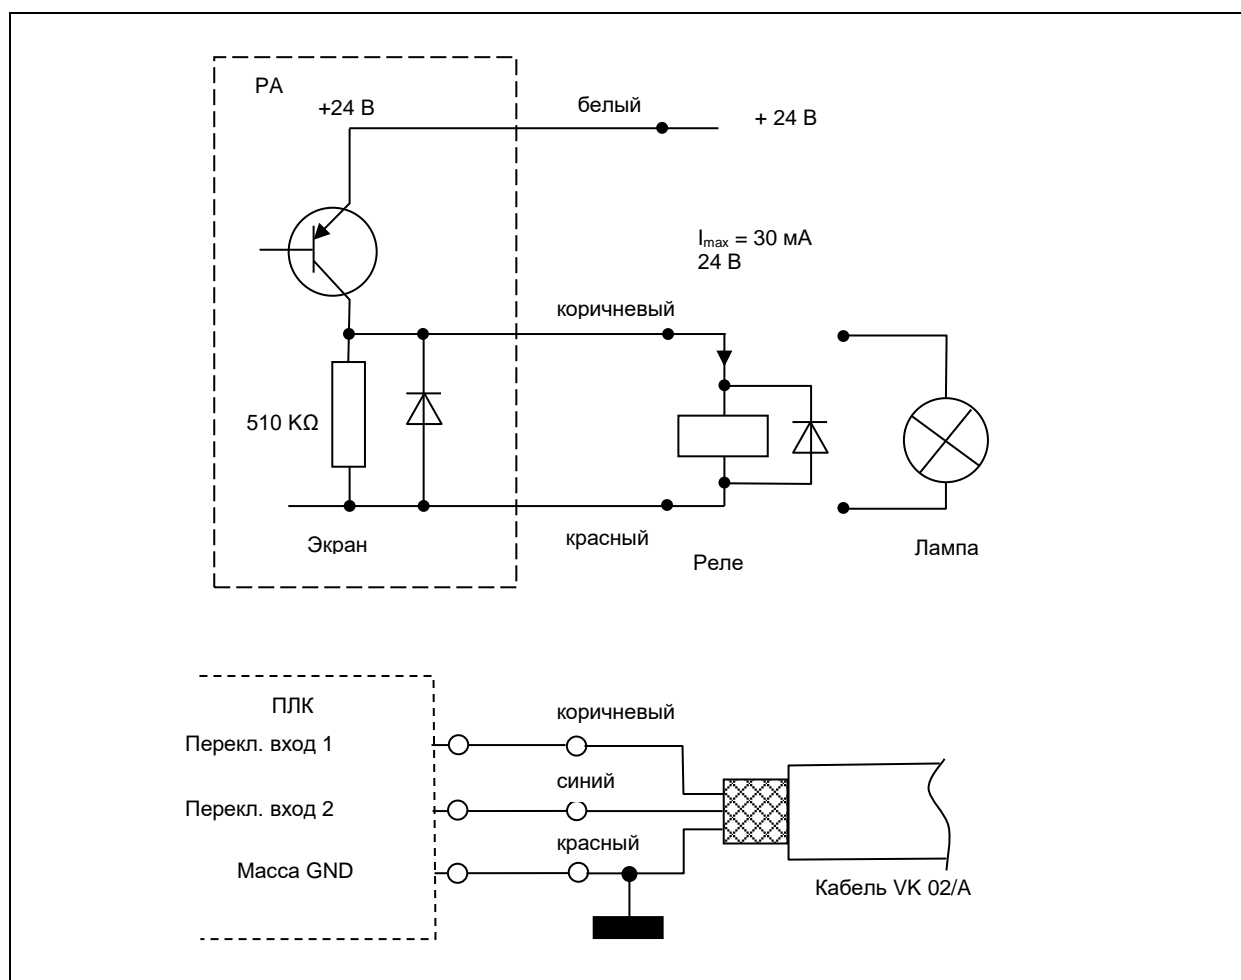

Дальнейшая конфигурация переключаемых выходов описана в разделе 9.2

5 Ввод в эксплуатацию

5.1 Общие указания

Пирометр необходимо устанавливать в местах, не подверженных влиянию пыли, дыма, водяного пара или слишком высоких температур.

При эксплуатации прибора в спектральном режиме загрязнение линзы отрицательно влияет на показания результатов измерений, поэтому следует следить за тем, чтобы линза была чистой.

На траектории прохождения лучей пирометра не должно быть препятствий. Наличие разного рода помех является источником погрешностей измерений.

5.2 Настройка пирометра после монтажа

Для получения точных результатов измерений важно, чтобы пирометр был наведён и сфокусирован точно на предмет измерений. Кроме того, следует следить за тем, чтобы ход лучей от объекта к пирометру не был затруднён, так как в этом случае нарушается точность измерений.

5.2.1 Конструкция со сквозным видоискателем (PA 80 / 83)

При настройке пирометра со сквозным видоискателем необходимо отрегулировать объектив таким образом, чтобы объект измерений и круглая маркировка измерительного пятна были одновременно отчётливо видны. Замаркированное измерительное пятно в поле зрения видоискателя должно быть полностью заполнено объектом измерения.

Поляризационный фильтр для защиты глаз поставляется вместе с комплектом принадлежностей и ввинчивается в окуляр. Бесступенчатая регулировка яркости достигается посредством поворота фильтра.

Если измерительное пятно равно или незначительно больше определённого показателем визирования минимального размера измерительного пятна, рекомендуется проверить фокусировку, используя максимальное значение выходного тока.

5.2.2 Конструкция с видеокамерой (РА 80 / 83)

Пирометры типа РА xx AF xx /C оснащены интегрированной цветной видеокамерой.

Видеоизображение облегчает оптическую настройку пирометра и позволяет в течение длительного времени наблюдать за объектом измерения.

Для выполнения измерений следует сфокусировать прибор таким образом, чтобы видеоизображение было **отчётливым**. (Технические данные см. главу 7922)

5.2.3 Фокусировка РА 81

Пирометр РА 81 оснащён лазерным устройством, который необходимо включить для его настройки. Для этого следует нажать и держать примерно 2 сек. синюю клавишу „MODE“ на задней стороне прибора.

Для фокусировки установочный винт на измерительной головке (внутр. шестигранник DIN 916) отвинчивается торцовым ключом (DIN 911), а внутренний тубус по отношению к внешней трубке объектива необходимо сдвинуть. Из-за изоляции измерительной головки фокусировку следует выполнять медленно, для того, чтобы между линзой и внутренним тубусом происходила компенсация давления воздуха.

Измерительная головка тогда правильно сфокусированна, когда точку лазерного целеуказателя чётко видно на объекте измерения.



5.2.4 Конструкция с лазерным целеуказателем (PA 8x)

Пирометры PA xx AF xx L оснащены лазерным устройством, которое можно дополнительно включить для наводки прибора на объект измерения.

Для включения целеуказателя необходимо нажать и держать в течение прим. 2 сек. синюю кнопку «MODE» на обратной стороне прибора.

Для выполнения измерений пирометр необходимо навести на цель и сфокусировать таким образом, чтобы на данной дистанции было отчётливо видно яркое пятно круглой формы.



УКАЗАНИЕ!

У пирометров с лазерным целеуказателем включение лазера может повлиять на качество измерения температуры. Степень влияния зависит от типа прибора и измеряемой температуры. Во избежание погрешностей измерения целеуказатель через 2 минуты автоматически отключается.

Альтернативно можно вновь нажать и держать синюю кнопку «MODE» в течении прим. 2 сек. Для выключения лазера.

Для предотвращения перегрузки лазера в случае перегрева в пирометр встроена схема защиты. При внутренней температуре прибора выше 55 °С лазер принципиально отключен. Для контроля включения мигает светодиод F1.

5.3 Техника безопасности

5.3.1 Лазерный луч

Опасность повреждения глаз!

Пирометры CellaCast PA эксплуатируются с красным лазером класса 2. Если смотреть на лазерный луч в течение длительного времени, можно повредить сетчатку глаз. Поэтому необходимо обязательное соблюдение нижеследующих условий:

- Включать лазерный целеуказатель только для наводки пирометра на цель, а затем его снова отключать.
- Нельзя смотреть прямо на луч.
- Не оставлять прибор без присмотра, если лазер включён.

- Не направлять лазерный луч на людей.
- При монтаже и наводке пирометра избегать отражения лазерных лучей от зеркальных поверхностей.
- Соблюдать действующие нормативы новейшего издания по защите от лазерного излучения.

Во всех остальных случаях включение лазера запрещено!

5.3.2 Мощность лазера

Длина волны лазера составляет 630-680 нм (видимый красный цвет). Исходная мощность лазерного луча на объективе составляет макс. 1,0 мВт. Для кожи человека исходящее излучение безопасно.

Продукт классифицирован по классу 2 и соответствует EN60825-1, IEC60825-1.

5.3.3 Предупреждающая табличка

Предупреждающая об опасности лазера табличка чёрно-жёлтого цвета расположена рядом с заводской табличкой. Стрелка на предупреждающей табличке показывает направление выхода лазерного луча.



Изображение 1: Табличка, предупреждающая об опасности лазерного луча



УКАЗАНИЕ!


Если после монтажа пирометра на оборудовании предупреждающей таблички не видно, необходимо рядом с отверстием, из которого выходит лазерный луч, поместить другую предупреждающую табличку (не входящую в объём поставок).

При обычной эксплуатации пирометра лазерный целеуказатель отключён. Его включение возможно посредством нажатия кнопки на

задней панели. Через 2 минуты лазер автоматически отключается. Все лица, работающие с пирометром, должны соблюдать вышеуказанные предписания по технике безопасности.

5.4 Настройка пирометра PA 83

Пирометр должен быть выравнен таким образом, чтобы струя металла находилась в центре поля зрения. Ширина струи жидкого металла должна занимать не менее 30 % поля зрения.

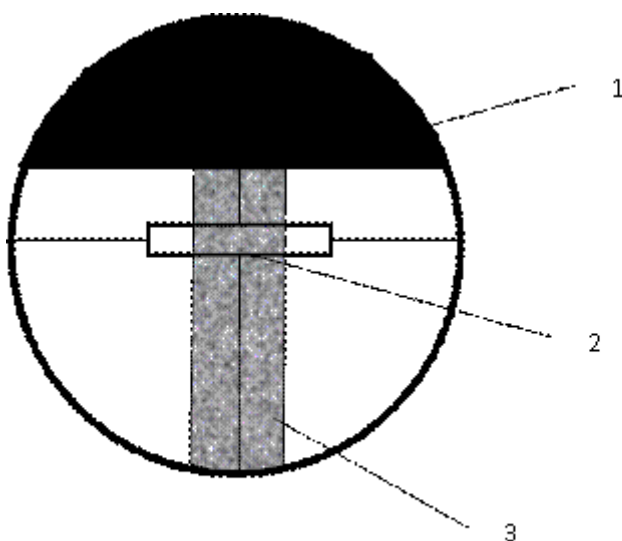


- 1) Разгрузное отверстие печи
- 2) Маркировка поля измерения
- 3) Струя жидкого металла

5.5 Первоначальная регулировка параметров

Выборка параметров выполняется на пирометре с помощью кнопок ▲▼ (выбрать параметры) и «MODE». С помощью этих кнопок можно контролировать и регулировать все необходимые для эксплуатации прибора параметры (см. раздел 3.1).

Последовательность действий:

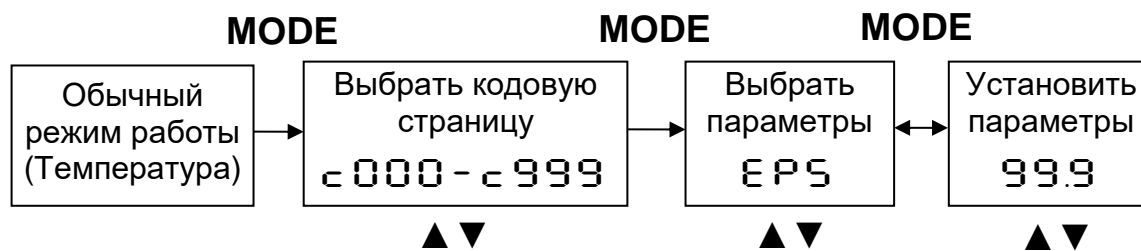

1. В обычном режиме работы нажать синюю кнопку «MODE»-выход на кодовую страницу („Codeseite“).
1. Выбрать кодовую страницу с необходимыми параметрами нажатием на жёлтые кнопки со стрелками ▲▼.
2. Подтвердить кнопкой «MODE» и выбрать желаемые параметры кнопками ▲▼
3. Подтвердить кнопкой «MODE» и установить желаемые параметры нажатием на кнопки ▲▼
4. После окончания регулировки нажать ещё раз «MODE» и нажатием ▲▼ вызвать [ESC / SAVE]
5. Запись в память [SAVE] или отмену [ESC] подтвердить нажатием кнопки „MODE“. На дисплее вновь появляются обычные показания температуры.

При первоначальном вводе прибора в эксплуатацию необходимо проверить и отрегулировать нижеследующие параметры. Полный обзор всех настраиваемых параметров представлен на диаграммах и в таблицах разделов 7 и 0.

Параметр	Кодовая страница	Название параметра	Примечание
Соотношение коэффициентов излучения	с 00 1	EPS.9	Соотношение сигналов $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \text{Quotient [Q]}$
Ао1 Калибровка Исходное значение	с 0 10	Ао 1..	Исходное значение температуры Ао1
Ао1 Калибровка Окончательное значение	с 0 10	Ао 1.~	Окончательное значение температуры Ао1
Ао1 Acal. 0/4..20mA	с 0 10	Ао 1.4	Переключение 0/4 – 20 мА
Ао1.	с 100	Ао 1t	Моделирование температуры для проверки переноса измеренных значений в систему управления



Примечание:

Через терминал компьютера возможна блокировка кнопок прибора. В данном случае для выбора кодовой страницы посредством P000 запрашивается код доступа. Для полного доступа к параметрам следует задать P 100. В противном случае параметры появляются на дисплее, но их нельзя изменить.

5.6 Настройка коэффициента излучения (Режим спектрального соотношения)

Посредством изменения соотношения коэффициентов излучения разница между измеренным уровнем температуры и истинной (фактической) температурой могут быть компенсированы. Эта регулировка должна выполняться при возникновении селективной интерференции или в результате влияния материала на различие коэффициентов излучения для значений лямбда 1 и лямбда 2. Соотношение коэффициентов нужно установить с помощью погружного зонда!



УКАЗАНИЕ!

При обычном режиме работы коррекция коэффициента излучения возможна непосредственно с помощью кнопок ▲▼. При одновременном нажатии кнопки «ENTER» можно задавать температурное значение для автоматического расчёта коэффициента излучения, которое осуществляется на заднем плане. Таким образом можно уточнить коэффициент излучения если известна температура объекта! Изменённые значения сразу принимаются.



ВНИМАНИЕ!

После коррекции коэффициента излучения пирометр будет работать с новыми значениями постоянно!

5.7 Калибровка токовых выходов

При использовании аналоговых / токовых выходов у пирометра необходимо «подогнать» калибровку, т.е. привести её в соответствие с результатами обработки данных (ПЛК, внешний индикатор, регулятор). С этой целью на пирометре и в системе управления выполняется идентичная настройка диапазона температур (начало и конец) и диапазонов тока (0...20 или 4...20 мА).

Доступ для выполнения регулировок выполняется через кодовую страницу с **0 10**.

5.8 Контроль калибровки и передачи температурного значения посредством моделирования тока

Сразу после пуска в эксплуатацию необходимо проверить правильность переноса измеренных значений в систему управления. Для этого на пирометре с помощью кнопок возможна имитация температуры, измеренное значение которой впоследствии, в зависимости от установленной калибровки, будет заложено в качестве выходного тока. Соответствующий параметр можно найти на кодовой странице с **100**.


При правильной установке все введённые здесь значения должны появиться в подключённой системе управления (только в пределах зоны калибровки).

В случае появления отклонений (ошибочных значений) следует проверить калибровку и кабельное соединение.

После проверки, для перехода в обычный режим измерения, необходимо выйти из кодовой страницы посредством нажатия "**ESC**".

6 Принцип действия пирометра

6.1 Внутренняя обработка сигналов

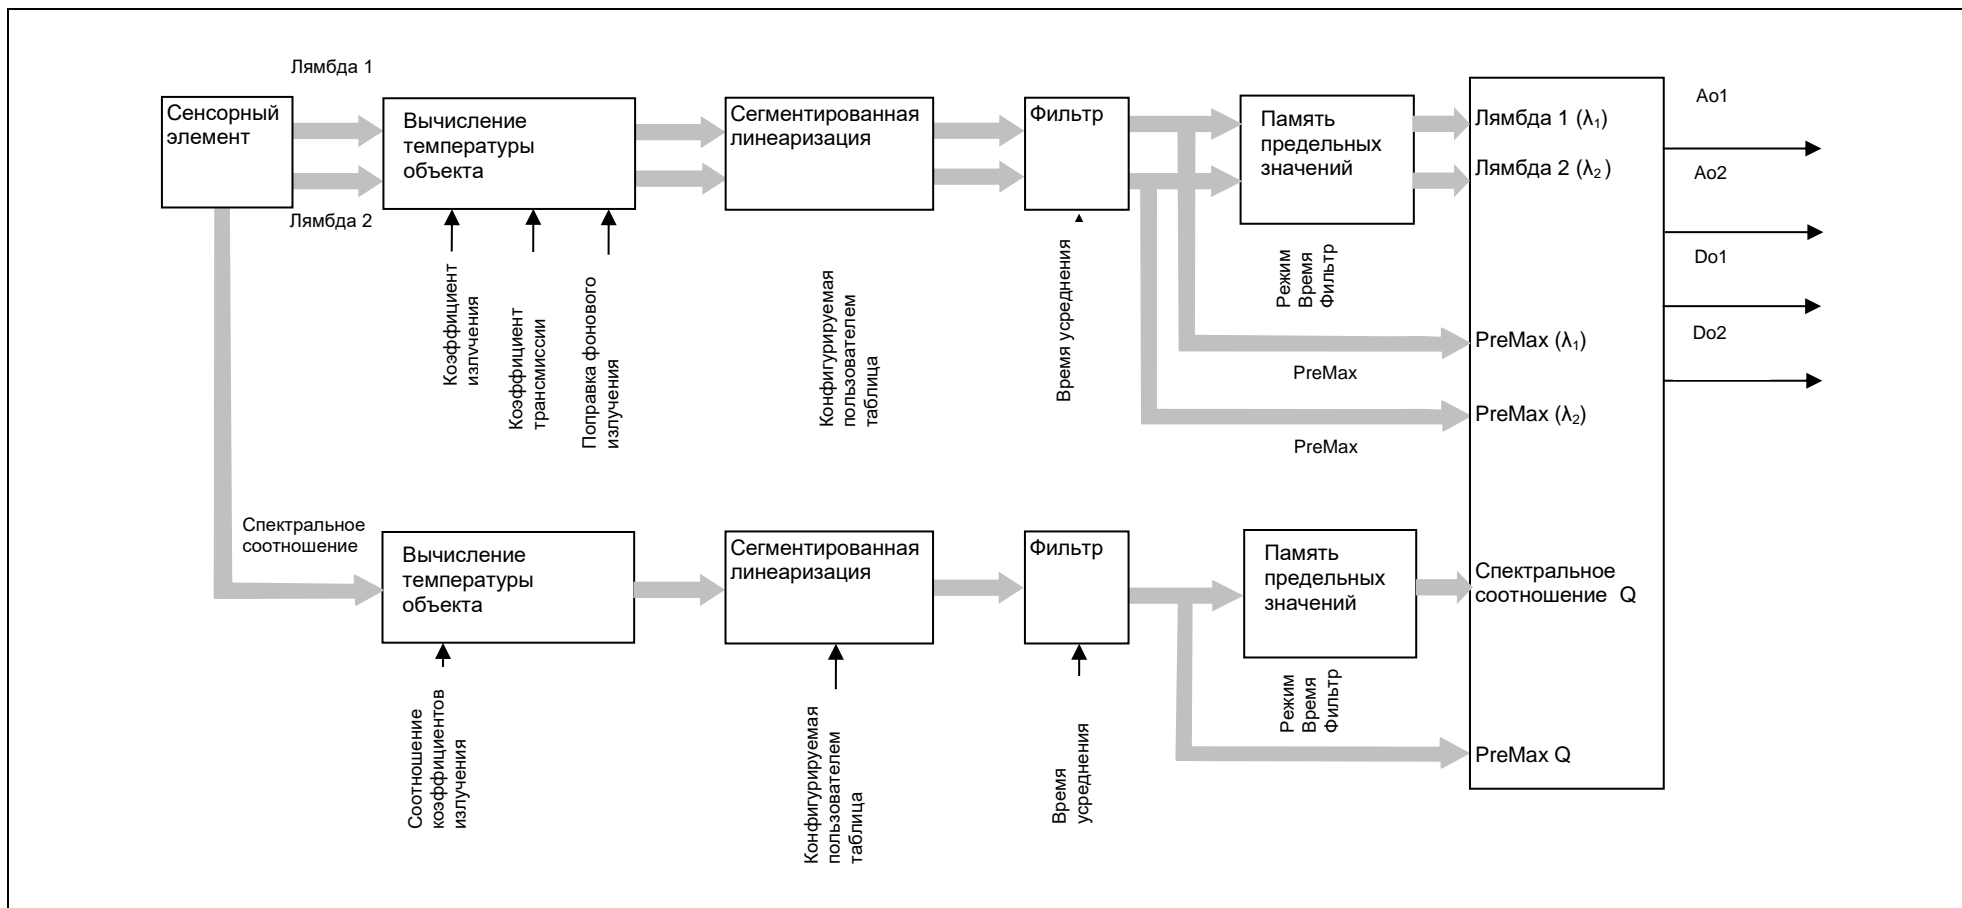

7 Ввод в эксплуатацию Дополнительные функции

7.1.1 Контроль затухания сигнала / контроль загрязнения (Режим спектрального соотношения)


Для обеспечения надежных и точных результатов измерений при загрязнении линзы, прикрученного защитного стекла или промежуточной трубки пирометры PA 8x имеют функцию контроля загрязнения (Dirt Alert), активирование которой осуществляется с помощью параметра dirt .

Мониторинг загрязнения является предупреждающей функцией, которая срабатывает в том случае, если отрегулированное пороговое значение не достигнуто, что часто происходит в момент обнаружения пирометром объекта измерения при выполнении измерений во время протекания циклических процессов.



УКАЗАНИЕ!


Параметр Dirt Alert должен быть отрегулирован на интенсивность сигнала $\times 0,5$.

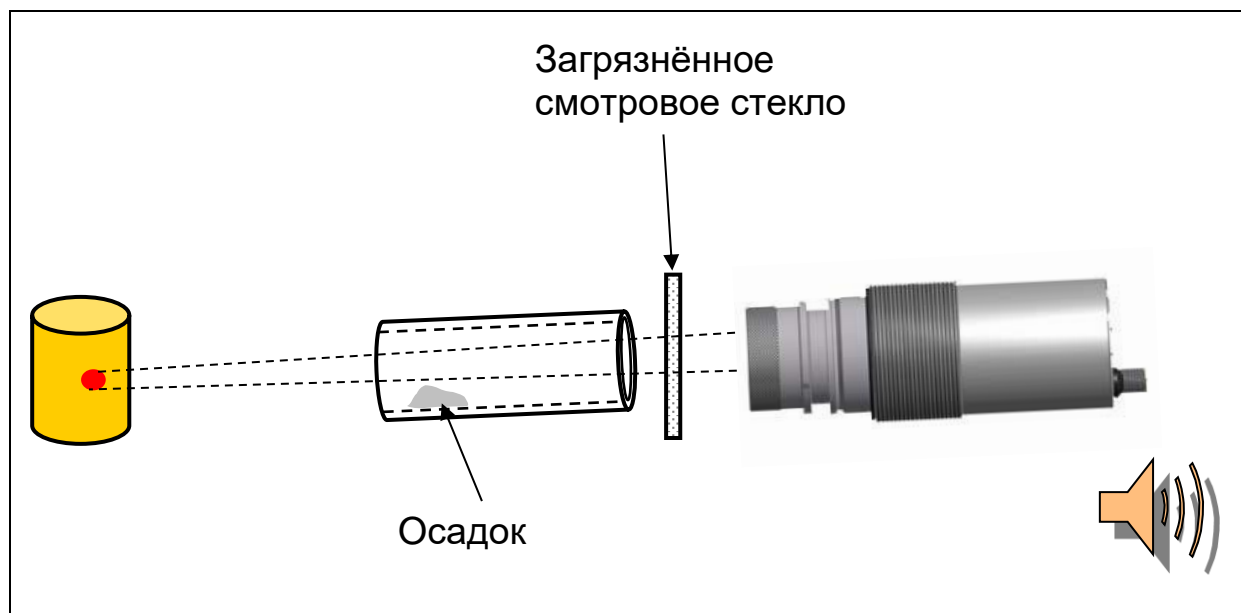

7.1.2 Сегментированная линейаризация температуры

При необходимости существует возможность последовательной линейаризации измеренной температуры по произвольно составленной таблице. С этой целью возможен ввод от 2 до 10 точек отсчёта (X/Y- пары), которые затем интерполируются в систему обработки измерительных значений (см. изображение) по линейной прямой. Для значений меньше первой точки отсчёта или больше последней точки отсчёта первый и последний сегмент экстраполируются по линейной прямой. Все точки отсчёта необходимо задавать по возрастающей прогрессии.

На дисплее допуск к линейаризации возможен посредством $\ll 00 \mid$ / $\ll \text{in. l.}$

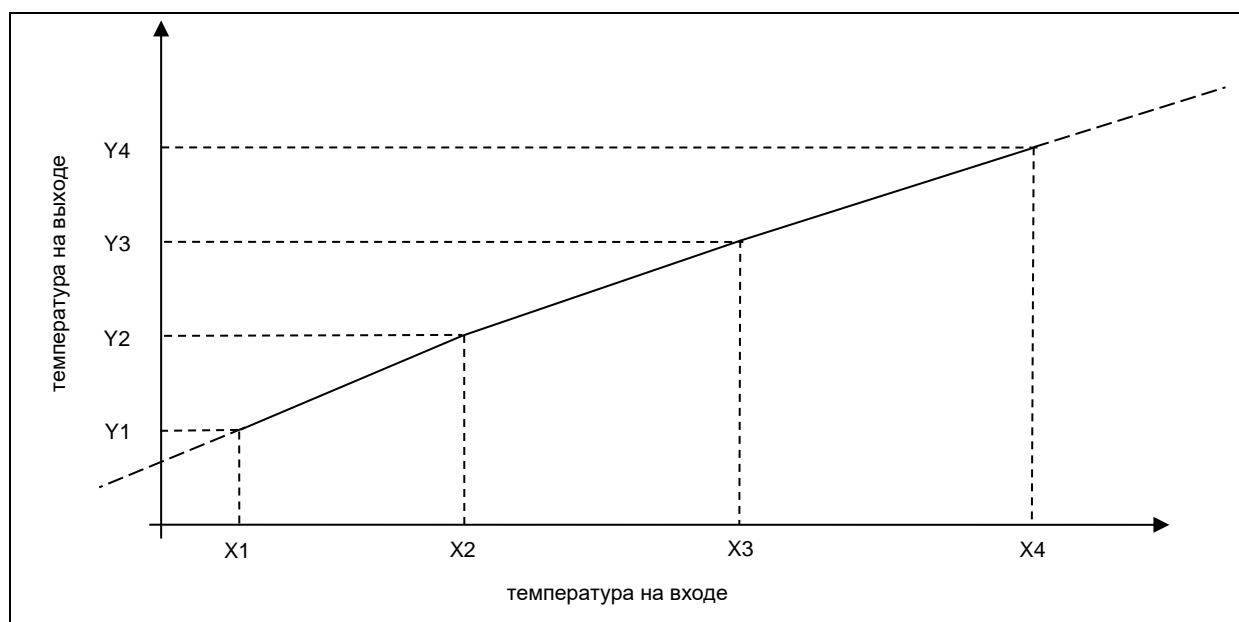


7.1.3 Фильтр для усреднения сигнала

При возникновении колебаний измеряемой температуры в течение определённого промежутка времени за стабилизацию измерительного сигнала отвечает функция сглаживания. Чем больше величина постоянной времени t_{98} , тем меньше влияние колебаний температуры на измеренную величину.

Время реагирования пирометра пропорционально установленной постоянной времени t_{98} , поэтому необходима настройка прибора на объект измерения минимум в течение заданного времени t_{98} .

Функция сглаживания регулируется посредством $\ll 00 \mid$ / $\ll \text{F. L. 9}$ для канала соотношения коэффициентов излучения Q.

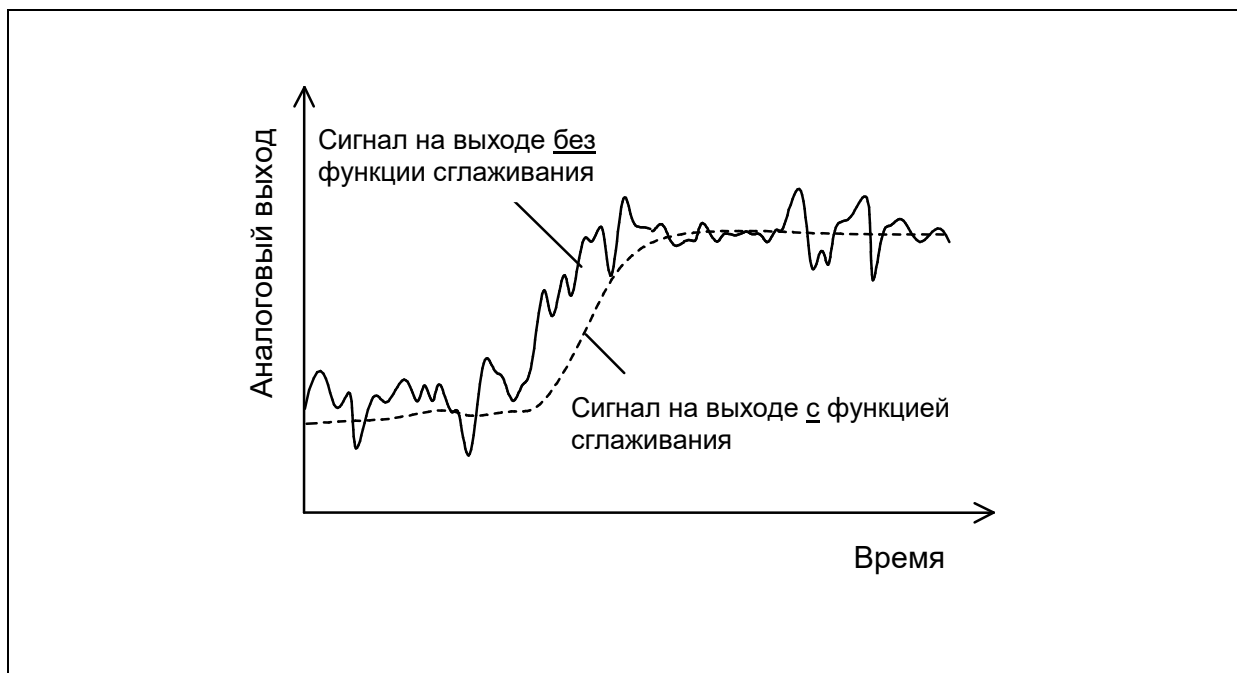

8 Функция АРТ «Автоматическая Регистрация Температуры»

8.1 Измерение струи жидкого металла

Данная функция служит для определения температуры в автоматическом режиме при циклических процессах, например, разлив металла. С этой целью для расчёта температуры определяются периоды измерения и температурные пороги. Существует дополнительная возможность рассчитать среднее температурное значение на протяжении нескольких циклов.

Начало измерительного цикла определяется автоматически и зависит от следующих параметров:

Порог 1 (t_{th1}):	Перед началом измерения температура должна минимум один раз упасть ниже порога 1. При автоматическом сбросе «Autoreset» ($Autoreset = on$) порог 1 игнорируется.
Порог 2 (t_{th2}):	Превышение порога 2 минимум в течение периода мёртвого времени (t_{dead})
Мёртвое время (t_{dead}):	См. порог 2

Если условия выполнены, начинается время измерения (t_{act}).

Время измерения (t_{ACT})	В течение времени измерений рассчитывается и запоминается температурное значение.
---	---

**УКАЗАНИЕ!**

Если параметр $t_{ACT} = 0$, то момент окончания циклического процесса регистрируется автоматически (измеренная температура < порога 2). На приборе в таком случае вместо значения времени (параметр t_{ACT}) высвечивается „Auto“.

Параметр (RLO) определяет, какая именно температура будет выдана во время измерений.

Отображение процесса измерений на выходах и на дисплее (RLO)	<p>„$t = 0$“ Выдача температурного значения во время измерений устанавливается на начало диапазона измерений.</p> <p>„$t hld$“ Выдача температурного значения во время измерений устанавливается на предыдущее значение.</p>
---	--

Длительность времени измерения по желанию высвечивается на зелёном светодиоде или отображается в виде сигнала на переключающем выходе. (Kapitel 10.1.3)

По окончании всех выполненных циклов измерений рассчитывается среднее значение, которое высчитывается из актуального и старого, в результате соответствующей оценки выбранного и сохранённого в памяти среднего значения.

Среднее значение ($F - P_r$)	Степень оценки. При 100% без учёта среднего значения.
--	---

Чем ниже установка $F - P_r$, тем выше степень усреднения.

При активном усреднении ($F - P_r < 100\%$) выполняется дополнительная проверка достоверности актуального измерительного цикла. Для этого выявляется разница между актуальным и сохранённым старым средним значением. Если разница больше, чем порог достоверности t_{SP} , выдаётся измеренное значение «0», а среднее значение остаётся неизменным.

Достоверность (t_{SP-})	Нижний предел допустимого перепада температур.
Достоверность (t_{SP+})	Верхний предел допустимого перепада температур.

В конце интервала измерений выдаётся среднее измеренное значение или «0». Одновременно генерируется импульс, который можно использовать для управления переключаемых выходов. Для этого следует задать **ПЕН1** в качестве источника и отрегулировать время удержания примерно на 0,5 сек.

После окончания времени измерения начинается время выбега, которое должно быть закончено до начала нового измерительного процесса при указанных выше условиях.

Время выбега ($t_{d,5}$)	Должно истечь перед началом нового цикла.
--------------------------------------	---

Если на протяжении времени t_{out} измерительный цикл не начинается, то блок памяти с накопленными средними значениями стирается. Запись новых средних значений начинается одновременно с началом следующего процесса измерений.


Timeout (t_{out}):	Timeout для функции усреднения (в минутах)
-------------------------------	---

Для циклического срабатывания функции АРТ можно активировать «автосброс» (Autoreset). В этом случае порог 1 игнорируется. Для начала измерения достаточно превысить порог 2 на длительность мёртвого времени t_{DEL} .

Autoreset (A.r St):	Autoreset on/off
----------------------------	------------------

Также проверяется ход температуры во время измерения. Если температура, даже кратковременно, опускается ниже порога 2, тогда актуальное измерение сбрасывается.

Set Li2 check on tAct ($c_{h.L.2}$)	on/off
--	--------

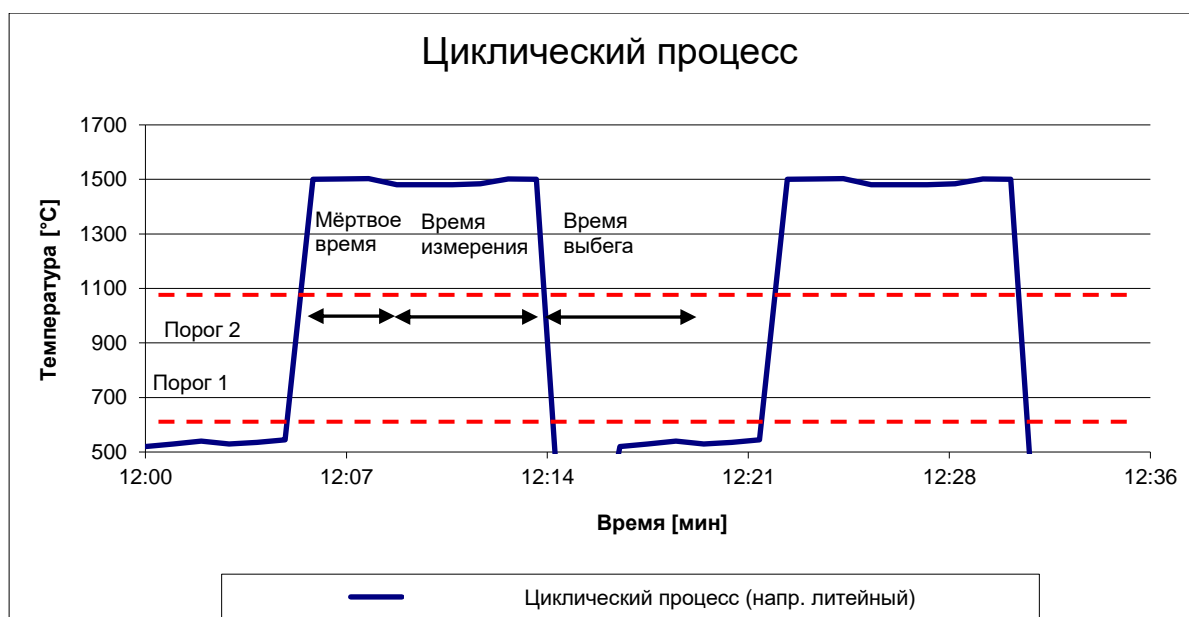

8.1.1 Глобальная настройка прибора

Функция	Параметр	Значение
Диапазон измерения / калибровка Ia1		650 – 1700 °C
Источник для Ao1	Ro 1.5	Q Канал соотношения сигналов
Ao1 Калибровка Исходное значение	Ro 1.1	650 °C
Ao1 Калибровка Окончательное значение	Ro 1.7	1700 °C
Ao1 → 0/4..20 мА	Ro 1.4	4-20 (4-20 мА)
Функция зелёного светодиода для индикации статуса	LED 6	TRC Q Индикация времени измерения при вкл. функции APT Источник: Канал соотношения Q

8.1.2 Исходные параметры пирометра PA 83

Функция	Параметр	Значение
Отображение процесса измерений на выходах и на дисплее	Ro 0	t = 0 Выдача температурного значения во время измерений устанавливается на начало диапазона измерений.
Autoreset	Ar St	Off / Выкл.
Среднее значение	F - Pr	90 %
Время измерения	t Ac t	0 с *1 (Автоматически)

Мёртвое время	t dEL	1 с
Set Li2 check on tAct	chL2	oFF (Выкл.)
Timeout	t oUt	2 мин *2 (точнее < перерыв между двумя ковшами)

*1 Параметр t Ac t = 0 доступен лишь при версии программного обеспечения 1.69 и выше. Для прежних версий действует: интервал измерения = кратчайший интервал литья - мёртвое время – 1сек. В идеальном случае измерение должно быть завершено в конце литья. При переменных технологических интервалах следует использовать время кратчайшего цикла литья.

*2 Время параметра Timeout должно быть меньше времени между циклами литья.

8.1.3 Настраиваемые параметры в зависимости от материала

Конфигурация осуществляется с помощью кнопок на приборе или программным обеспечением CellaView

Функция	Параметр	Стандартная конфигурация
Соотношение коэффициентов излучения $\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$	EP5.9	101 (Серый чугун)* 104 (Высокопрочный чугун)

* Точную настройку соотношения коэффициента излучения необходимо выполнять с учётом измерений, полученными с помощью погружного измерительного зонда (термопары).

Do1 Нижний порог цифрового (переключаемого) выхода 1*	do 1.~	Настройка с помощью кнопок прибора или ПК
Do1 Верхний порог для цифрового (переключаемого) выхода 1*	do 1.~	Настройка с помощью кнопок прибора или ПК

* Настройку необходимо выполнять с учётом измерений, полученными с помощью погружного измерительного зонда (термопары).

8.2 Дополнительная конфигурация функции АРТ

Функция	Параметр	Значение
Время фильтрации	FILT	500 мс
Режим функции Q-check	chcQ	On
Относительный миним. лимит отключения	chcL	5 %

Память предельных значений	PEPQ	Red (Функция АРТ)
Время выбега	td15	0 с
Порог Li 1	Li1	1100 °C
Порог Li 2	Li2	1200 °C
Порог достоверности Нижний предел	tSP-	50 К
Порог достоверности Верхний предел	tSP+	150 К

8.2.1 Конфигурация предельных значений цифровых выходов

Цифровой выход 1

Переключаемый выход 1 (Включенный, если измеренное значение находится вне границе)	do1.	on (Вкл.)
Источник	do15	Q Канал соотношения
Логическая функция	do1F	гнБ. Функция "Range" (Включение при выходе из диапазона)

Цифровой выход 2

Переключаемый выход 1 (Включенный, если измеренное значение находится вне границе)	do2.	on (Вкл.)
Источник	do25	RRcQ Время измерения функции АРТ / Канал соотношения [Q]
Логическая функция	do2F	LuL. Функция "Level" (Включение выхода при превышении определённого порога)
Время удержания	do2n	0,2 с

8.3 Измерение в желобе или в плавильной печи

Функция для автоматического измерения температуры расплава металла в желобе или в плавильной печи.

Параметр	Функция	Стандартная конфигурация	Собственная настройка
$\epsilon P S . 9$	Соотношение коэффициентов излучения $Q = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$	101 (Серый чугун)* 104 (Высокопрочный чугун)	
$ch r . 9$	Режим функции Q-check	$\Pi \text{ on}$	
$ch r . -$	Относительный миним. лимит отключения	5 %	
$F . L . 9$	Функция сглаживания	On (Вкл.)	
$F . L . t$	Время фильтрации	500 мс	
$MEM . 9$	Память предельных значений	$R t d$ (Функция АРТ)	
$t d \epsilon L$	Мёртвое время	1 с	
$t A c t$	Время измерения	15 с	
$t d . S$	Время выбега	0 с	
$t o U t$	Timeout	2 мин	
$L . 1$	Порог 1	1100 °C	
$L . 2$	Порог 2	1200 °C	
$F - P r$	Оценка среднего значения	75	
$t S P -$	Порог достоверности Нижний предел	50 °C	
$t S P +$	Порог достоверности Верхний предел**	150 °C	
$A n o$	Индикация на дисплее во время измерения	$t h L d$	
$ch L . 2$	Set Li2 check on t.Act	$o F F$ (Выкл.)	
$A r S t$	Autoreset	$o n$ (Вкл.)	

* Настройку необходимо выполнять с учётом измерений, полученными с помощью погружного измерительного зонда (термопары).

Конфигурация предельных значений цифровых выходов

Цифровой выход 1

Переключаемый выход 1 (Включенный, если измеренное значение находится вне границе)	do 1.	on (Вкл.)
Источник	do 1.5	Ч Канал соотношения
Логическая функция	do 1.F	г н Б. Функция "Range" (Включение при выходе из диапазона)

Цифровой выход 2

Переключаемый выход 1 (Включенный, если измеренное значение находится вне границе)	do 2.	on (Вкл.)
Источник	do 2.5	Я Я с Ч Время измерения функции АРТ / Канал соотношения [Q]
Логическая функция	do 2.F	L u L. Функция "Level" (Включение выхода при превышении определённого порога)
Время удержания	do 2.n	0,2 с

8.4 Конфигурация аналогового входа для внешней настройки соотношения коэффициентов излучения e1/e2

Конфигурация I/O (кодовая страница: с 0 10)

Параметр	Функция	Примечания
Ao 2.	Аналоговый выход 2	oFF Выкл.
A .Fn	Функция: налогового входа	EP5.9 Регулирование соотношения коэффициентов излучения через аналоговый вход
A .u 1	Ain Калибровка Исходное значение	Начало диапазона входного напряжения 1 (2 В)
A .u 2	Ain Калибровка Исходное значение	Начало диапазона входного напряжения 2 (10 В)
A .u 1	Ain Калибровка	Входная величина 1 (z. В. 100% для соотношения коэффициента излучения)
A .u 2	Ain Калибровка	Входная величина 2 (напр. 110% для соотношения коэффициента излучения)
SAUE	Сохранить	Сохранение отрегулированных параметров / Выход из меню

Пирометр нужно настроить так, чтобы настроенное значение аналогового входа отображалось на дисплее.

Изображение внутренних значений (Кодовая страница: c 020)

Параметр	Функция	Примечание
A _{in}	Входная величина аналогового входа	Актуальное значение аналогового входа при включении

9 Конфигурация I/O (входов / выходов)

9.1 Калибровка аналоговых выходов

Для использования аналогового выхода необходима его калибровка и определение источника сигнала. Источник определяет выходной сигнал аналогового выхода. У пирометров спектрального соотношения (РА 80, 81, 83) для аналогового выхода 1 (Ao1) существуют три источника:

- канал соотношения коэффициентов излучения
- спектральный канал 1 / лямбда 1
- спектральный канал 2 / лямбда 2

Источник Ao1 при обычном режиме работы будет являться температурным значением, которое высвечивается на дисплее.

Для аналогового выхода 2 (Ao2) дополнительно существуют следующие источники:

- канал соотношения / сигнал перед памятью предельных значений
- спектральный канал 1 / сигнал перед памятью предельных значений
- спектральный канал 2 / сигнал перед памятью предельных значений
- интенсивность сигнала
- внутренняя температура прибора

Калибровку необходимо выполнять для каждого аналогового выхода отдельно. Она определяется началом.....концом диапазона, а также выходным током 0...20 / 4...20 мА. Преобразование температуры в ток происходит по линейной возрастающей.

Ток устанавливается посредством клавиш на задней панели прибора в диапазоне 0...20 / 4...20 мА или в зависимости от напряжения на одном из переключаемых входов 1 или 2:

- 0 В -> 0...20 мА
- 24 В -> 4...20 мА

Выборка для установки аналогового выхода 1, а также аналогового выхода 2 находится на кодовой странице c 0 10, параметры A_{o 1.5}, A_{o 1.1}, A_{o 1.2} und A_{o 1.4}

1) Пример конфигурации PA 83:

Ao1: измеряемая температура / спектральный канал 1
650...1700 °C ≅ 4...20 мА

Ao2: внутренняя температура PA
0...100 °C ≅ 4...20 мА

Кроме того, существует возможность калибровки второго выхода в качестве функции лупы измеренного значения, включающего в себя часть диапазона первого выхода:

2) Пример конфигурации PA 83:

Ao1: измеряемая температура спектрального канала 1
650...1700 °C ≅ 4...20 мА

Ao2: измеряемая температура спектрального канала 1
800...1200 °C ≅ 4...20 мА

9.2 Переключаемые выходы

Каждому из переключаемых выходов можно присвоить следующие функции:


- **Выход не используется** (занят для дискретного входного сигнала, т.е. переключаемого входа)
- **«Ready» Сигнал готовности** (измерение в пределах диапазона измерений прибора)
- **Сигнал переключения с регулируемым порогом:**
 - канал соотношения
 - канал соотношения перед памятью предельных значений
 - спектральный канал 1
 - спектральный канал 1 перед памятью предельных значений
 - спектральный канал 2
 - спектральный канал перед памятью предельных значений
 - интенсивность сигнала
 - сигнал функции контроля затухания сигнала
 - внутренняя температура прибора

- **Сигнал статуса функции АРТ:**
 - функция АРТ лямбда 1 / триггер в конце интервала измерений
 - функция АРТ лямбда 2 / триггер в конце интервала измерений
 - функция АРТ канал соотношения / триггер в конце интервала измерений
 - функция АРТ лямбда 1 / сигнализация времени измерения
 - функция АРТ лямбда 2 / сигнализация времени измерения
 - функция АРТ канал соотношения / сигнализация времени измерения


При использовании выхода в качестве переключаемого сигнала регулируются следующие параметры:

- источник сигнала
- логическая функция и инвертирование выхода
- порог чувствительности + гистерезис переключения при функции „Level“
- нижний и верхний предел при выполнении функции = „Range“
- время перед подключением (время задержки)
- продление времени переключения (время удержания)

9.2.1 Логическая функция включения „Level“

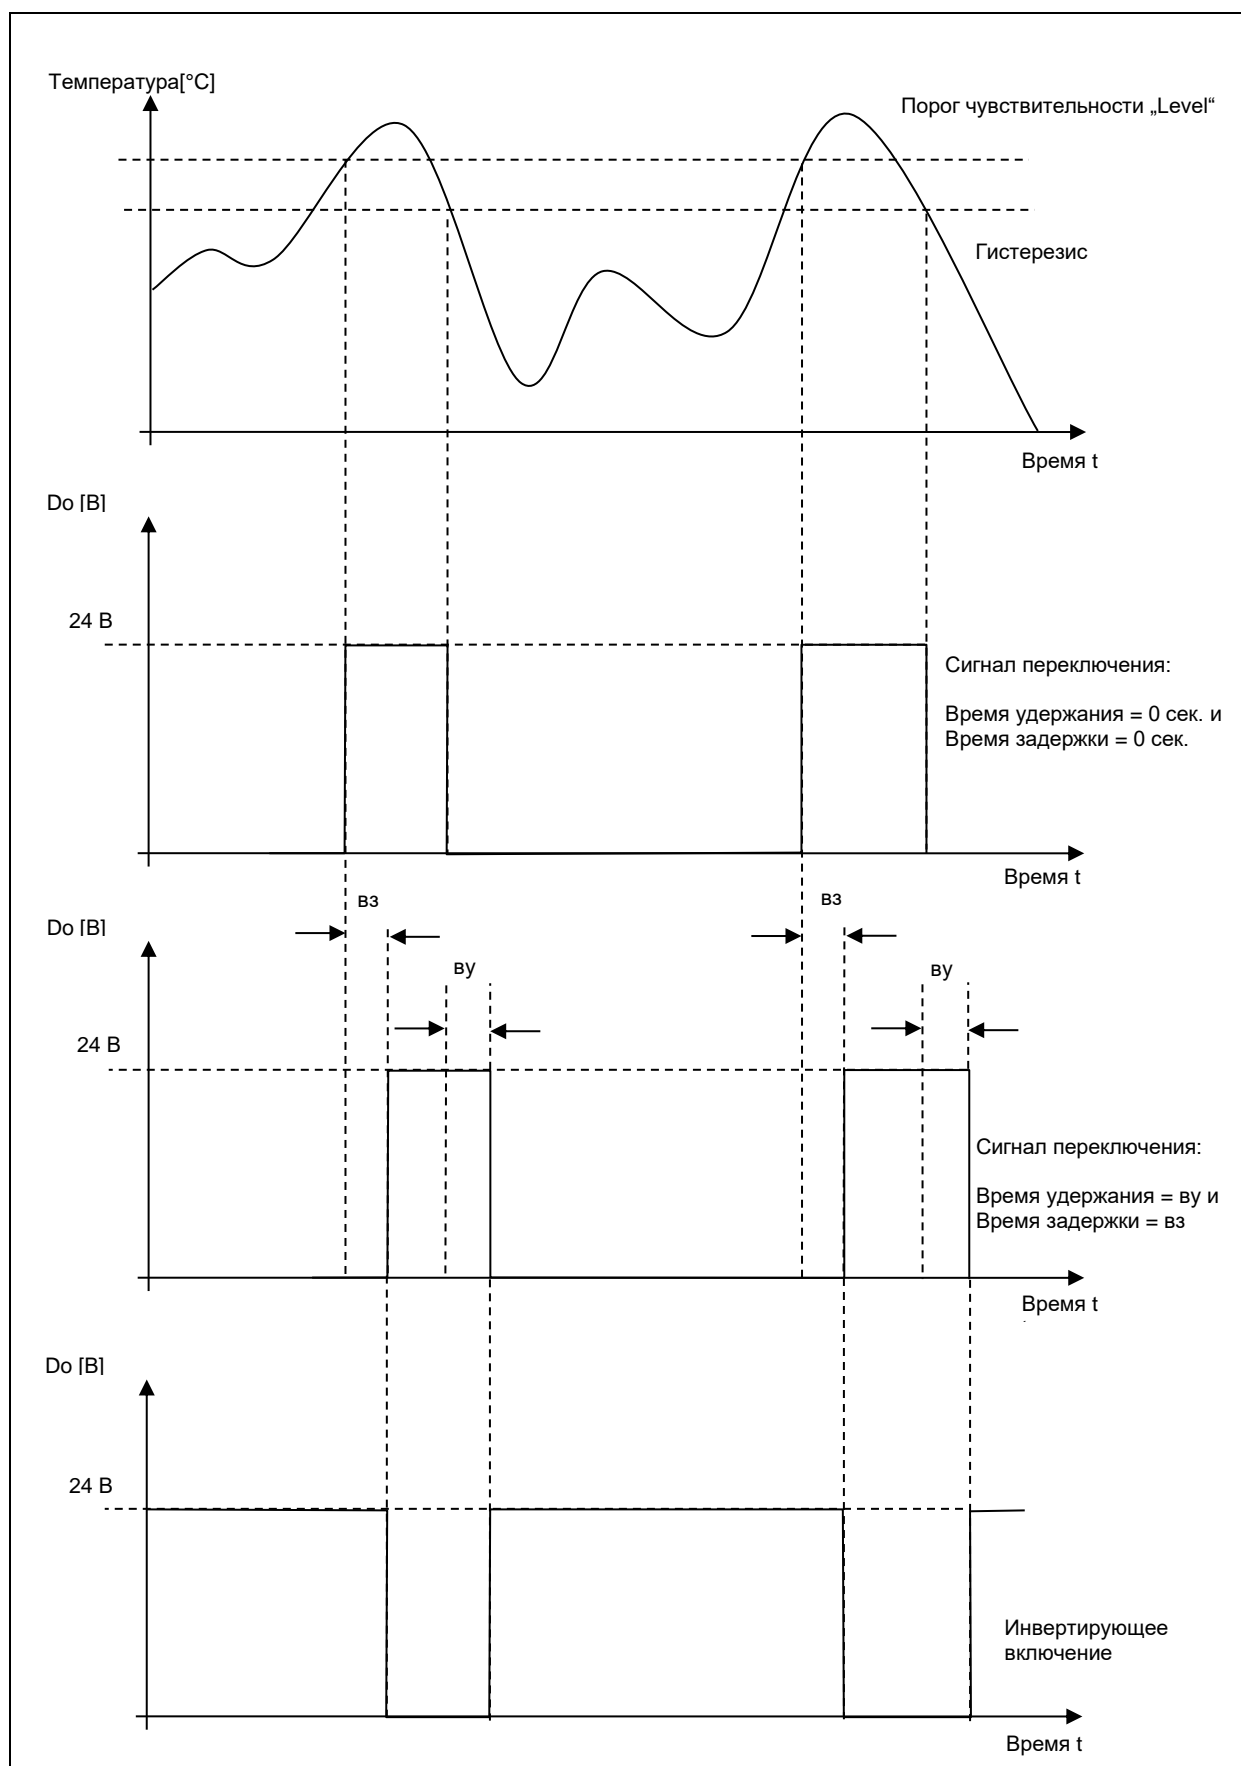

9.2.2 Логическая функция включения „Range“

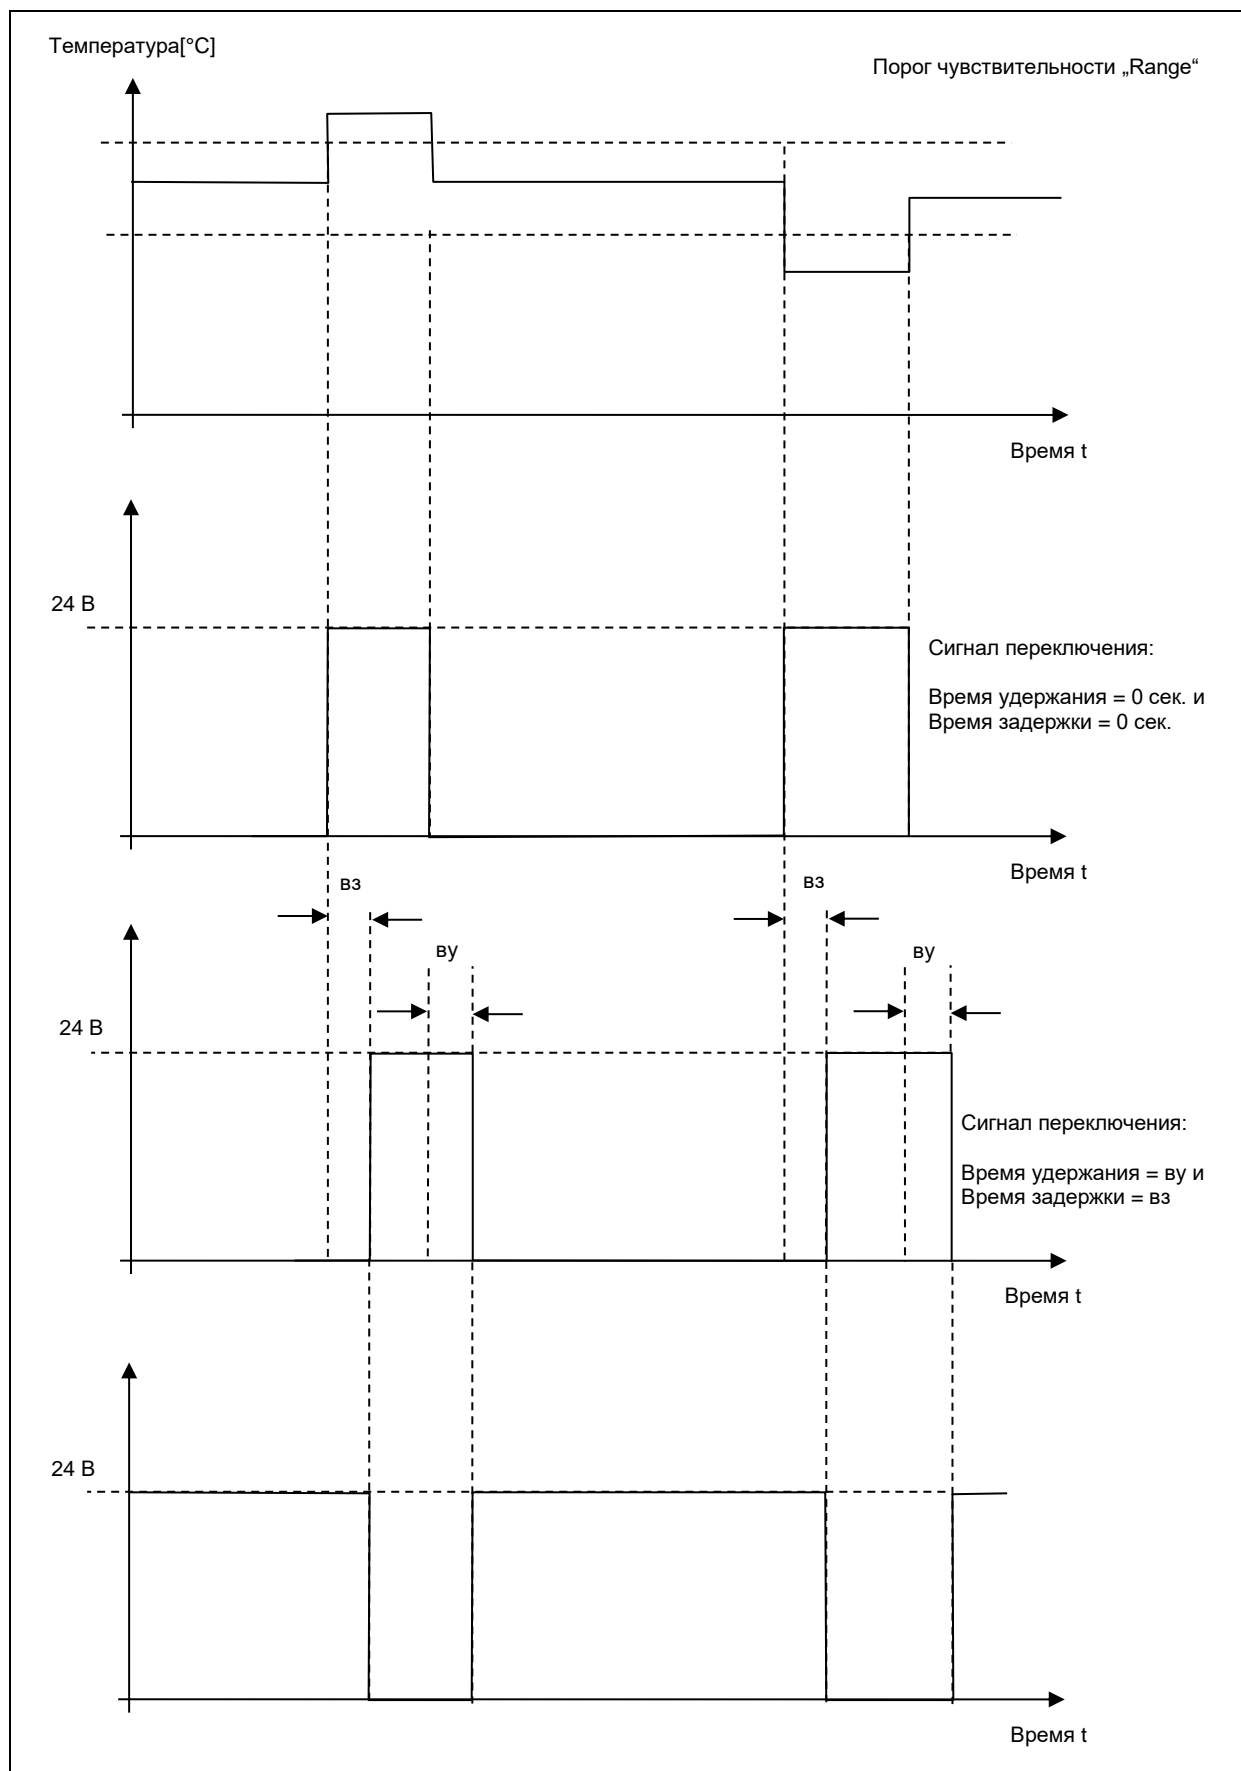

9.3 Переключаемые входы

Для использования переключаемого входа необходима деактивация соответствующего переключаемого выхода во избежание их взаимного влияния друг на друга. Присвоение статуса «Вход» происходит в результате выполнения соответствующих функций:

- калибровка аналогового выхода Ao1/Ao2 на 0...20 мА или 4...20 мА
- стирание памяти минимальных и максимальных или двойных максимальных значений
- управление целеуказателем с помощью импульса (в конструкциях с лазерным целеуказателем)

9.4 Аналоговый вход для регулирования коэффициента излучения (Режим спектрального соотношения)

При необходимости аналоговый (токовый) выход 2 (подключение через штифт 3) используется в качестве потенциального входа, что позволяет, например, отрегулировать коэффициент излучения измеряемого объекта через внешний источник.

С этой целью необходимо вручную деактивировать аналоговый выход 2 во избежание взаимного влияния входа и выхода. Затем на кодовой странице $\llcorner \text{O} \text{IO}$, используя параметр $\text{A} \cdot \text{F} \text{r}$, можно выбрать желаемую функцию. После инициации коэффициент излучения не может быть изменен непосредственно с помощью кнопок или интерфейса. На дисплее в зависимости от аналогового входа высвечивается актуальное используемое значение. Время от времени появляется $\text{E} \text{H} \text{E}$, свидетельствуя о том, что регулирование выполнено извне.

Калибровка нижнего и верхнего значения напряжения выполняется с помощью параметров $\text{AU} \dots$. Соответствующие значениям напряжения величины входа определяются с помощью параметров $\text{A} \dots$

Пример внешней регулировки коэффициента излучения:

$\text{A} \cdot \text{U} \text{1} = 0 \text{ В}$

$\text{A} \cdot \text{U} \text{2} = 10 \text{ В}$

$\text{A} \cdot \text{r} \text{1} = 80$ (коэффициент излучения 80 %)

$\text{A} \cdot \text{r} \text{2} = 120$ (коэффициент излучения 120 %)

**УКАЗАНИЕ!**

Если используется аналоговый вход, параметры для аналогового выхода 2 недоступны. Если используется аналоговый выход 2, параметры аналогового входа недоступны.

9.5 Общие функции (Кодовая страница с 0 ! !)**9.5.1 Функция зелёного светодиода**

Светодиоду можно присвоить следующие функции:

- непрерывная индикация рабочего напряжения +24 В
- индикация статуса переключаемого выхода 1
- индикация статуса переключаемого выхода 2
- индикация времени измерения (функция АРТ (t R c t))

Настройка функции светодиода выполняется с помощью параметра **L E d B**.

9.5.2 Включение лазерного целеуказателя

Если пирометр оснащён лазерным целеуказателем, существуют следующие возможности запуска целеуказателя с помощью параметра **P i L o**:

- кнопка пирометра
- полное отключение
- импульсный запуск с помощью переключающих входов (переключение 0 -> 24В)

С помощью параметра **P i L t** можно отрегулировать время автоматического отключения целеуказателя в диапазоне от 1 до 15 мин.

**УКАЗАНИЕ!**

Встроенный лазерный целеуказатель не предназначен для продолжительного использования. Поэтому отключение лазера происходит не позднее отрегулированного параметром **P i L t** времени.

При температуре окружающей среды выше 55°C лазер отключается.

9.5.3 Регулировочные функции для камеры

Если пирометр оснащён интегрированной камерой, возможна установка следующих режимных модусов:

Регулятор экспозиции (TBC: True Brightness Control):

- регулирование экспозиции происходит только в пределах отмеченного измерительного пятна (с t b c = o n)
- настройка экспозиции распространяется на всё поле зрения камеры (с t b c = o F F)

Баланс белого цвета

Баланс белого служит для повышения чувствительности реакции камеры на цветовую гамму при выполнении снимка. В течении времени автоматической балансировки камера ищет и сравнивает кажущуюся ей белую поверхность в автоматическом режиме. Если камера не находит белую поверхность, балансировка может привести к искажению цветопередачи в виде нежелательного цветового оттенка (параметр c . c o l = „автом. режим“).

Существует возможность задавать цветовую гамму в ручном режиме. Камера в этом случае настройку белого не выполняет (с . c o l = d A Y L Дневной свет).

Кадр для показаний измеряемой температуры

Отключение и включение кадра с показаниями измеряемой температуры осуществляется в правом нижнем углу с помощью параметра c . o u l .

9.5.4 Включение интерфейса

CellaCast PA оснащён двумя серийными интерфейсами, каждый из которых используется для связи с компьютером.

Порт USB расположен на обратной стороне прибора. Защищённый пластмассовой крышкой интерфейс, как правило, уже при поставке активирован на заводе-изготовителе для соединения с терминалом. Перед подключением к порту USB компьютера необходима инсталляция драйвера (см. гл. 16). После этого пирометр идентифицируется в качестве нового серийного порта, опрос которого выполняется с помощью программы терминала (напр., гипертерминал).

Параметры регулируются следующим образом:

**57600 бод / 8 Биты данных / Odd паритет / 1 Стоповый бит /
Без управления потоком данных**

**УКАЗАНИЕ!**

Передача данных начинается примерно через 2 сек. после включения сигнала «DTR». Данный сигнал следует активировать в программе терминала.

После подключения порта и настройки параметров пирометр выдаёт следующие данные:

```
-----
- PA40 AF1          650-1700C -
- PA40SW001/0     QP 0,95/1,05um  Version 01.74  19.06.13 -
-----
```

Press double CTRL-E to enter command-mode

Второй серийный порт соответствует стандарту RS485. Он доступен непосредственно через контакты 5 и 6 прибора. Для включения порта на кодовой странице с **0 1 1** необходимо изменить параметр **ѐ E r П**. на параметр **r 485**. Коммуникация терминала происходит в данном случае через этот порт, обеспечивая таким образом увеличение дистанции для передачи данных. Команды пользователя принимаются только в тех случаях, когда сам пирометр сигналов не посылает, поскольку порт RS485 согласно нормам работает в режиме полудуплексной передачи данных. Поэтому при работе с терминалом данный порт следует преимущественным образом обслуживать в ручном режиме (например, при пуско-наладке). Концевое сопротивление шины (150 Ω) уже интегрировано в пирометре. Поэтому интерфейс можно использовать непосредственно в качестве связи «точка к точке» для соединения с компьютером посредством преобразователя RS485-RS232 (W&T #86201).

9.6 Моделирование выходных сигналов и температуры Ao1 и Ao2 (Кодовая страница с **100**)

Пирометр обладает функцией, с помощью которой можно моделировать измеряемую температуру, например, при вводе в эксплуатацию. С помощью кнопки задаётся желаемая температура, которая затем, в зависимости от калибровки, будет являться значением выходного тока. Соответствующий параметр можно найти на кодовой странице с **100**. При правильной инсталляции все введённые здесь значения должны появиться в подключённой системе управления (в зоне калибровки). В случае появления неправильных значений следует проверить калибровку и кабельное соединение.

После проверки необходимо выйти с кодовой страницы посредством нажатия "E 5 c" и выполнять измерения в обычном режиме. Установка параметров на приборе

10 Настройка параметров в приборе

В дополнение к описанным в 7 главе способам настройки прибора возможен непосредственный доступ ко многим другим параметрам, которые разделены на 7 уровней (кодовые страницы).

10.1 Описание кодовых страниц

Уровни конфигурации специфицированы в соответствии с выполняемыми функциями. Доступ к ним обеспечивается через следующие кодовые страницы:

• c 00 1	Регистрация результатов измерений / Канал соотношения коэффициентов [Q]
• c 002	Регистрация результатов измерений / Спектральный канал 1 (L2 / Лямбда 1)
• c 003	Регистрация результатов измерений / Спектральный канал 2 (L2 / Лямбда 2)
• c 0 10	Конфигурация I/O (входы / выходы)
• c 0 1 1	Общие функции
• c 020	Индикация внутренних величин
• c 100	Моделирование выходных сигналов Ao1 и Ao2

Все параметры указаны в нижеследующих таблицах. Отдельные параметры при деактивации соответствующей основной функции недоступны. Так, например, невозможно отрегулировать время усреднения в том случае, если функция сглаживания деактивирована или действует в автоматическом режиме.

10.1.1 Регистрация результатов измерений Канал соотношения коэффициентов излучения (Кодовая страница: c 00 1)

Параметр	Функция	Примечания
E P S . 9	Соотношение коэффициентов излучения	$\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} = \text{Quotient [Q]}$
c h . 9	Режим функции Q-check	o F F Выкл. n . n Отключение при недостижении порога n . n . n Отключение при недостижении / превышении порога

сhг..	Относительный миним. лимит	Отключение канала соотношения [Q] при достижении нижнего порога [в %] (относительно интенсивности сигнала)
сhг.~	Относительный максим. лимит	Отключение канала соотношения [Q] при достижении верхнего порога [в %] (относительно интенсивности сигнала)
сhЯt	Абсолютный минимум температуры	Отключение канала соотношения [Q] при достижении абсолютного порога температуры
сhЯ'.	Абсолютный минимум спектральной излучательной способности	Отключение канала соотношения [Q] при достижении абсолютного порога коэффициента излучения [%]
Л.и.Я	Дополнительная линейаризация в произвольно конфигурируемой пользователем таблице	OFF Выкл. 2 - 10: Кол-во используемых точек отсчёта
Л.Н1	Точка отсчёта x 1..10	Значение на входе. Точка отсчёта n
Л.У1	Точка отсчёта y 1..10	Значение на выходе. Точка отсчёта n
F.Л.Я	Функция сглаживания	OFF без усреднения ON усреднение простое
F.Л.t	Время фильтрации	Время t98 в сек. при простом усреднении
пЕп.Я	Память предельных значений	OFF Выкл. п.и.н Сохранение минимальных значений п.Я.н Сохранение максимальных значений д.б.л.п Сохранение двойных макс. значений д.б.л.с Сохранение комбинированных двойных макс. значений Я.т.д Функция АРТ
пЕп.t	Время удержания двойных макс. значений	Время удержания в сек. (доступно только при включённой памяти двойных максимальных значений)
F.Л.п	Функция сглаживания памяти предельных значений*	OFF Выкл. ON Вкл.
F.Л.t	Время фильтрации*	Время t98 в сек.
сЛг.п	Внешний вход для стирания памяти предельных значений*	OFF Внешнее стирание невозможно Е.н.т.1 Стирание при 0-24 В на перекл. входе 1 Е.н.т.2 Стирание при 0-24 В на перекл. входе 2
т.д.Е.Л	Мёртвое время	Функция АРТ см. раздел 8
т.Я.с.т	Время измерения	Функция АРТ см. раздел 8

ε d . 1 5	Время выбега	Функция APT см. раздел 8
ε o U t	Timeout	Функция APT см. раздел 8
L i . 1	Порог 1	Функция APT см. раздел 8
L i . 2	Порог 2	Функция APT см. раздел 8
F - P r	Оценка среднего значения	Функция APT см. раздел 8
ε S P -	Порог достоверности Нижний предел	Функция APT см. раздел 8
ε S P +	Порог достоверности Верхний предел	Функция APT см. раздел 8
A n o	Индикация на дисплее во время измерения	ε = 0 Индикация начала диапазона измерений во время измерения ε h L d Индикация предыдущего значения во время измерения
A r S t	Автосброс	Функция APT см. раздел 8
c h L 2	Set Li2 check on t.Act	Функция APT см. раздел 8
S A U E	Сохранить	Сохранение отрегулированных параметров / Выход из меню
E S c	Отмена (Escape)	Отмена отрегулированных параметров / Выход из меню

* Параметры доступны только при наличии памяти максимальных, минимальных или двойных максимальных значений.

10.1.2 Регистрация результатов измерений Спектральные каналы 1 и 2 (Кодовые страницы: c 002 и c 003)

Параметр	Функция	Примечания
ε P S . 1	Коэффициент излучения L1	
ε A U . 1	Коэффициент трансмиссии L1	Коэффициент трансмиссии от напр. защитных стекол
б A c . 1	Компенс. фон	Компенсация фонового излучения необходима в тех случаях, когда отражаемое фоновое излучение слишком велико по отношению к собственному излучению измеряемого объекта,
б A c t	Фоновая температура	
б A c !	Влияние фона	Доля фонового излучения в %
L i n . 1	Дополнительная линеаризация в произвольно конфигурируемой пользователем таблице	o F F Выкл. 2 - 10: Кол-во используемых точек отсчёта
L . H 1	Точка отсчёта x 1..10	Значение на входе. Точка отсчёта n

L . 4 1	Точка отсчёта у 1..10	Значение на выходе. Точка отсчёта n
F . L . 1	Функция сглаживания	o F F Вез усреднения o n Усреднение простое
F . L . 5	Время фильтрации	Время t98 в сек. при простом усреднении
п e n . 1	Память предельных значений	o F F Выкл. п . n Сохранение минимальных значений п я n Сохранение максимальных значений д б л . n Сохранение двойных макс. значений д . 5 n Функция APT
п e n . 5	Время удержания двойных макс. значений	Время удержания в сек.
F . L . n	Функция сглаживания памяти предельных значений*	o F F Выкл. o n Вкл.
F . L . 5	Время фильтрации*	Время t98 в сек.
c L r . n	Внешний вход для стирания памяти предельных значений*	o F F Внешнее стирание невозможно E n 5 . 1 Стирание при 0-24 В на перекл. входе 1 E n 5 . 2 Стирание при 0-24 В на перекл. входе 2
t d E L	Мёртвое время	Функция APT см. раздел 8
t A c t	Время измерения	Функция APT см. раздел 8
t d . 5	Время выбега	Функция APT см. раздел 8
t o u t	Timeout	Функция APT см. раздел 8
L . 1	Порог 1	Функция APT см. раздел 8
L . 2	Порог 2	Функция APT см. раздел 8
F - P r	Оценка среднего значения	Функция APT см. раздел 8
t S P -	Порог достоверности Нижний предел	Функция APT см. раздел 8
t S P +	Порог достоверности Верхний предел	Функция APT см. раздел 8
A n o	Индикация на дисплее во время измерения	t = 0 Индикация начала диапазона измерений во время измерения t h l d Индикация предыдущего значения во время измерения
A r S t	Автосброс	Функция APT см. раздел 8
c h L 2	Set Li2 check on t.Act	Функция APT см. раздел 8
S A u E	Сохранить	Сохранение отрегулированных параметров / Выход из меню
E S c	Отмена (Escape)	Отмена отрегулированных параметров / Выход из меню

* Параметры доступны только при наличии памяти максимальных, минимальных или двойных максимальных значений.

Примечание: L1 обозначает лямбда 1, спектральный канал 1.

10.1.3 Конфигурация I/O «входы / выходы» (Кодовая страница: с 0 10)

Параметр	Функция	Примечания
Ao 1.5	Ao1 Аналоговый выход 1 Выбор источника	L 1 Лямбда 1 L 2 Лямбда 2 Q Канал соотношения [Q] (Выбранный источник в обычном режиме эксплуатации прибора является температурным значением, которое отображается на дисплее)
Ao 1.-	Ao1 Калибровка Исходное значение	
Ao 1.~	Ao1 Калибровка Окончательное значение	
Ao 1.4	Ao1 0/4..20мА	0-20 0-20 мА 4-20 4-20 мА E nE. 1 перекл. вход 1: 0В=0-20 мА 24В=4-20 мА E nE. 2 перекл. вход 2: 0В=0-20 мА 24В=4-20 мА
Ao 2.	Аналоговый выход 2	oFF Выкл. oN Вкл.
Ao 2.5	Ao2 Выбор источника	L 1 Лямбда 1 L 1P. Лямбда 1 <u>перед</u> памятью предельного значения L 2 Лямбда 2 L 2P. Лямбда 2 <u>перед</u> памятью предельного значения Q Канал соотношения [Q] QP. Канал соотношения <u>перед</u> памятью предельного значения E U Внутренняя температура прибора I nE U Интенсивность сигнала
Ao 2.-	Ao2 Калибровка Исходное значение	
Ao 2.~	Ao2 Калибровка Окончательное значение	
Ao 2.4	Ao2 0/4..20мА	0-20 = 0-20 мА 4-20 = 4-20 мА E nE. 1 перекл. вход 1: 0В=0-20 мА 24В=4-20 мА E nE. 2 перекл. вход 2: 0В=0-20 мА 24В=4-20 мА
do 1.	Переключаемый выход 1	oFF Выкл. oN Вкл.

do IS	Do1 Выбор источника	<p>сдУ Сигнал статуса готовности</p> <p>λ1 Лямбда 1</p> <p>λ1P. Лямбда 1 <u>перед</u> памятью предельного значения</p> <p>λ2 Лямбда 2</p> <p>λ2P. Лямбда 2 <u>перед</u> памятью предельного значения</p> <p>Q Канал соотношения [Q]</p> <p>QP. Канал соотношения <u>перед</u> памятью предельного значения</p> <p>tU Внутренняя температура прибора</p> <p>иСУ Интенсивность сигнала</p> <p>п.т.1 Триггер при вкл. функции АРТ Лямбда 1**</p> <p>п.т.2 Триггер при вкл. функции АРТ Лямбда 2**</p> <p>п.т.9 Триггер при вкл. функции АРТ Канал соотношения [Q]**</p> <p>д.т.т Контроль затухания сигнала</p> <p>В.В.с.1 Время измерения при вкл. Функции АРТ лямбда 1**</p> <p>В.В.с.2 Время измерения при вкл. функции АРТ лямбда 2**</p> <p>В.В.с.9 Время измерения при вкл. функции АРТ Канал соотношения [Q]**</p>
do IF	Do1 Логическая функция	<p>λ.λ. Функция "Level" (Включение выхода при превышении определённого порога)</p> <p>λ.λ.- Функция "Level"/Инвертирование выхода</p> <p>р.р.б. Функция "Range" (Включение при выходе из диапазона)</p> <p>р.р.б- Функция. "Range" / Инвертирование выхода</p>
do It	Do1 Порог переключения	Температурный порог для переключения (только для логической функции „Level“)
do Ih	Do1 Гистерезис переключения	Гистерезис +/- относительно порога переключения (только для логической функции „Level“)
do I.-	Do1 Начало диапазона	Начало диапазона для сигнала переключения (только для логической функции „Range“)
do I.-	Do1 Конец диапазона	Конец диапазона для сигнала переключения (только для логической функции „Range“)
do IL	Do1 Время задержки	См. раздел 9.2
do IN	Do1 Время удержания	См. раздел 9.2
do2.	Переключаемый выход 2	<p>оFF Выкл.</p> <p>оN Вкл</p>

do2.5	Do2 Выбор источника	<p>г.д.У Сигнал статуса готовности</p> <p>λ.1 Лямбда 1</p> <p>λ.1.P.P. Лямбда 1 <u>перед</u> памятью предельного значения</p> <p>λ.2 Лямбда 2</p> <p>λ.2.P.P. Лямбда 2 <u>перед</u> памятью предельного значения</p> <p>Q Канал соотношения</p> <p>Q.P.P. Канал соотношения <u>перед</u> памятью предельного значения</p> <p>т.В Внутренняя температура прибора</p> <p>и.н.У Интенсивность сигнала</p> <p>п.т.р.1 Триггер при вкл. функции АРТ Лямбда 1**</p> <p>п.т.р.2 Триггер при вкл. функции АРТ Лямбда 2**</p> <p>п.т.р.9 Триггер при вкл. функции АРТ Канал соотношения [Q]**</p> <p>д.т.т Контроль затухания сигнала</p> <p>я.я.с.1 Время измерения при вкл. функции АРТ лямбда 1**</p> <p>я.я.с.2 Время измерения при вкл. функции АРТ лямбда 2**</p> <p>я.я.с.9 Время измерения при вкл. функции АРТ Канал соотношения [Q]**</p>
do2.F	Do2 Логическая функция	<p>λ.λ.λ. Функция "Level" (Включение выхода при превышении определённого порога)</p> <p>λ.λ.λ.- Функция "Level"/Инвертирование выхода</p> <p>г.н.б. Функция "Range" (Включение при выходе из диапазона)</p> <p>г.н.б.- Функция. "Range" / Инвертирование выхода</p>
do2.t	Do2 Порог переключения	Температурный порог для переключения (только для логической функции „Level“)
do2.h	Do2 Гистерезис переключения	Гистерезис +/- относительно порога переключения (только для логической функции „Level“)
do2..	Do2 Начало диапазона	Начало диапазона для сигнала переключения (только для логической функции „Range“)
do2.-	Do2 Конец диапазона	Конец диапазона для сигнала переключения (только для логической функции „Range“)
do2.L	Do2 Время удержания	См. раздел 9.2
do2.П	Do2 Время задержки	См. раздел 9.2

А .F. n	Функция: Аналоговый вход	oFF Аналоговый вход деактивирован E P5 1: Регулирование коэффициента излучения канала «лямбда 1» через аналоговый <u>вход</u> «лямбда 1» bA c 1: Регулирование фоновой температуры через аналоговый <u>вход</u> E P5 2: Регулирование коэффициента излучения канала «лямбда 2» через аналоговый <u>вход</u> bA c 2: Регулирование фоновой температуры через аналоговый <u>вход</u> «лямбда 2» E P5 4: Регулирование соотношения коэффициентов излучения через аналоговый <u>вход</u>
А .U 1	Ain Калибровка Исходное значение	Начало диапазона входного напряжения 1 (0..10V)
А .U 2	Ain Калибровка Исходное значение	Начало диапазона входного напряжения 2 (0..10V)
А .U 1	Ain Калибровка	Входная величина 1 (напр. коэффициент излучения = 0%)
А .U 2	Ain Калибровка	Входная величина 2 (напр. коэффициент излучения = 100%)
SA UE	Сохранение	Сохранение отрегулированных параметров / Выход из меню
ES c	Отмена (Escape)	Отмена отрегулированных параметров / Выход из меню

Примечание:

Ao1 и Ao2 обозначают аналоговый выход 1 и 2

Do1 и Do2 обозначают цифровой (переключаемый) выход 1 и 2

Ain обозначает аналоговый вход.

10.1.4 Общие функции (Кодовая страница: c 0 ! !)

Параметр	Функция	Примечания
LED B	Функция зелёного светодиода для индикации статуса	o n Наличие напряжения питания 24В d o 1 Индикация статуса переключаемого выхода 1 d o 2 Индикация статуса переключаемого выхода 2 t A c 1 Индикация времени измерения при вкл. функции АРТ L1** t A c 2 Индикация времени измерения при вкл. функции АРТ L2** t A c 4 Индикация времени измерения при вкл. функции АРТ Канал соотношения [Q] **
P .Lo.	Включение целеуказателя*	o n t Нажатием кнопки на приборе o F F Полное отключение t d . 1 Срабатывание при подаче сигнала на переключ. вход 1 t d . 2 Срабатывание при подаче сигнала на переключ. вход 2

P .L t	Макс. время действия целеуказателя*	t - 15: Timeout в минутах
t E r n.	Терминал Присвоение	o F F Передача данных на терминал компьютера отключена U S b Передача данных на терминал компьютера через порт USB r - 485 Передача данных на терминал компьютера через RS485 (полудуплексный)
A .S t r .	Автоматическая выдача измерит. значений	o F F Автоматическая выдача измерит. значений отключена o n Включена выдача измерит. значений на терминал компьютера
A c y c .	Цикл автоматической выдачи измерит. значений	Время цикла в сек.
A d d r .	Адрес прибора	Адрес интерфейса для протоколирования
d .S P .	Дисплей	"o n" "on" появляется на дисплее .Я : Индикация температуры источника A01
U n i t	Единица температуры	o c Градусы по Цельсию o F Градусы по Фаренгейту
c o u l .	Изображение температуры**	"o n" Вкл. "o F F" Выкл.
c t b c .	ТВС Регулировка экспозиции**	"o n" Измерение яркости пятна "o F F" Измерение средневзвешенной яркости
c c o l .	Настройка баланса белого**	"д я ч л ." Дневной свет .Я U t o : В автом. режиме
S A u E	Сохранение	Сохранение отрегулированных параметров / Выход из меню
E S c	Отмена (Escape)	Отмена отрегулированных параметров / Выход из меню

* Только у пирометров с лазерным целеуказателем.

**Параметры доступны только при наличии камеры.

10.1.5 Индикация внутренних измеренных значений (Кодовая страница: c 020)

Параметр	Функция	Примечания
q	Измеряемая температура канала соотношения [Q]	Индикация актуальной измеренной температуры канала соотношения [Q]
L 1.	Измеряемая температура лямбда 1	Индикация актуальной измеренной температуры лямбда 1 / L1
L 2.	Измеряемая	Индикация актуальной измеренной

	температура лямбда 2	температуры лямбда 2 / L2
L1Pr.	Измеряемая температура лямбда 1 /Pre/	Индикация актуальной измеренной температуры L1 перед памятью предельных значений
L2Pr.	Измеряемая температура лямбда 2 /Pre/	Индикация актуальной измеренной температуры L2 перед памятью предельных значений
QPr.	Измеряемая температура канал соотношения [Q] /Pre/	Индикация актуальной измеренной температуры [Q] канала соотношения перед памятью предельных значений
intY	Интенсивность сигнала	Рассчитанная интенсивность сигнала
t.int.	Внутренняя температура прибора	Актуальная температура внутри прибора
A in	Входная величина аналогового входа	Актуальное значение аналогового входа при включении
Esc	Отмена (Escape)	Отмена отрегулированных параметров / Выход из меню

10.1.6 Моделирование выходных сигналов Ao1 и Ao2 (Кодовая страница: с I00)

Параметр	Функция	Примечания
Ao1.	Аналоговый выход 1 проверить	Непосредственное задание тока на выходе Ao1 в миллиамперах
Ao1t	Проверить аналоговый выход 1 и калибровку	Непосредственное задание моделированного температурного значения для Ao1. Использование актуальных значений калибровки.
Ao2.	Аналоговый выход 2 проверить*	Непосредственное задание тока на выходе Ao2 в миллиамперах
Ao2t	Проверить аналоговый выход 2 и калибровку*	Непосредственное задание моделированного температурного значения для Ao2. Использование актуальных значений калибровки.
Esc	Отмена (Escape)	Выход из меню

*Функция доступна только при активировании аналогового выхода 2.

11 Программное обеспечение CellaView

Новое программное обеспечение CellaView служит для подключения пирометра и анализа измеренных значений на персональном компьютере.


Её можно бесплатно скачать здесь:

www.keller.de/its/

Для этого нужно внести название компании, ФИО, свой адрес Email и страну в которой вы находитесь.

12 Установка параметров через терминал (последовательный интерфейс)

Конфигурация всех параметров, необходимых для регистрации результатов измерений или общей конфигурации пирометра, возможна через серийный интерфейс и терминал компьютера. Важнейшие настройки выполняются с помощью определённых кнопок. Остальные функции заложены в подчинённых «меню». Навигация внутри «меню» представлена на схеме.

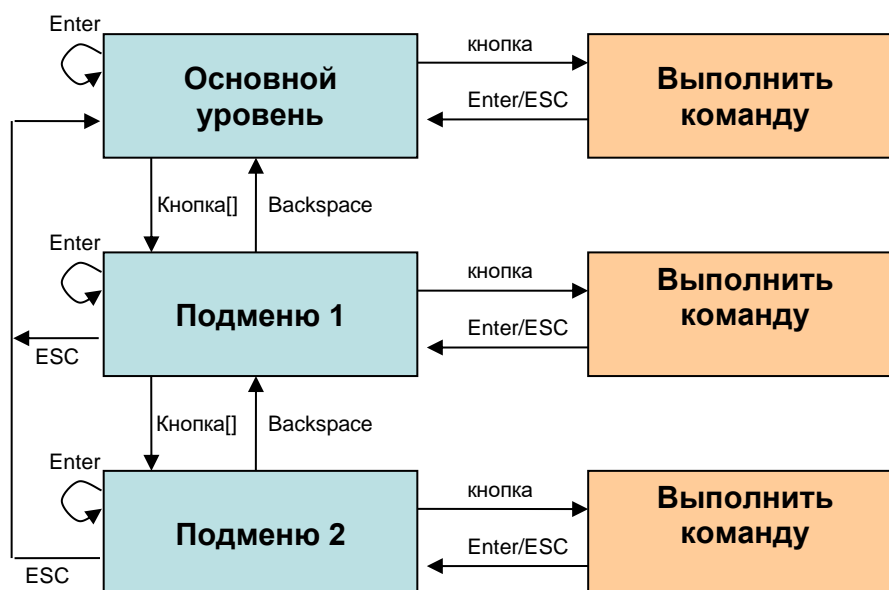

Для ввода пирометра в рабочий режим «Терминал» необходимо нажать на клавишу «CTRL» и одновременно дважды на клавишу «E». На экране появляется меню помощи.

Команды передаются непосредственно через терминал на компьютер с помощью соответствующей кнопки, напр. «E»: для настройки коэффициента излучения. «Подменю» представлены в квадратных скобках, напр. [QUOTIENT]

12.1 Основное меню Обзор

После старта терминала или ввода «H» появляется основное меню:

```
-----
Mainmenu
-----
0: [QUOTIENT]                E: Quick access EPSILON
1: [LAMBDA 1]               A: Quick access FILTER
2: [LAMBDA 2]               T: Quick access Ao1 SOURCE
C: [I/O]                    Y: Quick access Ao1 SCALE BEGIN
K: [CALIBRATION]           Z: Quick access Ao1 SCALE END

H: Show this help-site      J: Show diagnosis
W: Show ambient temperature Q: Show calibration data
X: Show measure temperatures P: Show channel parameters
-----
>
```

12.2 Параметры / Обзор диагностики

Обзор актуальных параметров / Команда «P»:

```
-----
- PA40 AF1          650-1700C -
- PA40SW001/0      QP 0,95/1,05um Version 01.74 19.06.13 -
-----
Qu range .... 650.0 - 1700.0 C    Ao 1 source ..... quotient
Qu epsilon ratio ..... 100.0 %    Ao 1 scale .. 650.0 - 1700.0 C
Qu check L2 rel.limit 10.00 %     Ao 1 current .....4-20 mA
Qu abs.limit 650 C @ 50.00 %      Ao 2 source ..... off
Qu linearization ..... off
Qu filter ..... 0.10 s
Qu memory type ..... off         Do 1 source ..... ready-signal
                                   Do 1 function level/signal

Unit ..... Celsius               Do 1 delay time ..... 0.00 s
Terminal assigned to ..... USB    Do 1 hold time ..... 0.00 s
Autoprint ..... off              Do 2 source ..... off
Print cycle time ..... 0.1 s
Protocol address ..... 001
Display ..... active
Key lock ..... off
Status LED ... assigned to Do 1
Pilot1. .... internal 2min
-----
>
```

Слева в верхнем углу перечислены все параметры для регистрации измеренных значений канала соотношения [Quotient]. В правой колонке указана конфигурация I/O. Слева внизу представлен перечень общих настроек.

12.3 Описание подчинённых меню («Подменю»)

12.3.1 Регистрация результатов измерений Канал соотношения коэффициентов излучения [Q]

Submenu QUOTIENT

```
-----  
Qu epsilon ratio ..... 100.0 %  
Qu check L2  rel.limit  10.00 %  
Qu abs.limit   650 C @  50.00 %  
Qu linearization ..... off  
Qu filter ..... 0.10 s  
Qu memory type ..... off
```

E: Epsilon
U: [Q-CHECK]
L: [LINEARIZATION]
F: Filter
M: [MEMORY]
P: Show parameter
Q: Show calibration data
O: Show signal intensity
X: Show measure temperatures
Y: Show premax measure temps.
ESC: Back to MAIN-MENU

```
-----  
>QUOTIENT >
```

12.3.2 Регистрация результатов измерений Спектральный канал 1

Вызов всех параметров для регистрации результатов измерений спектрального канала 1 осуществляется с помощью кнопки "1".

Submenu LAMBDA 1

```
-----  
L1 epsilon ..... 99.6 %  
L1 transmission ..... 100.0 %  
L1 backc. .. ..... off  
L1 linearization ..... off  
L1 filter ..... automatic  
L1 memory type ..... off
```

E: Epsilon
T: Transmission
B: Background-Compensation
L: [LINEARIZATION]
F: Filter
M: [MEMORY]
P: Show parameter
Q: Show calibration data
X: Show measure temperature
Y: Show premax measure temps.
ESC: Back to MAIN-MENU

```
-----  
>LAMBDA 1 >
```

12.3.3 Регистрация результатов измерений Спектральный канал 2

Вызов всех параметров для регистрации результатов измерений спектрального канала 2 осуществляется с помощью кнопки "2".
Регулируемые параметры аналогичны спектральному каналу 1!

12.3.4 Быстрое переключение Коэффициент излучения / Фильтр / Калибровка Ao 1

Команды «E», «A», «T», «Y» и «Z» обеспечивают непосредственный доступ к функциям коррекции коэффициента излучения, функции сглаживания, источнику Ao1 и калибровке.

12.3.5 Конфигурация I/O

Настройка входов и выходов выполняется в «подменю» с помощью «C»:

```
-----  
Submenu I/O  
-----
```

```
A: [ANALOG OUT 1]  
B: [ANALOG OUT 2]  
C: [DIGITAL OUT 1]  
D: [DIGITAL OUT 2]  
I: [ANALOG IN]  
M: [OPTIONS]  
ESC: Back to MAIN-MENU  
-----
```

```
>I/O >
```

В данном «подменю» перечислены возможные варианты настройки для отдельных входов и выходов.

Аналоговый выход 1:

```
-----  
Submenu ANALOG OUT 1  
-----
```

```
Ao 1 source ..... quotient  
Ao 1 scale .. 650.0 - 1700.0 C  
Ao 1 current .....4-20 mA
```

```
S: Set source  
A: Set scale begin  
B: Set scale end  
C: Set scale 0-20/4-20mA  
X: Set Ao 1 fix to mA value  
Y: Set Ao 1 fix to temp value  
ESC: Back to MAIN-MENU  
-----
```

```
>I/O >ANALOG OUT 1 >
```

```
>I/O >ANALOG OUT 1 >S
```

```
Set Analog Out 1 SOURCE:  
1: Lambda 1
```

2: Lambda 2
3: Quotient

Your choice>

Переключаемый выход 1:

Submenu DIGITAL SWITCH OUT 1

Do 1 source ready-signal
Do 1 function level/signal
Do 1 delay time 0.00 s
Do 1 hold time 0.00 s

S: Set source
F: Set function
D: Set delay time
O: Set hold time
ESC: Back to MAIN-MENU

>I/O >DIGITAL SWITCH OUT 1 >

>I/O >DIGITAL SWITCH OUT 1 >S

Set Digital Switch Out 1 SOURCE:

0: Off
1: Ready-Signal
2: Lambda 1
3: Lambda 1 premax
4: Lambda 2
5: Lambda 2 premax
6: Quotient
7: Quotient premax
8: Signal intensity
9: Dirt Alert
10: Ambient Temperature

Your choice>

В подменю «OPTIONS» существует возможность, кроме прочего, отрегулировать функцию блокировки кнопок пирометра. Если блокировка активирована, то при нажатии одной из кнопок пирометра идёт опрос кода. Для полного доступа необходимо установить код P100. При неправильном вводе кода параметры можно увидеть, но изменить их нельзя.

Submenu OPTIONS

Status LED ... assigned to Do 1
Autoprint off
Print cycle time 0.1 s
Protocol address 001
Display active
Key lock off
Unit Celsius
Pilot1. internal 2min

L: Set Status LED function
A: Set autoprint function
T: Set output cycle time
P: Set protocol-address

D: Set display function
E: Set key lock
G: Set pilot light function
H: Set pilot light timeout
F: Set unit Celsius/Fahrenheit
R: Restart Pyrometer
ESC: Back to MAIN-MENU

>I/O >OPTIONS >

12.3.6 Автоматическая выдача измерительных значений:

Для непрерывной передачи измерительных значений через серийный интерфейс необходимо включить режим автоматической выдачи измерительных значений.

В подменю «OPTIONS» функция подключается или отключается с помощью команды «A». С помощью команды «T» регулируется время цикла, в течение которого будет происходить выдача актуальных измеренных значений через серийный интерфейс.

При автоматической выдаче измеренных значений параметры прибора не переносятся; пирометр переносит актуальные температурные значения непосредственно в течение отрегулированного времени цикла.

12.3.7 Дополнительная калибровка в лаборатории

При необходимости существует возможность дополнительной калибровки пирометра через меню калибровки. Для этого после ввода команды «K» следует задать пароль «100».

Вход в меню калибровки:

Submenu CALIBRATION

Name "Pyrometer PA Series"

0: [QUOTIENT CALIBRATION]
1: [LAMBDA 1 CALIBRATION]
2: [LAMBDA 2 CALIBRATION]
A: Reset settings to factory default
S: Set pyrometer name
Z: End Calibration-Mode
ESC: Back to MAIN-MENU

>CALIBRATION >

Submenu QUOTIENT

Qu range 650.0 - 1700.0 C
Qu User calibration off
Qu User def. offset +0.00000
Qu User def. factor +1.00000

A: Set Qu - extended-range

B: Set Qu User-Cal. On/Off
 C: Set Qu User-Cal. Offset
 D: Set Qu User-Cal. Factor
 ESC: Back to MAIN-MENU

 >CALIBRATION >QUOTIENT >

Все выполненные настройки можно отменить. Возврат к регулировкам изготовителя осуществляется с помощью команды «А». То же самое касается параметрирования при регистрации измеренных значений, а также входов и выходов.

Через «В», «С» и «D» возможен непосредственный доступ в программу юстировки значений спектрального канала 1.




Внимание:

Для юстировки необходимы лабораторная печь и эталон для сравнения.

При неудачной попытке юстировки следует снова задать «*offset=0.0*» и «*factor=1.0*», или установить «*User-Cal.*» на "Off".

Команда «А» позволяет изменить весь измерительный диапазон пирометра, настроив его на более крупный или более мелкий по сравнению с диапазоном, отрегулированным изготовителем. При выполнении юстировки данного пирометра следует *удостовериться в том, что пирометр в состоянии выполнять измерения в пределах нового диапазона, а также проверить правильность установки новых предельных значений пирометров.* С помощью «S» можно ввести короткий текст с описанием места измерения пирометра. При необходимости данный текст можно вызвать из основного меню с помощью «Q».

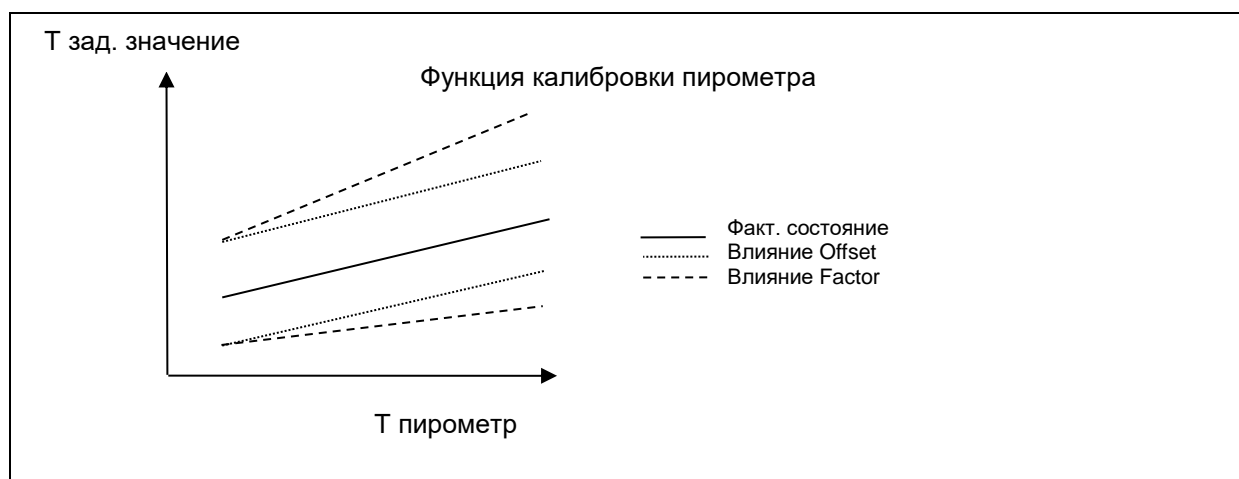

13 Экранирование и заземление

13.1 Выравнивание потенциала




Внимание:


Строгое соблюдение существующих Директив и Предписаний обязательно.

Корпус пирометра соединён с экраном с помощью соединительного штекера!

При разнице потенциалов между точками заземления по присоединённому с двух сторон экрану возможно прохождение переходного тока.

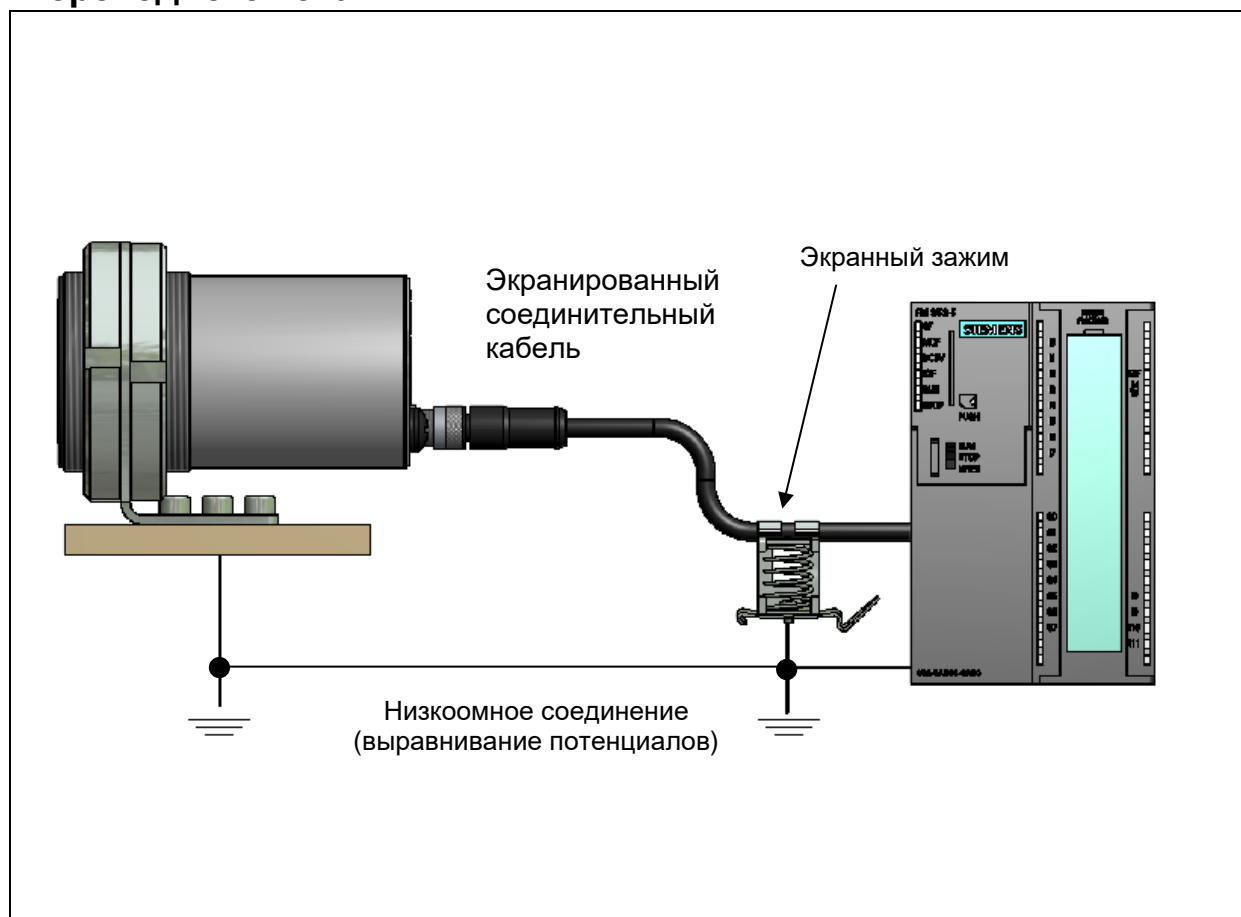

В таком случае для выравнивания потенциалов следует проложить дополнительный провод.

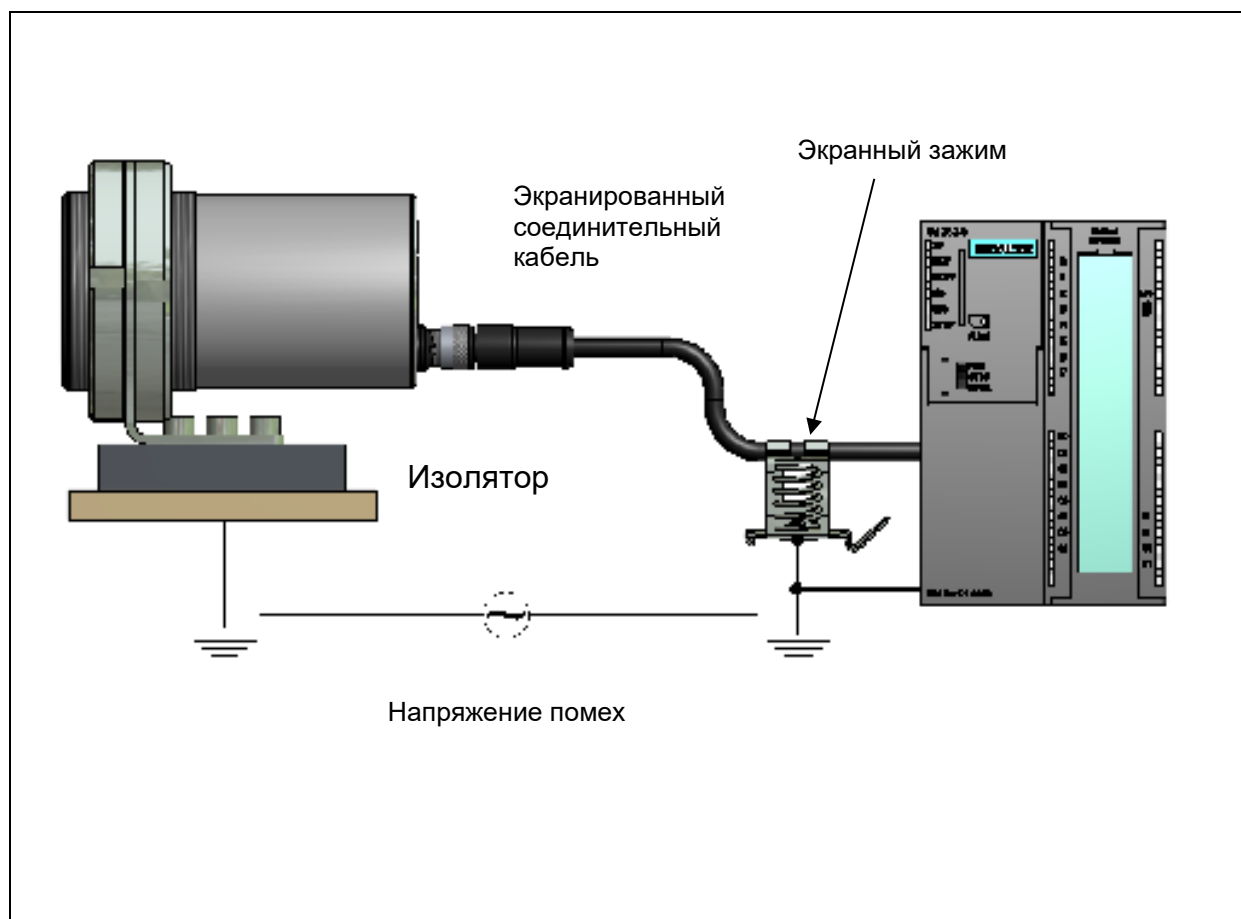

Во избежание прохождения переходного тока можно выполнять монтаж пирометра изолированно. Экран должен быть соединён с заземлением




Внимание:

Без изолированного монтажа и без выравнивания потенциалов максимальное напряжение помех допустимо до 48 В.

14 Примеры контактных выводов

14.1 Соединение с помощью кабеля Тип VK 02/A

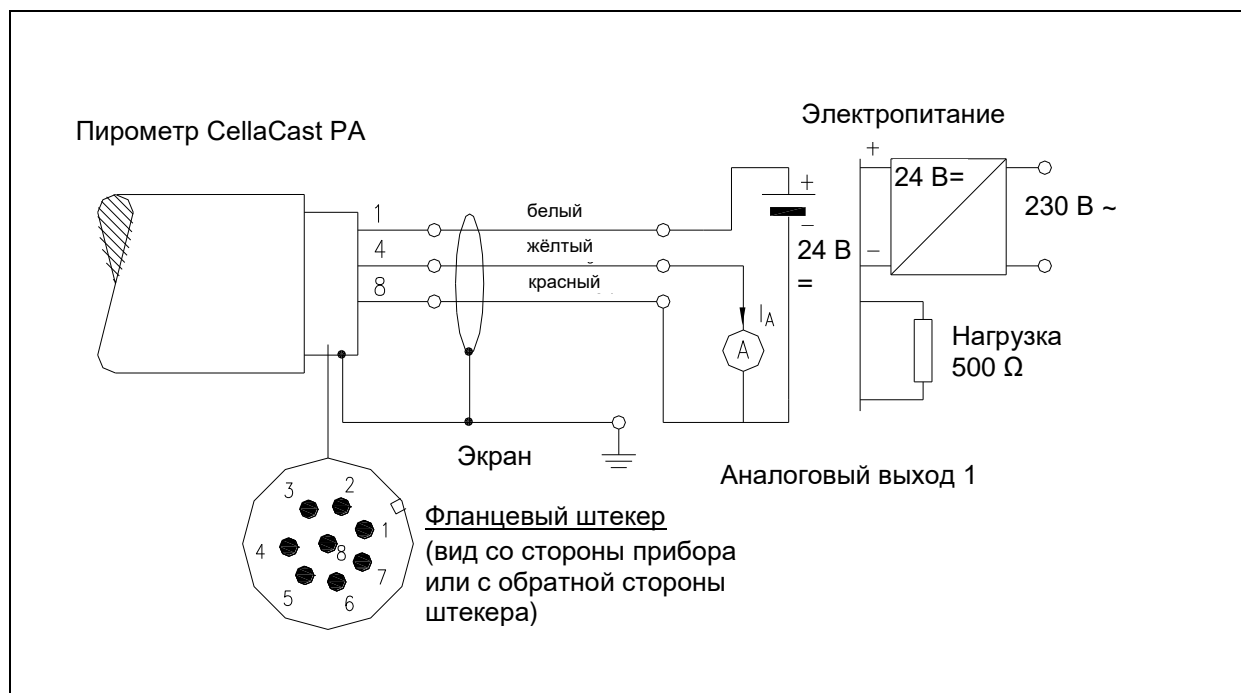

Пример контактных выводов PA

15 Принцип бесконтактного измерения температуры

Каждое вещество в любом своём физическом состоянии с температурой выше абсолютного нуля излучает тепло в окружающее пространство. Излучение возникает в результате колебаний атомов или молекул.

В рамках широкого спектра электромагнитного излучения диапазон такого теплового излучения ограничен. Он простирается от диапазона видимого света 0,5 μm до диапазона инфракрасного излучения с длиной волн больше 40 μm . Пирометры серии CellaCast PA используют это излучение для бесконтактного измерения температуры.

15.1 Преимущества бесконтактного измерения температуры

Бесконтактное измерение температуры означает экономически выгодный принцип измерения температуры, позволяющий вкладывать денежные средства только в измерительный прибор без расходов на дополнительные материалы, такие как, например, термоэлементы.

Кроме того, существует возможность быстрого измерения температуры движущихся объектов в автоматическом режиме – в диапазоне миллисекунд (мс), например, при процессах сварки.

Измерения малогабаритных предметов в пределах средних и высоких температур также не представляют собой никаких проблем. При бесконтактном измерении температуры, по сравнению с контактным, у измерительных объектов с маленькой теплоёмкостью искажений из-за теплоотдачи не возникает. Кроме того, бесконтактное измерение температуры возможно у расплавов агрессивных материалов в тех случаях, когда использование термоэлементов ограничено.

И, наконец, существует возможность измерения температуры объектов, находящихся под напряжением.

15.2 Измерения температуры абсолютно чёрного тела

Шкалу пирометра градуируют для измерения температуры с помощью абсолютно чёрного тела, так как интенсивность излучения чёрного тела зависит не от свойств материала, а только от температуры. Интенсивность теплового излучения чёрного тела при любой длине волны для соответствующей температуры является максимальной. Реальные физические тела такой способностью не обладают. Другими словами, чёрное тело поглощает все падающие на него лучи, не теряя их по причине отражения или трансмиссии.

Спектральный коэффициент излучения $\varepsilon(\lambda)$ чёрного тела равен 1 или 100 %.

Коэффициент излучения обозначает соотношение излучения реально существующего объекта измерения и интенсивности излучения идеального абсолютно чёрного тела.

$$\varepsilon(\lambda) = \frac{M}{M_s}$$

$\varepsilon(\lambda)$: коэффициент излучения объекта при длине волны λ

M : специфическая интенсивность излучения любого теплового излучателя (измеряемого объекта)

M_s : специфическая интенсивность излучения абсолютно чёрного тела

Большинство печей (обжигательные, закалочные или нагревательные) испускают излучение, которое практически равно '1', что соответствует условиям абсолютно чёрного тела в том случае, если измерения проводятся через сравнительно небольшое отверстие.

15.3 Измерения температуры реально существующих объектов

Реальные излучатели характеризуются соотношением испускаемого излучения к интенсивности излучения абсолютно чёрного тела такой же температуры. При измерениях объектов вне печи измеренная температура оказывается слишком низкой. Значительные погрешности измерений могут возникать у объектов с отражающей, блестящей или светлой поверхностью, у свободных от окислов металлов и расплавов, а также у керамических материалов. Для достижения точности результатов измерений у пирометра серии

CellaCast PA необходимо отрегулировать значения излучательной способности.

Спектральный коэффициент излучения любого тела не является точной константой материала, поскольку зависит от свойств его поверхности.

16 Коммуникационные интерфейсы

16.1 Последовательный интерфейс USB 2.0

Прибор CellaCast PA оснащён серийным интерфейсом, который соответствует нормам USB 2.0. Его можно подключить к компьютеру через обычный серийный порт. Для обслуживания в качестве программного обеспечения достаточно программы терминала, поскольку коммуникационное программное обеспечение уже интегрировано в каждом приборе. В некоторых версиях Windows программа обслуживания терминала является стандартом.


- Windows® 95 / 98 / NT / XP:
Пуск / Программы / Принадлежности / Гипертерминал / Задать название / Прямое соединение через Com / Установка параметров
- Windows® Vista / Windows® 7:
Гипертерминал в комплект поставки не включён.
Альтернативой гипертерминала является программа PuTTY. PuTTY является программным обеспечением с открытым исходным кодом «Open Source». Для загрузки доступ к ней возможен через ссылку: www.putty.org.

CellaCast PA подключается к интерфейсу компьютера с помощью стандартного кабеля USB, который входит в комплект поставки. В автоматическом режиме операционная система Windows® не способна узнавать пирометр. Необходимый драйвер для загрузки можно найти под следующей ссылкой:

www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 готова к скачиванию.
(PL2303 Prolific Driverinstaller.zip vxx)


16.2 Виртуальный порт COM

При использовании адаптера USB // RS232 Microsoft WINDOWS автоматически присваивает ему определённый порт COM. Для того, чтобы было понятно, какой порт COM имеется в виду, следует при нажатой кнопке Windows нажать кнопку «R», набрать в появившемся окне приказ „devmgmt.msc“

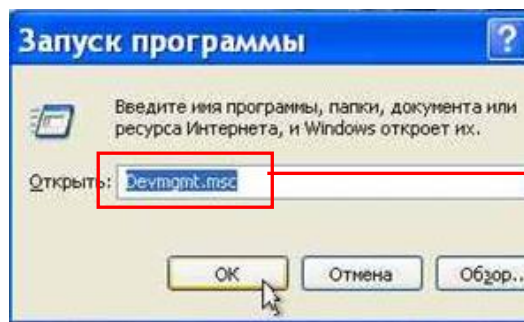

и подтвердить ОК.

Включается диспетчер устройств. После нажатия на

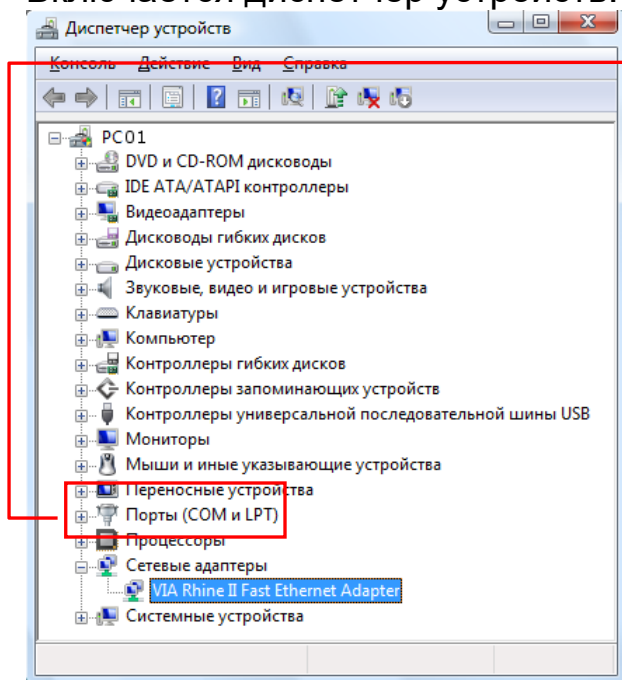

+ - знак портов (COM и LPT) подключённые интерфейсы появляются на дисплее. Адаптер RS232 // USB появляется в качестве порта *USB-to-Serial Comm*. Например, если данному адаптеру присвоен COM Port 5, необходимо настроить его в качестве интерфейса в используемом программном обеспечении.

16.3 Серийный интерфейс RS 485

CellaCast PA имеет совместимый со стандартом RS485 интерфейс, позволяющий непосредственное соединение «точки к точке», поскольку в пирометре уже интегрированы необходимые согласующие нагрузочные резисторы. Линия связи является помехоустойчивой и может достигать несколько сотен метров. Для подключения к компьютеру необходима интерфейсная плата RS485 или преобразователь уровня RS232 - RS485. Для удлинения линии связи в данном случае рекомендуется преобразователь с интегрированной гальванической развязкой для того, чтобы избежать проблем с контурами заземления. Подключение описано в 4 разделе.

В соответствии с нормами RS485 максимальное расстояние линии связи допускается до 1200 м (при 57600 бод). При длинах, превышающих 100 м, следует учитывать падение напряжения в том случае, если оно подведено по одному и тому же проводу.

16.4 Последовательная передача измеренных значений

Параметры интерфейса:

57600 бод / 8 битов данных / Odd паритет / 1 стоп бит / без подтверждения;

Формат температуры (1 цикл): состоит из:

Канал соотношения - лямбда 1 - лямбда 2

Байт	Отрицательная температура	Положительная температура	Превышение диапазона измерений	Диапазон измерений достигнут
1	Знак пробела	Знак пробела	Знак пробела	Знак пробела
2	Знак минуса-	Знак пробела	Знак минуса-	Знак минуса-
3	1000-ая	1000-ая	O	U
4	100-ая	100-ая	V	N
5	10-ая	10-ая	E	D
6	1-ая	1-ая	R	E
7	Десятичная точка.	Десятичная точка.	Знак пробела	R
8	Разряд десятичной дроби	Разряд десятичной дроби	Знак пробела	Знак пробела
9	Знак пробела	Знак пробела	Знак минуса-	Знак минуса-
10	Единица температуры С или F	Единица температуры С или F	Знак пробела	Знак пробела
11	Табулятор	Табулятор	Табулятор	Табулятор
12	Знак пробела	Знак пробела	Знак пробела	Знак пробела
13	Знак минуса -	Знак пробела	Знак минуса-	Знак минуса-
14	1000-ая	1000-ая	O	U
15	100-ая	100-ая	V	N
16	10-ая	10-ая	E	D
17	1-ая	1-ая	R	E
18	Десятичная точка.	Десятичная точка.	Знак пробела	R
19	Разряд десятичной дроби	Разряд десятичной дроби	Знак пробела	Знак пробела
20	Знак пробела	Знак пробела	Знак минуса-	Знак минуса-
21	Единица температуры С или F	Единица температуры С или F	Знак пробела	Знак пробела
22	Табулятор	Табулятор	Табулятор	Табулятор
23	Знак пробела	Знак пробела	Знак пробела	Знак пробела
24	Знак минуса-	Знак пробела	Знак минуса-	Знак минуса-
25	1000-ая	1000-ая	O	U
26	100-ая	100-ая	V	N
27	10-ая	10-ая	E	D
28	1-ая	1-ая	R	E
29	Десятичная точка.	Десятичная точка.	Знак пробела	R
30	Разряд десятичной дроби	Разряд десятичной дроби	Знак пробела	Знак пробела
31	Знак пробела	Знак пробела	Знак минуса-	Знак минуса-
32	Единица температуры С или F	Единица температуры С или F	Знак пробела	Знак пробела
33	Возврат каретки	Возврат каретки	Возврат каретки	Возврат каретки

Указание: Все знаки кодированы в формате ASCII; ведущие нули переносятся

Время цикла передачи температуры можно отрегулировать через терминал (мин. длительность цикла 0,1 сек.).


16.5 Последовательный интерфейс RS 485

Во время протокольной эксплуатации к шине RS 485 можно подключить максимально 31 пирометров. Мастер, например, программа CellaView управляет коммуникацией на шине и заставляет подключенные пирометры посылать или принимать данные. Каждый участник имеет свой определённый адрес, с помощью которого ведётся коммуникация между мастером и прибором. Адрес устанавливается с помощью кнопок во время пуско-наладочной настройки.


Кодовая страница: с 0 ! !

Addr.	Адрес прибора	Адрес интерфейса для протоколирования
-------	---------------	---------------------------------------

Шина интерфейса RS 485 состоит из двухжильного кабеля с максимальной длиной 1200 м. и участников, которые связаны с помощью макс. 5-ти метровых тупиковых кабелей с главной шиной.

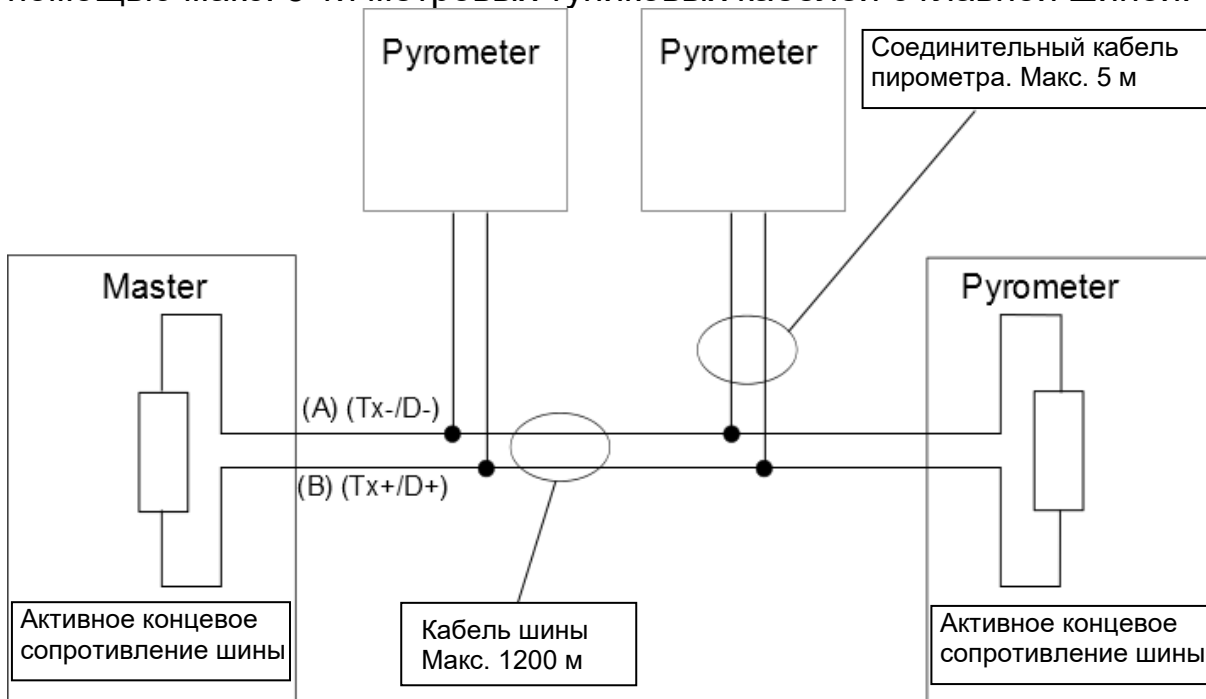

На соответствующем конце шины следует активировать концевое сопротивление. Для этого нужно переставить DIP-переключатели на позицию "ON". У остальных пирометров окончательное сопротивление должно быть отключено.

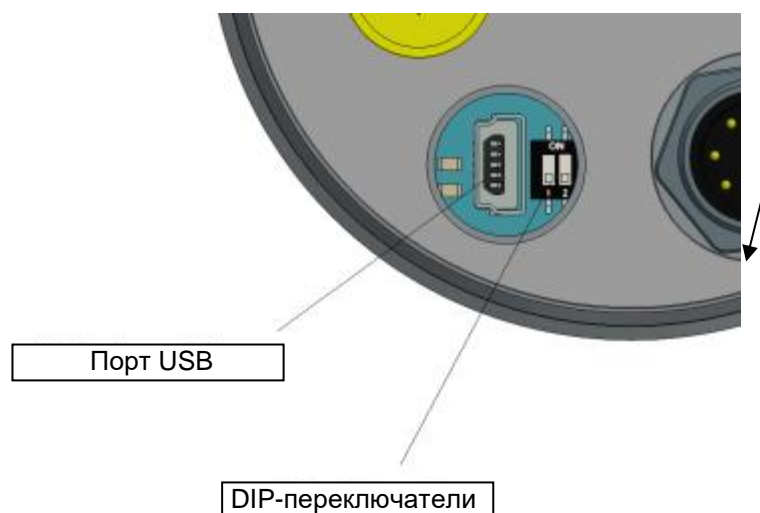

17 Уход и техническое обслуживание

17.1 Чистка линзы объектива

Загрязнение линзы объектива приводит к погрешности измерения. Поэтому линзы необходимо постоянно проверять и при необходимости чистить.

Пыль необходимо сдувать или сметать при помощи мягкой кисточки. Для чистки линзы можно использовать также имеющиеся в продаже специальные салфетки. Пригодны для этой цели и другие чистые и мягкие ткани без ворсинок.

Сильные загрязнения можно удалять с помощью специального средства для мытья посуды или жидкого мыла, которые затем необходимо осторожно смыть чистой водой; пирометр при этом следует держать линзой вниз.

Во избежание нанесения на поверхность линзы царапин при чистке следует избегать сильного давления на линзу.

Следует следить за тем, чтобы при отвинчивании присоединяемой оптики или объектива для чистки и их повторном привинчивании пирометр был выключен. В противном случае возможно повреждение прибора!

Примечание:

Необходимо предохранять пирометр от перегрева, попадания влаги, высокого напряжения и сильных электромагнитных полей. Объектив ни в коем случае нельзя направлять на солнце.

18 Технические характеристики PA 80 AF 6

Диапазон измеряемых температур (свободно настраиваемый):
750 ... 2400 °C

Сенсор:
фотодиод

Спектральный диапазон:
0,95 / 1,05 мкм

Диапазон фокусирования:
1,2 м ... ∞ (Телеоптика)

Показатель визирования:
240 : 1 при 1200 мм
(Телеоптика 20.06)

Цифровой выход:
периодическая выдача измеренного значения с настраиваемым периодом цикла

Аналоговый выход 1 + 2:
0(4) ... 20 мА линейные, переключаемые, калибруемые (4...20 мА стандарт)

Вторичная нагрузка:
макс. 500 Ω

Время настройки t_{98} :
≤ 10 мс $T > 650$ °C)

Разрешающая способность:

- **Аналоговый выход:**
0,2 К + 0,03 % настроенного диапазона
- **Дисплей:** 1 К
- **Интерфейс USB / RS 485:**
0,1 К через терминал компьютера

Погрешность измерения:

1 % измеряемой величины (при $\varepsilon=1$ и $T_A=23$ °C)

Линеаризация:
цифровая, через микроконтроллер

Воспроизводимость: 2 К

Визирное устройство:

- сквозной видеоискатель,
- лазерный целеуказатель
- встроенная цветная видеокамера

Температура окружающей среды:
0 – 65 °C (без охлаждения)

Сигнализация перегрева:
при температуре > 80 °C происходит переключение аналогового выхода на > 20,5 мА!

Температура хранения:
-20 ... 80 °C

Допустимая влажность воздуха:
95 % относительной влажности (без конденсата)

Температурный коэффициент:
≤ 0,05 % / К от измеряемого значения [°C]
(отклонение от 23 °C)

Интерфейс:
USB / RS 485 с интегрированными указаниями для пользователя по вводу параметров и опросу измеряемых значений

Аналоговый вход:
0 – 10 В

Переключаемый выход:
2 x открытый коллектор
24 В, ≤ 30 мА

Переключаемый вход:
2 на 24 В

Источник питания:
24 В пост. тока +10% / -20%
Потребление тока ≤ 135 мА (150 мА при включённом лазерном целеуказателе или 175 мА со встроенной цветной видеокамерой)
Пульсация ≤ 200 мВ

Размеры:
Ø 65 x 220 мм (включая штекер)

Корпус:
нержавеющая сталь

Вес:
примерно 0,9 кг

Подключение:
через контактное гнездо

Степень защиты:
IP65 по норме DIN 40050 при навинченном штекере

Регулируемые параметры:

Диапазон измерений:
начальное значение и диапазон измерения регулируются

Аналоговый выход 1+2:
источник / калибровка

Переключаемый выход 1+2:
источник / точки переключения

Коэффициент трансмиссии:
 λ_1 и λ_2

Компенсация фонового излучения: λ_1 и λ_2

Таблица линеаризации:
измеренную температуру можно линеаризовать по свободно настраиваемой таблице

Соотношение коэффициента излучения:

$$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} : 80 \dots 120 \%$$

Ширина шага 0,1 %

Коэффициент излучения ε :
 λ_1 и λ_2 : 10,0 до 110 %
Ширина шага 0,1 %


Сглаживающая функция t_{98} :
0 - 999 сек.
адаптивное усреднение

Режимы хранения данных:
-мин./макс. память предельных значений
-память двойных макс. значений с настраиваемым временем хранения данных

Комплектуемое оборудование:
сертификат калибровки ISO 9001 или DKD

Широкий выбор дополнительных принадлежностей (арматура, цифровые дисплеи и т.д.)

18.1 Диаграмма поля зрения PA 80 AF 6

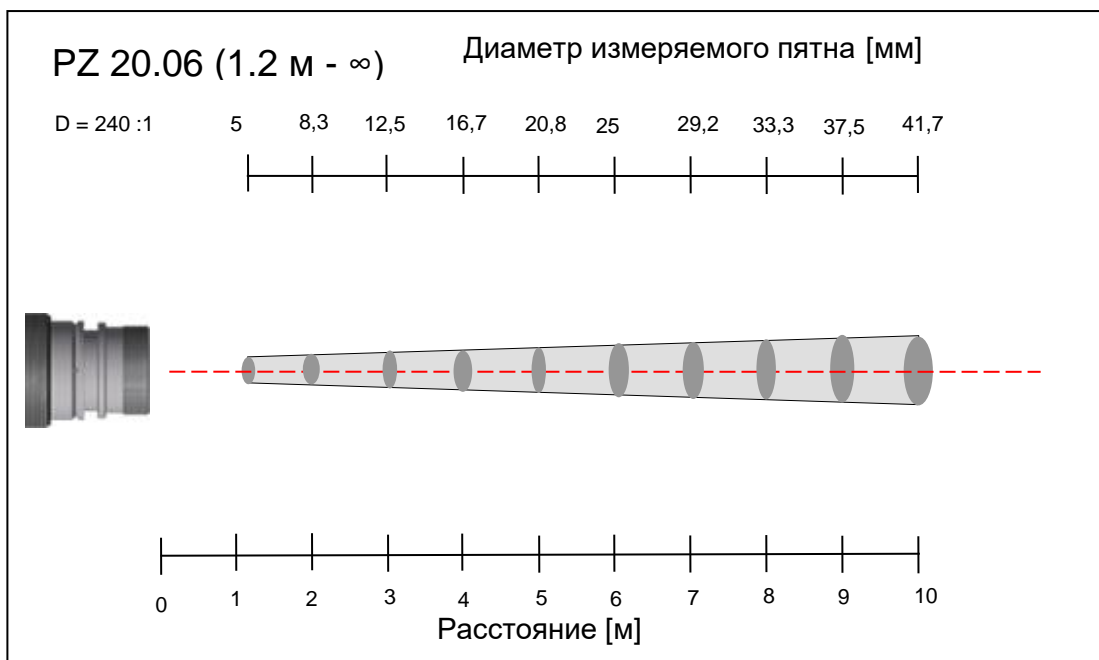

19 Технические характеристики PA 81 AF 11

Диапазон измеряемых температур (свободно настраиваемый):
800 ... 2400 °C

Сенсор: фотодиод

Спектральный диапазон: 0,95 / 1,05 мкм

Диапазон фокусирования:
0,2 м...∞ (Стандартная оптика PA 41.01 M 30)

Показатель визирования:
190 : 1 (стандартная PA 40.01)

Цифровой выход:
периодическая выдача измеренного значения с настраиваемым периодом цикла

Аналоговый выход 1 + 2:
0(4) ... 20 мА линейные, переключаемые, калибруемые (4...20 мА стандарт)

Вторичная нагрузка:
макс. 500 Ω

Время настройки t_{98} :
≤ 20 мс $T > 950$ °C

Разрешающая способность:

- **Аналоговый выход:**
0,2 К + 0,03 % настроенного диапазона
- **Дисплей:** 1 К
- **Интерфейс USB / RS 485:**
0,1 К через терминал компьютера

Погрешность измерения:
1,5 % измеряемой величины (при $\varepsilon=1$ и $T_A=23$ °C)

Линеаризация: цифровая, через микроконтроллер

Воспроизводимость: 3 К

Визирное устройство:
• лазерный целеуказатель

Температура окружающей среды:

Головка: -20 – 250 °C
Оптоволокно: -20 – 250 °C
Электроника: 0 – 65 °C

Сигнализация перегрева:
при температуре > 80 °C происходит переключение аналогового выхода на > 20,5 мА

Температура хранения:
Головка: -20 – 250 °C
Оптоволокно: -20 – 250 °C
Электроника: -20 – 80 °C

Допустимая влажность воздуха:
95 % относительной влажности (без конденсата)

Температурный коэффициент:
≤ 0,05 %/K от измеряемого значения [°C] (отклонение от 23 °C)

Интерфейс:
USB / RS 485 с интегрированными указаниями для пользователя по вводу параметров и опросу измеряемых значений

Аналоговый вход: 0 – 10 В

Переключаемый выход:
2 x открытый коллектор
24 В, ≤ 30 мА

Переключаемый вход:
2 на 24 В

Источник питания:
24 В пост. тока +10% / -20%
Потребление тока ≤ 135 мА (150 мА при включённом лазерном целеуказателе)
Пульсация ≤ 200 мВ

Размеры:
Ø 65 x 220 мм (включая штекер)

Корпус: нержавеющей сталь

Вес: примерно 0,9 кг

Подключение:
через контактное гнездо

Степень защиты:
IP65 по норме DIN 40050 при навинченном штекере

Регулируемые параметры:

Диапазон измерений:
начальное значение и диапазон измерения регулируются

Аналоговый выход 1+2:
источник / калибровка

Переключаемый выход 1+2:
источник / точки переключения

Коэффициент трансмиссии:
 λ_1 и λ_2

Компенсация фонового излучения: λ_1 и λ_2

Таблица линеаризации:
измеренную температуру можно линеаризовать по свободно настраиваемой таблице

Соотношение коэффициента излучения:

$\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$: 80 ... 120 %

Ширина шага 0,1 %

Коэффициент излучения ε :
 λ_1 и λ_2 : 10,0 до 110 %
Ширина шага 0,1 %


Сглаживающая функция t_{98} :
0 - 999 сек.
адаптивное усреднение

Режимы хранения данных:
-мин./макс. память предельных значений
-память двойных макс. значений с настраиваемым временем хранения данных

Комплектуемое оборудование:
сертификат калибровки ISO 9001 или DKD

Широкий выбор дополнительных принадлежностей (арматура, цифровые дисплеи и т.д.)


**19.1 Диаграмма поля зрения PA 81 AF 11
(Стандартная оптика PA 41.01 M30)**

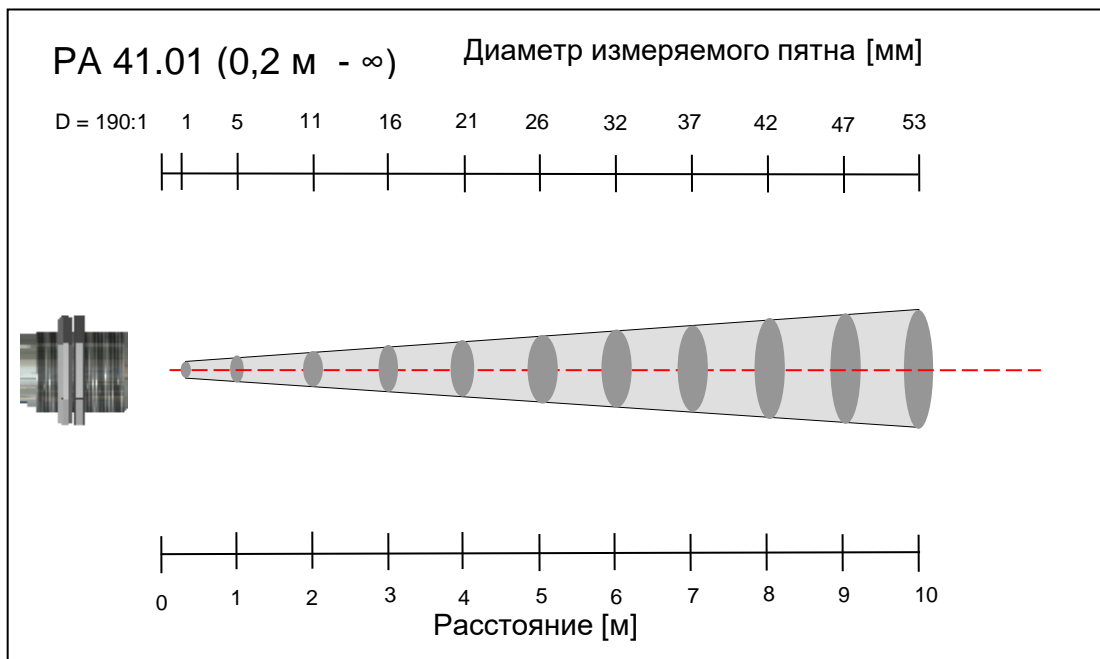


20 Общие технические характеристики PA 83

Диапазон температур настраиваемый): 650 ... 1700 °C	измеряемых (свободно	Визирное устройство: <ul style="list-style-type: none"> • сквозной видеоискатель, • лазерный целеуказатель • встроенная цветная видеокамера 	Подключение: через контактное гнездо
Сенсор: фотодиод			Степень защиты: IP65 по норме DIN 40050 при навинченном штекере
Спектральный диапазон: 0,95 / 1,05 мкм		Температура окружающей среды: 0 – 65 °C (без охлаждения)	Регулируемые параметры:
Диапазон фокусирования: 0,4 м ... ∞ (стандартная) 0,3 ... ∞ (оптика F50) 1,2 м ... ∞ (телеоптика) 0,2 м ... ∞ (широкоугольная)		Сигнализация перегрева: при температуре > 80 °C происходит переключение аналогового выхода на > 20,5 mA	Диапазон измерений: начальное значение и диапазон измерения регулируются
Показатель визирования: Стандартная оптика x AF 1 (20.01) Горизонтально 45 : 1 Вертикально 230 : 1 Оптика F50 x AF 13 (20.08) Горизонтально 30 : 1 Вертикально 150 : 1 Телеоптика x AF 3 (20.06) Горизонтально 75 : 1 Вертикально 375 : 1 Широкоугольная оптика x AF 10 (20.05) Горизонтально 10 : 1 Вертикально 55 : 1		Температура хранения: -20 ... 80 °C	Аналоговый выход 1+2: источник / калибровка
Цифровой выход: периодическая выдача измеренного значения с настраиваемым периодом цикла		Допустимая влажность воздуха: 95 % относительной влажности (без конденсата)	Переключаемый выход 1+2: источник / точки переключения
Аналоговый выход 1 + 2: 0(4) ... 20 mA линейные, переключаемые, калибруемые (4...20 mA стандарт)		Температурный коэффициент: ≤ 0,05 % / K от измеряемого значения [°C] (отклонение от 23 °C)	Коэффициент трансмиссии: λ_1 и λ_2
Вторичная нагрузка: макс. 500 Ω		Интерфейс: USB / RS 485 с интегрированными указаниями для пользователя по вводу параметров и опросу измеряемых значений	Компенсация фонового излучения: λ_1 и λ_2
Время настройки t₉₈: ≤ 10 мс		Аналоговый вход: 0 – 10 В	Таблица линеаризации: измеренную температуру можно линеаризовать по свободно настраиваемой таблице
Разрешающая способность: <ul style="list-style-type: none"> • Аналоговый выход: 0,2 K + 0,03 % настроенного диапазона • Дисплей: 1 K • Интерфейс USB / RS 485: 0,1 K через терминал компьютера 		Переключаемый выход: 2 x открытый коллектор 24 В, ≤ 30 mA	Соотношение коэффициента излучения: $\frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$: 80 ... 120 % Ширина шага 0,1 %
Погрешность измерения: 1,5 % измеряемой величины (при $\epsilon=1$ и T _A =23 °C)		Переключаемый вход: 2 на 24 В	Коэффициент излучения ϵ: λ_1 и λ_2 : 10,0 до 110 % Ширина шага 0,1 %
Воспроизводимость: 3 K		Источник питания: 24 В пост. тока +10% / -20% Потребление тока ≤ 135 mA (150 mA при включённом лазерном целеуказателе или 175 mA со встроенной цветной видеокамерой) Пульсация ≤ 200 мВ	Сглаживающая функция t₉₈: 0 - 999 сек. адаптивное усреднение
		Размеры: Ø 65 x 220 мм (включая штекер)	Режимы хранения данных: -мин./макс. память предельных значений -память двойных макс. значений с настраиваемым временем хранения данных
		Корпус: нержавеющая сталь	Комплектующее оборудование: сертификат калибровки ISO 9001 или DKD
		Вес: примерно 0,9 кг	Широкий выбор дополнительных принадлежностей (арматура, цифровые дисплеи и т.д.)

20.1 Диаграмма поля зрения PA 83 (750 – 2400 °С)

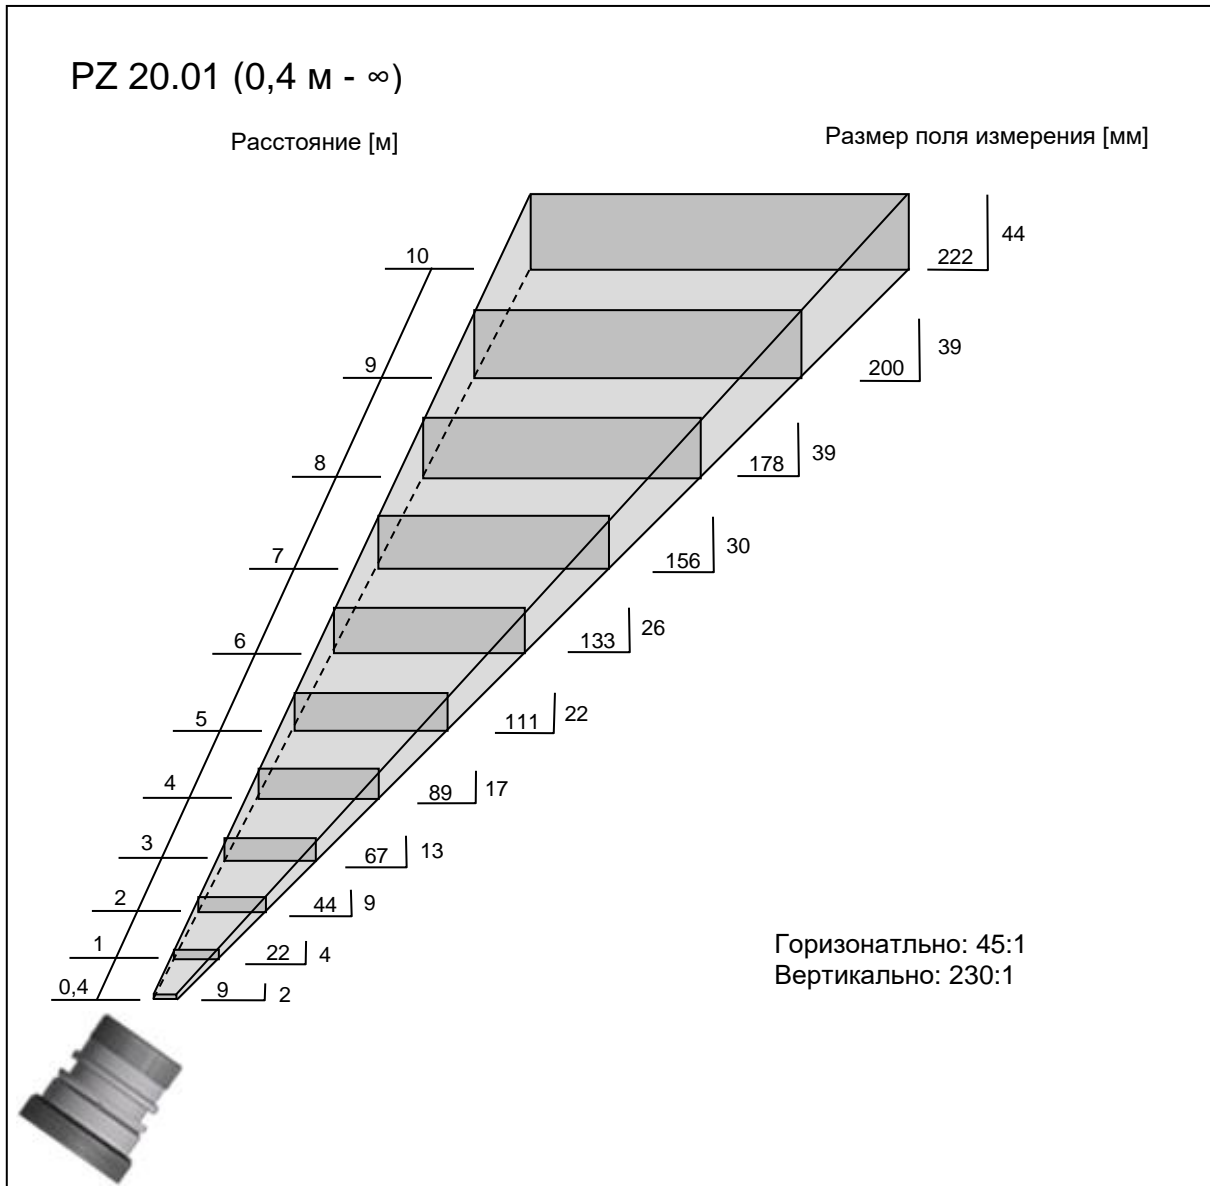


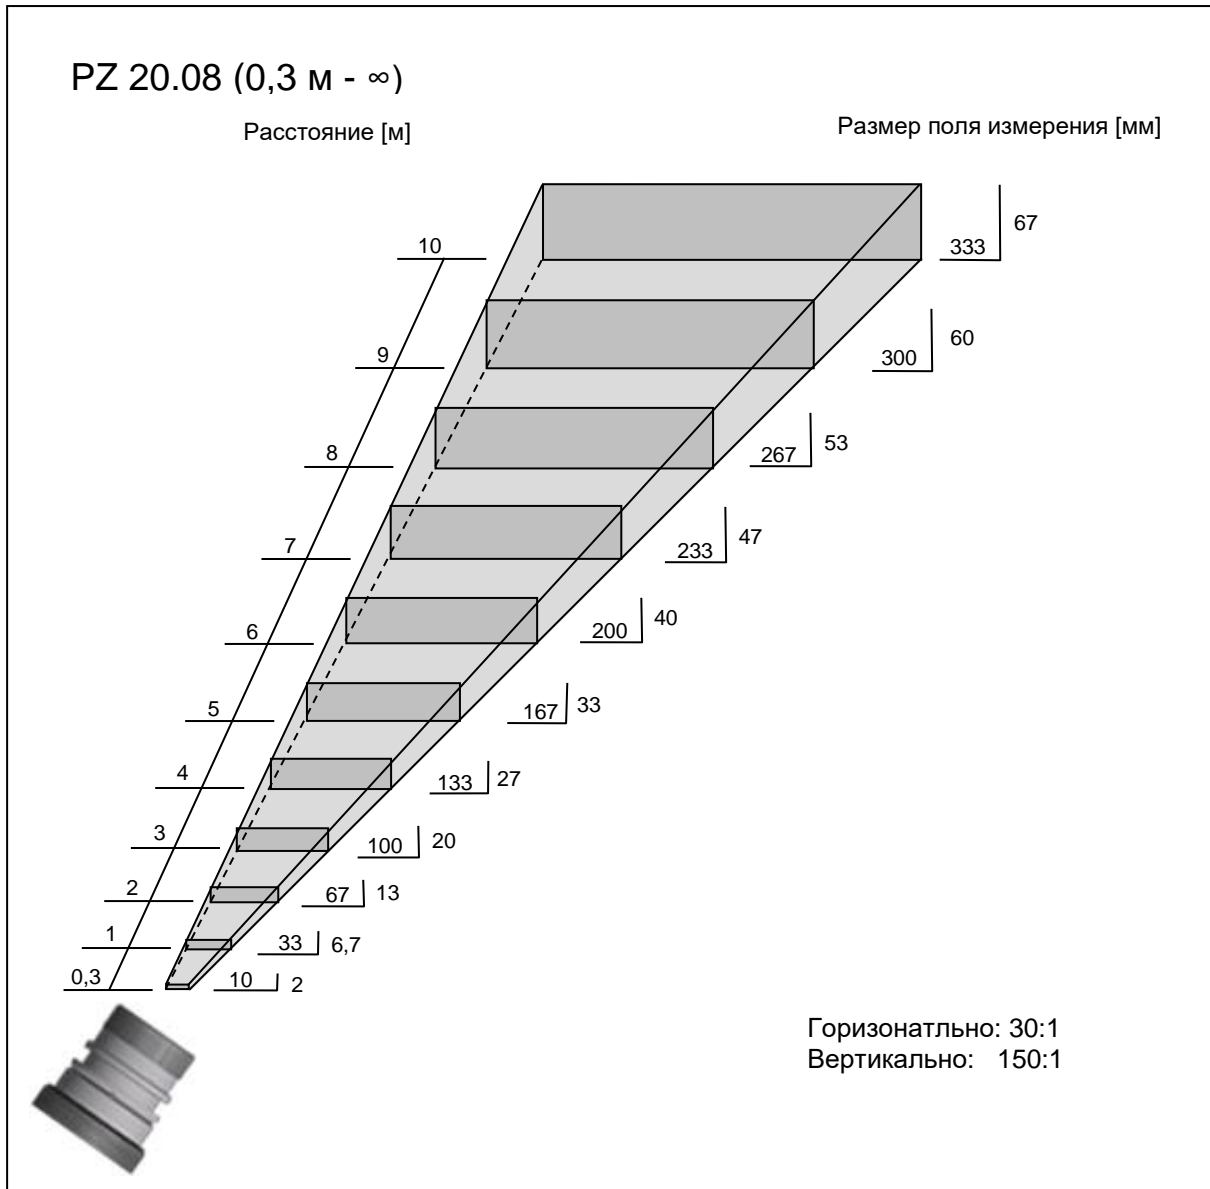


PZ 20.06 (1,2 м - ∞)

Расстояние [м]

Размер поля измерения [мм]

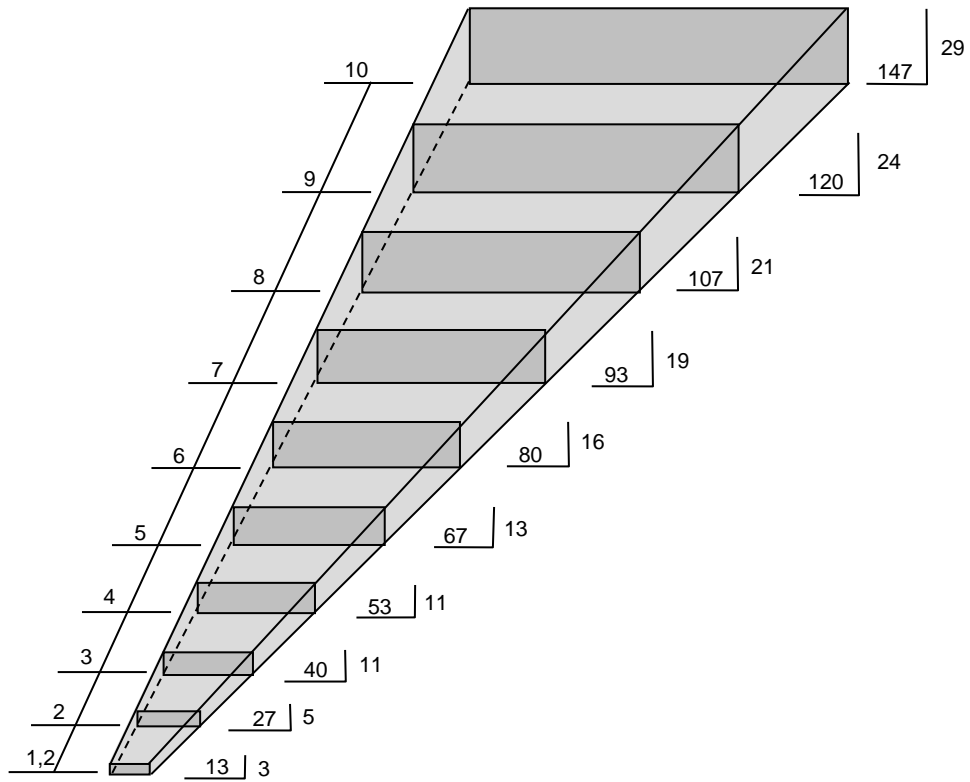


Горизонтально: 75:1
Вертикально: 375:1

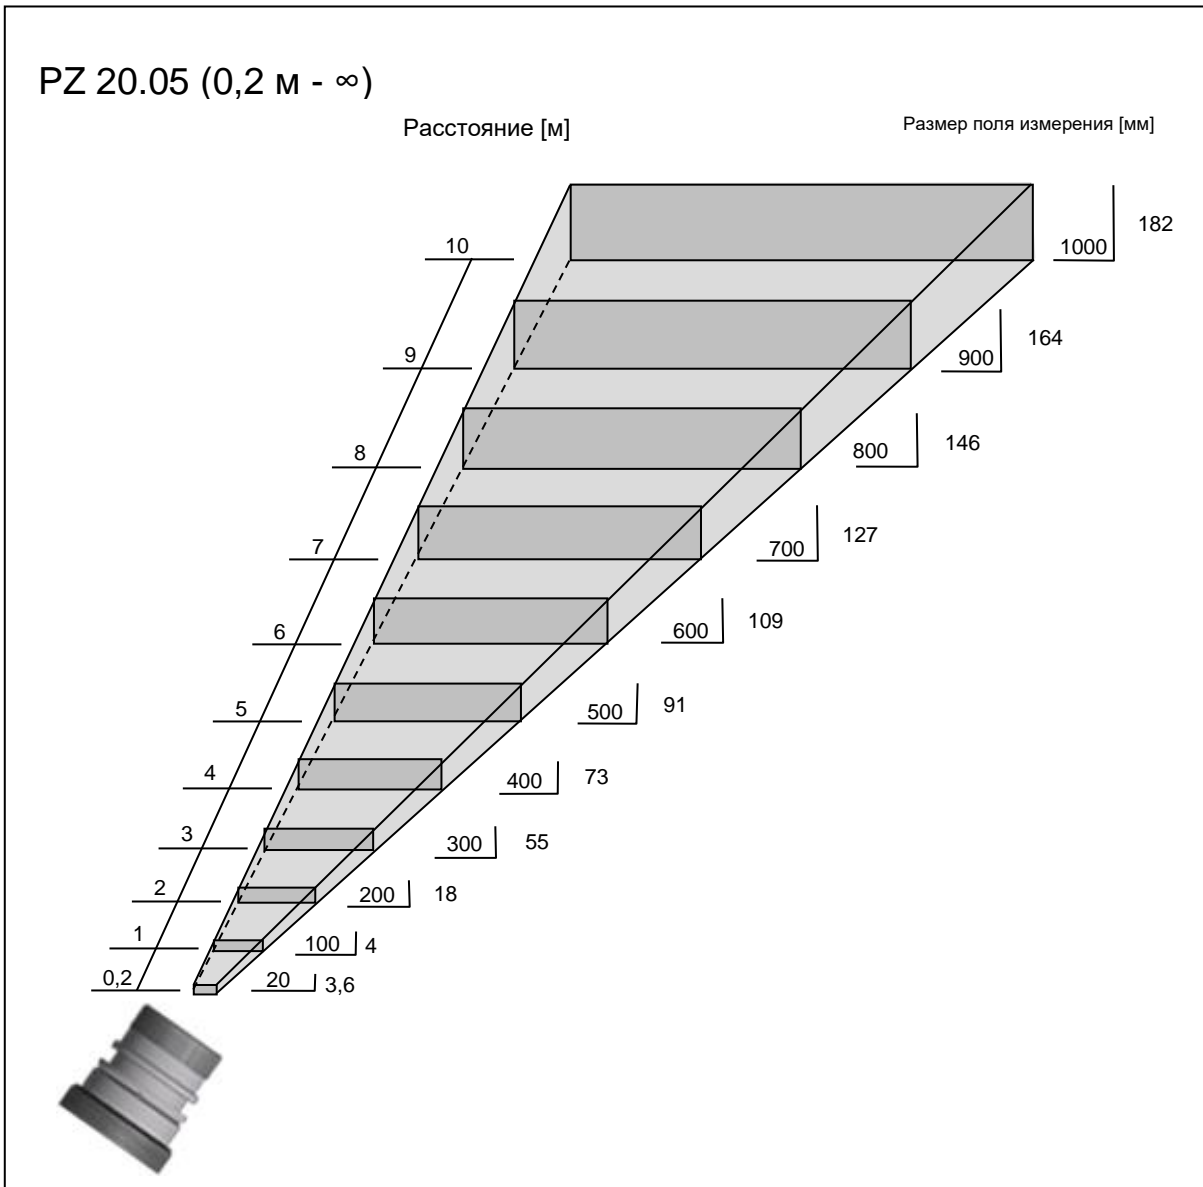


21 Габариты


21.1 Пирометр PA 80 / 83

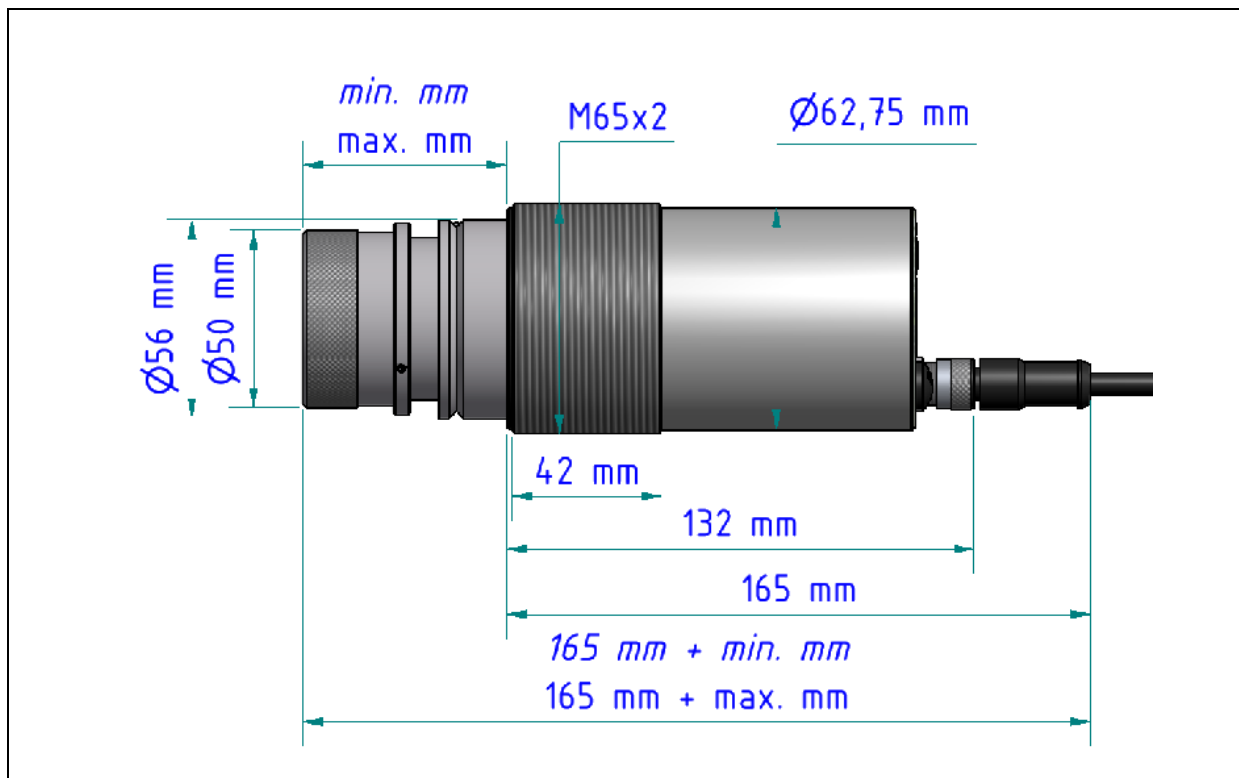

21.2 Пирометр PA 81

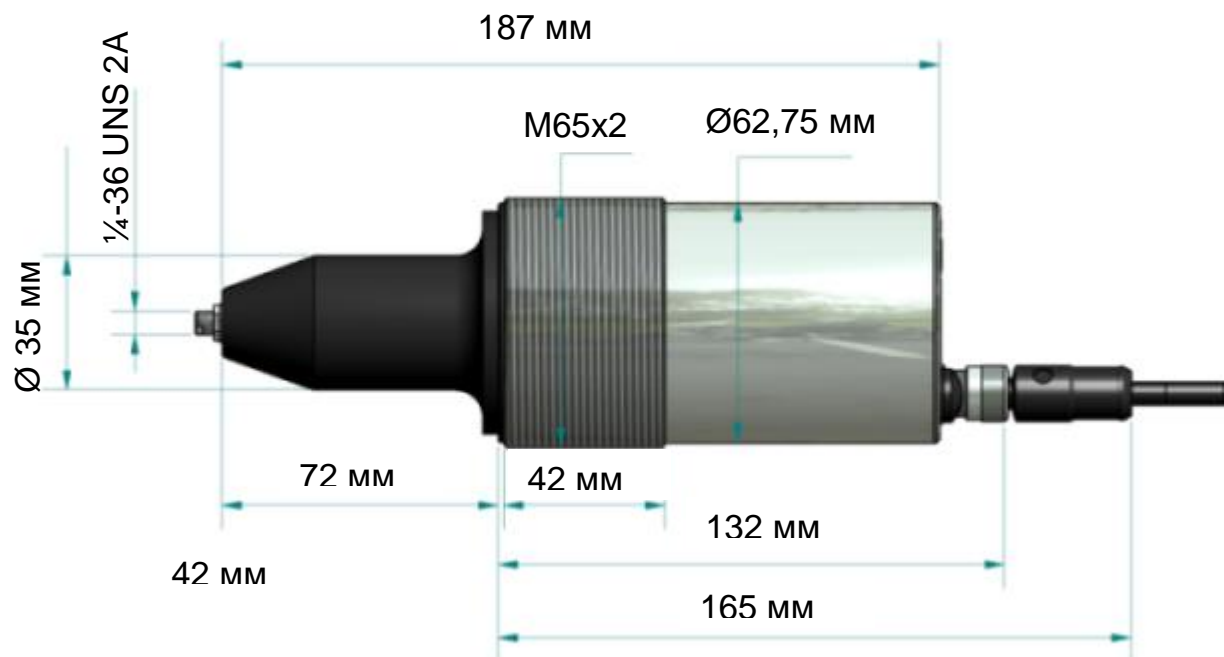


21.4 Измерительная головка PA 41.01 (M 30)

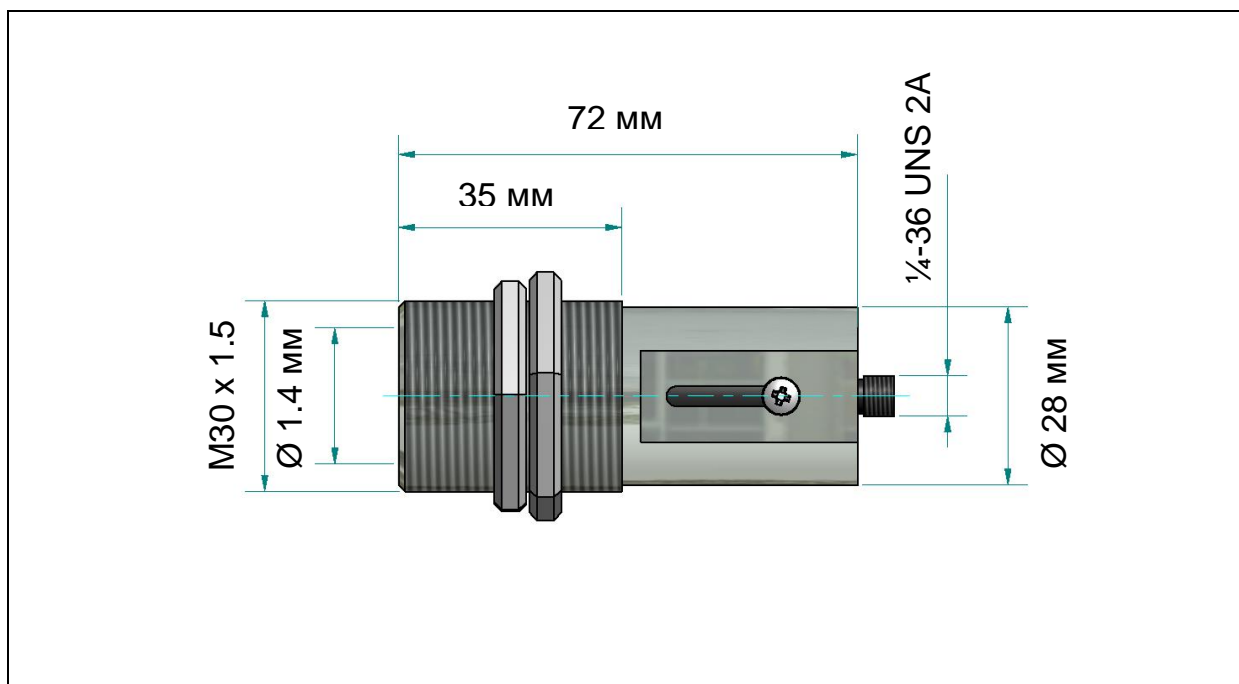

22 Технические характеристики видеокамеры

- Система ТВ: Composite Video PAL, 1 Vpp, 75 Ом
- Подключение: пирометр -> TNC гнездо, монитор-> Chinch или BNC (видеокабель VK 02/F), потенциально развязанный от электропитания пирометра.
- Разрешение: 722 x 576 пиксель
- Изображение температуры: маркировка поля измерения
- «ТВС»: регулировка экспозиции

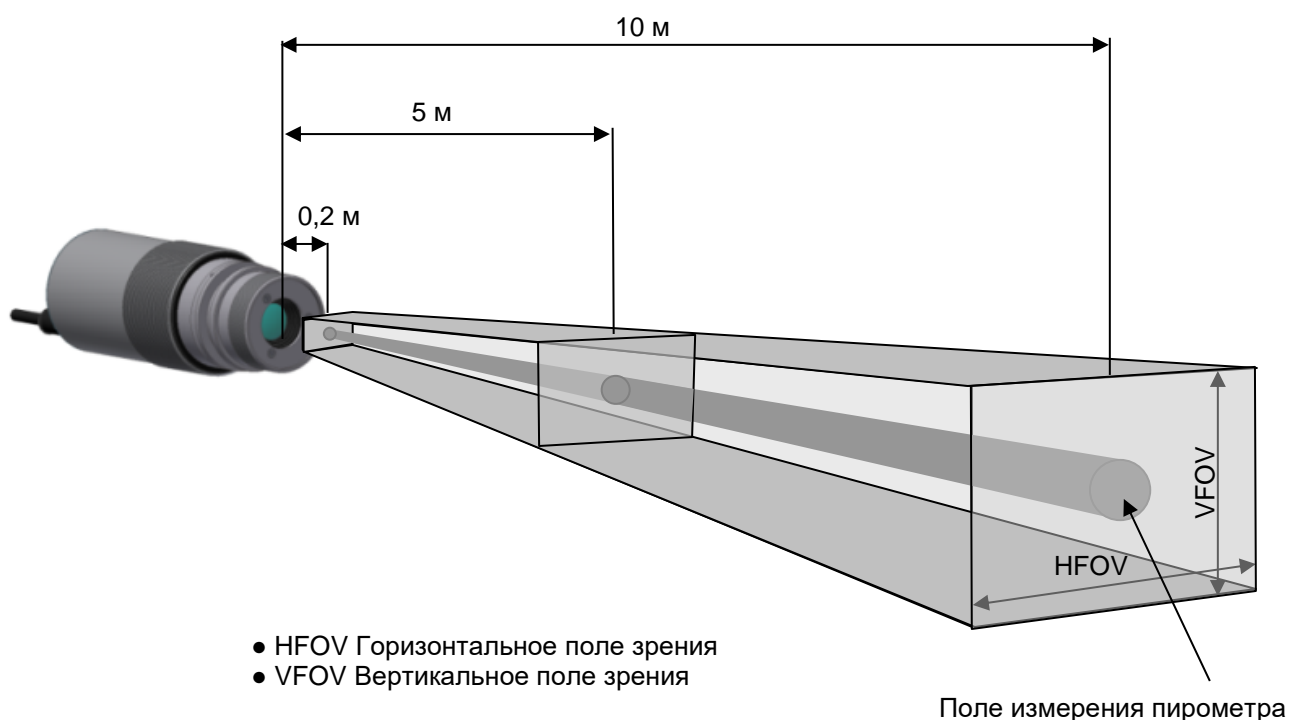

ВНИМАНИЕ!


При подключении видеокабеля VK 02/F следует обращать внимание на плотное прикручивание штекера.

Оптика		Расстояние до измеряемого объекта [м]													
		0,2	0,3	0,4	1	1,2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стандартная оптика 20.01	HFOV [мм]			16,2	44,9	54,4	92,7	140	188	236	284	332	379	427	475
	VFOV [мм]			12,1	33,7	40,8	69,5	105	141	177	213	249	285	320	356
Вариооптика 20.03	HFOV [мм]	8,5	14,1	19,8											
	VFOV [мм]	6,4	10,6	14,8											
Телеоптика 20.06	HFOV [мм]					32,5	56,4	86,3	116	146	176	206	236	266	295
	VFOV [мм]					24,4	42,3	64,7	87,1	110	132	154	177	199	222
Широкоугольная оптика 20.05	HFOV [мм]	41,7		79,4	192,6	230,3	381,2	570	759	947	1136	1324	1513	1702	1890
	VFOV [мм]	31,3		59,6	144,4	172,7	285,9	427	569	710	852	993	1135	1276	1418
Оптика F50 20.08	HFOV [мм]		19,6	26,8	69,8	84,2	142	213	285	357	428	500	572	643	715
	VFOV [мм]		14,7	20,1	52,4	63,1	106	160	214	267	321	375	429	482	536


23 Дополнительное оборудование

Описание	Тип	Артикул №
Кабель, длина 5м, 8 x 0.25 мм ² , экранированный	VK 02/A	101 3909
Видеокабель	VK 02/F	103 1446
Поляризационный фильтр	PA 20/P	100 9974
Крепёжный кронштейн	PA 11/U	100 9679
Гайка вала	KM 13	513 854
Регулируемый монтажный уголок	PA 11/K	100 7490
Кварцевое стекло	PA 20/I	1008144
Кабель USB	VK 11/D	100 9677


23.1 Регулируемый монтажный уголок PA 11 / K

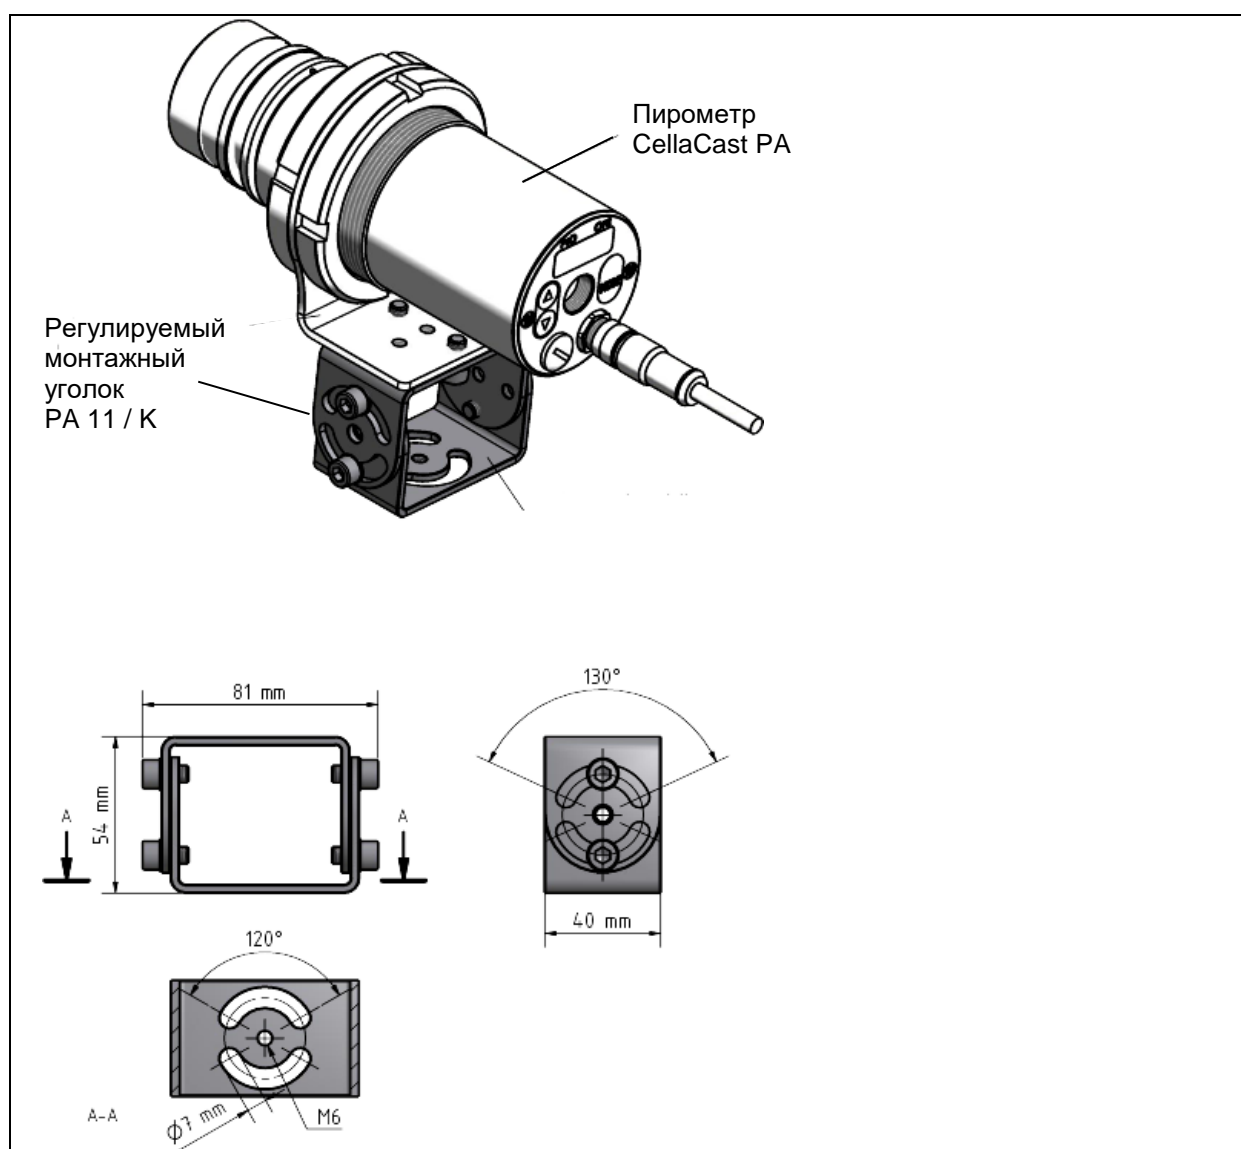

23.2 Крепёжный кронштейн PA 11 / U

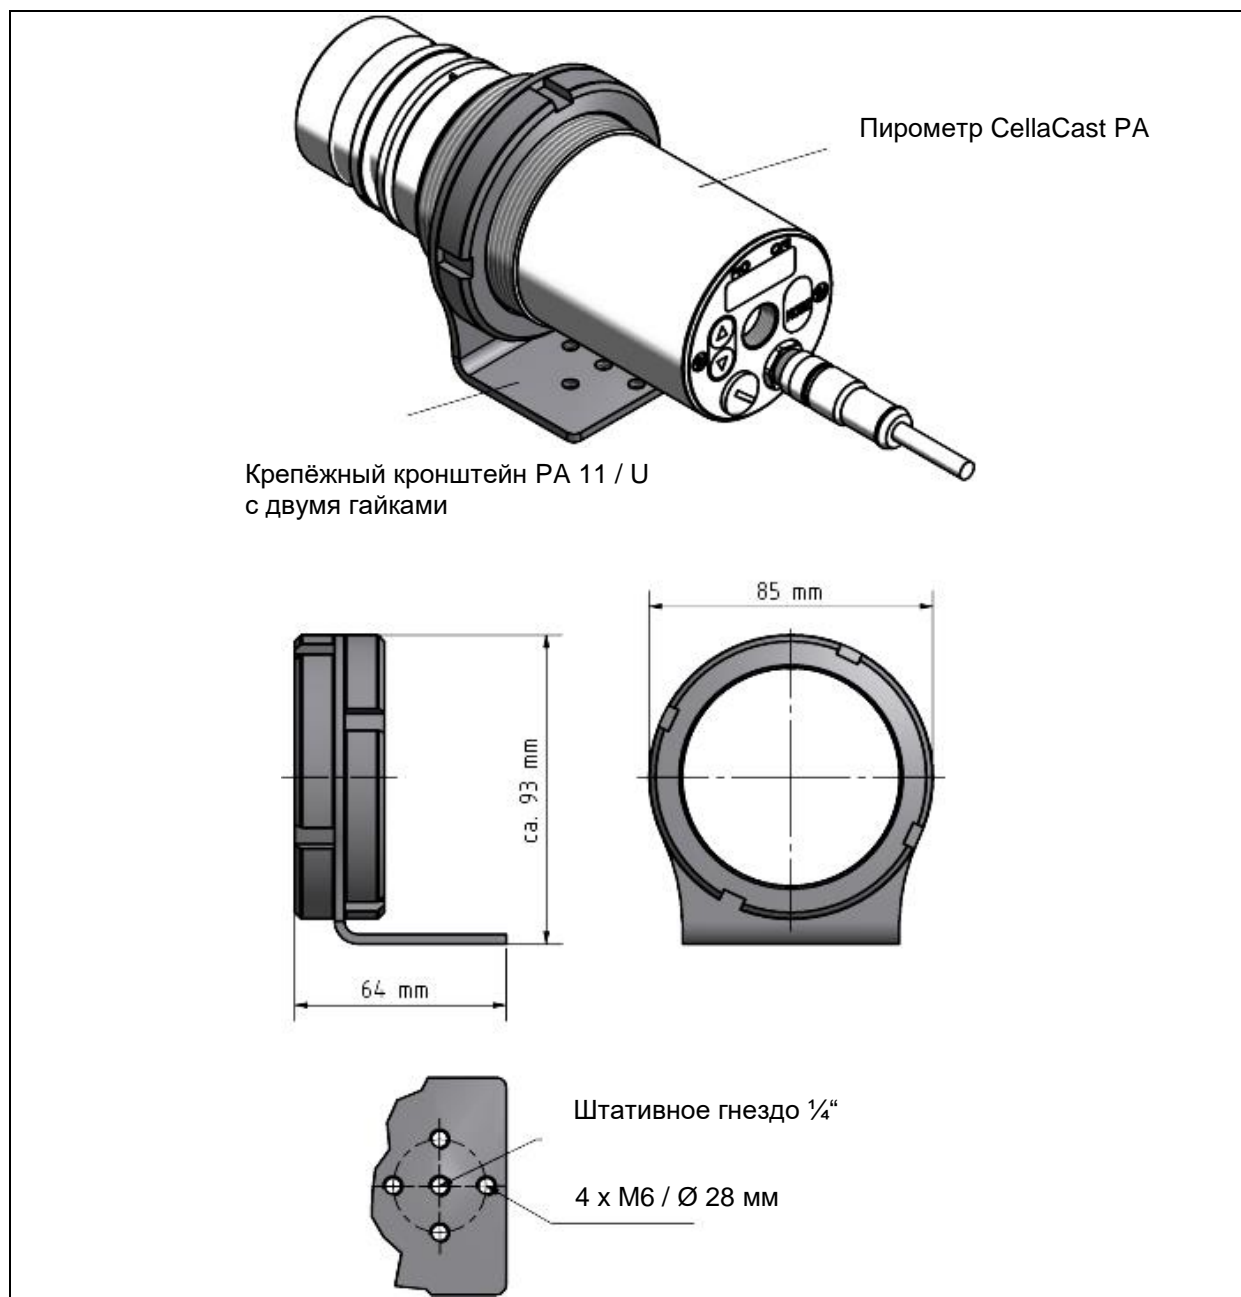

23.4 Прозрачная насадка с кварцевым стеклом PA 20 / I

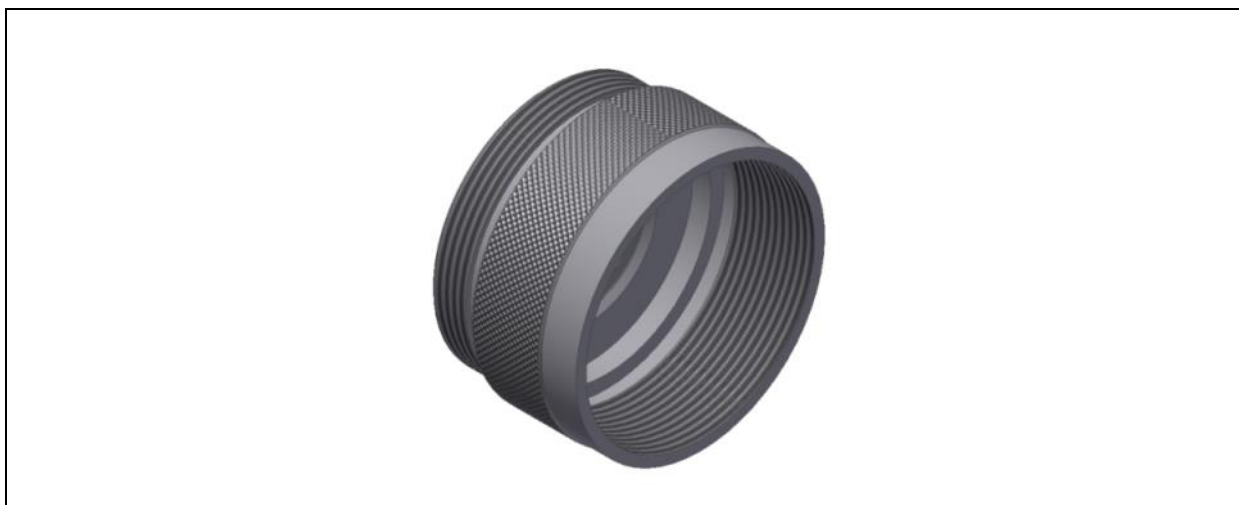

Прозрачная насадка с кварцевым стеклом для пирометра PA 40, PA 50, PA 60




ВНИМАНИЕ!

Замена защитного стекла разрешена только компетентным специалистам. При снятии защитного стекла следует носить **защитные очки и защитные перчатки.**


23.5 Кабель VK 02 / A

Артикул № 101 3909

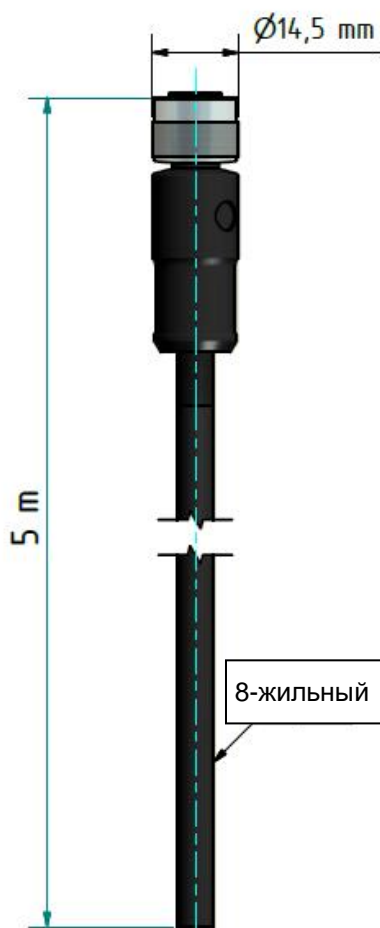

Расцветка жил	Разводка контактов
белый	1
коричневый	2
зелёный	3
жёлтый	4
серый	5
розовый	6
синий	7
красный	8

Экран заземляется на корпусе штекера

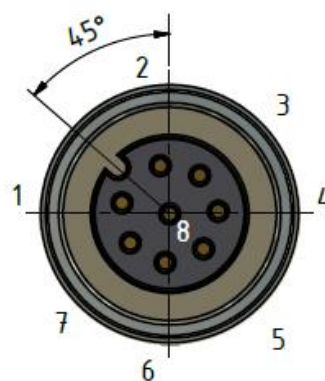


Масштаб (3:1)

Сечение соединительного провода 0,25 мм² (AWG 24)
 Степень защиты IP68 / IP 67 экранированный
 Верхняя предельная температура + 85 °C
 Нижняя предельная температура – 25 °C


23.6 Видеокабель VK 02 / F

Артикул № 103 1446

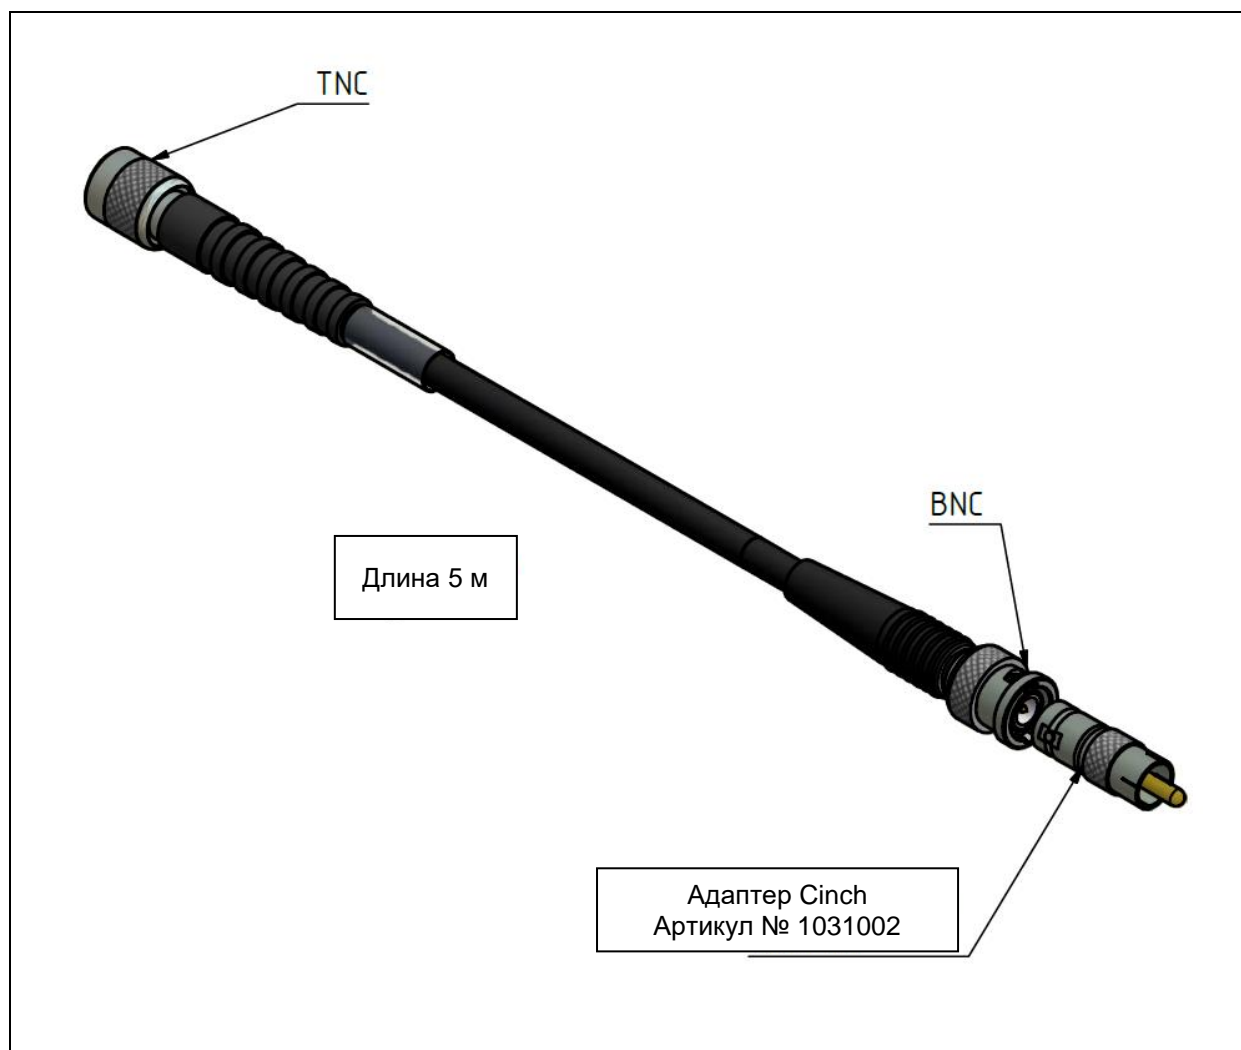


24 Монтажные комплекты

24.1 Монтажный комплект PA 83-002

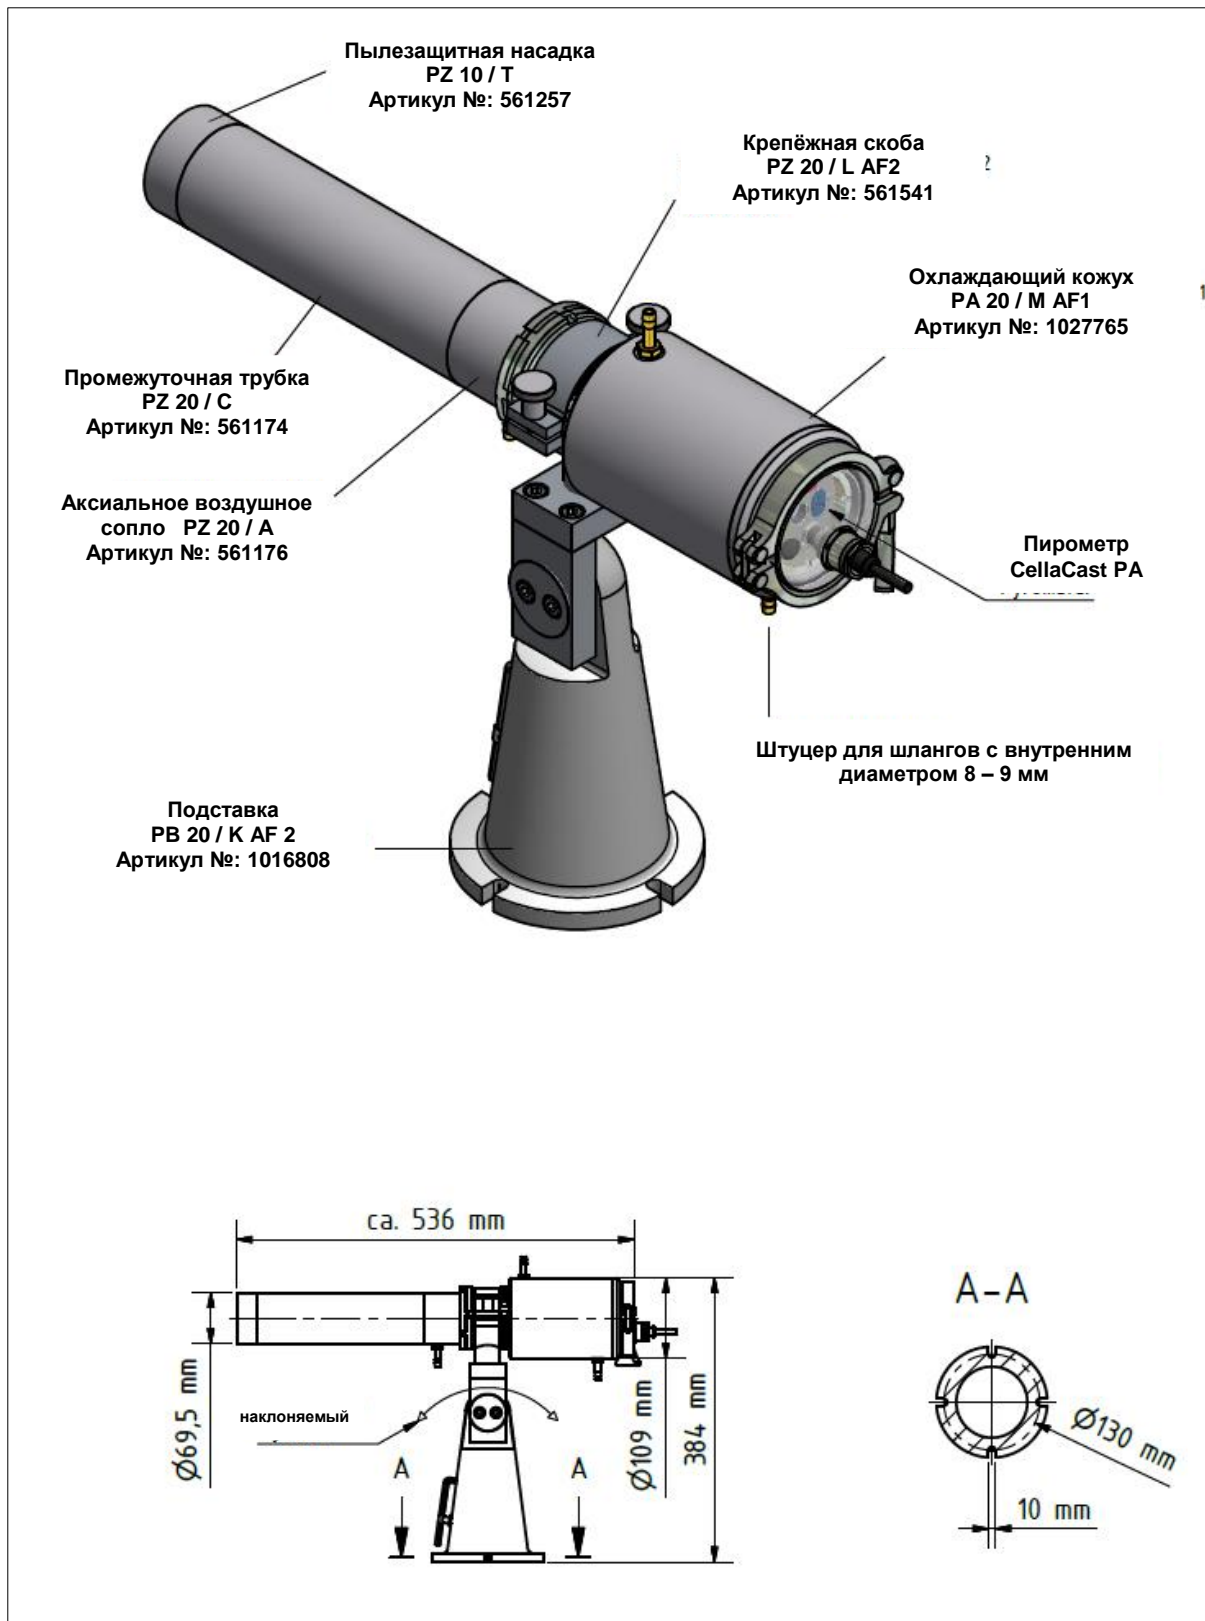

24.2 Монтажный комплект PA 83-003

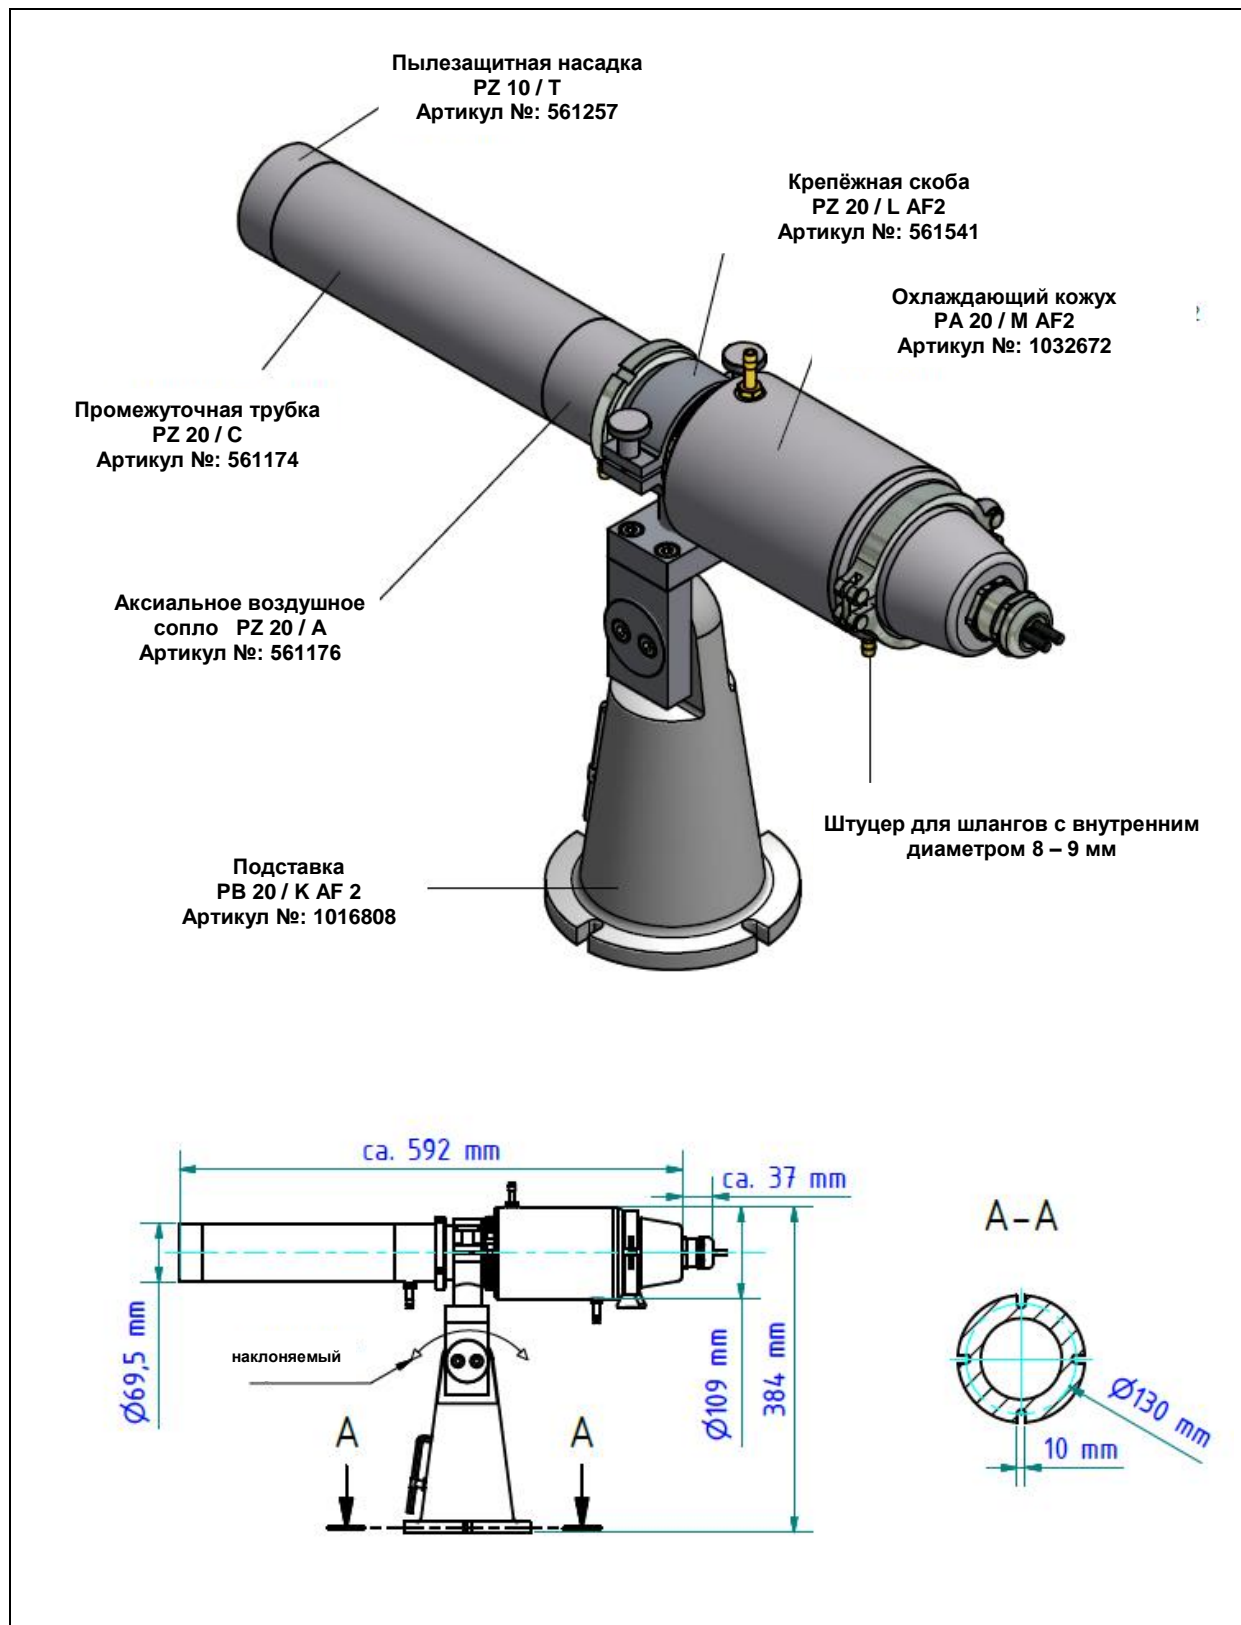

25 Глоссарий

Функция Autoprint	После подключения напряжения питания начинается автоматическая выдача рассчитанных измерительных значений через серийный интерфейс.
Print cycle time	Описывает оперативное время, по прохождении которого измеренные значения поступают на серийный интерфейс.
Показатель визирования	Показатель визирования описывает отношение расстояния между пирометром и объектом измерения к диаметру измерительного пятна.
Память двойных максимальных значений	Кратковременные температурные пики держатся на протяжении настроенного времени удержания измеренного значения.
Коэффициент излучения	Коэффициент излучения (или степень черноты) характеризует свойства поверхности объекта, температуру которого измеряет направленный на него пирометр. Этот коэффициент определяется как отношение энергии, излучаемой данной поверхностью при определённой температуре, к энергии излучения абсолютно чёрного тела при той же температуре. Коэффициент излучения может принимать значения от 0,1 до приближенного к 1 (или 10 % до 100 %). Ошибочный (или неточный) выбор коэффициента излучения - основной источник погрешности для всех пирометрических методов измерения температуры. Коэффициент излучения настраивается на приборе.
Двухспектральный пирометр / пирометр спектрального соотношения.	Двухспектральный пирометр воспринимает инфракрасное излучение объекта посредством двойного фотодиода одновременно и на одном и том же месте при наличии двух различных волн. Из соотношения двух значений интенсивности излучения вычисляется температура.
Односпектральный пирометр	Пирометр воспринимает инфракрасное излучение объекта при наличии одной центральной волны, интенсивность которой позволяет вычислить температуру.

26 Транспортировка, упаковка и утилизация

26.1 Доставка / Осмотр

При получении прибора необходимо проверить его комплектацию согласно сертификату, а также наличие повреждений при транспортировке.

При обнаружении видимых повреждений поставка не принимается или принимается с условием. В товарно - транспортно накладных следует отметить степень повреждения и предъявить рекламацию. Скрытые дефекты необходимо reklamировать сразу после их обнаружения, поскольку требования о возмещении ущерба могут быть поданы только в срок, предусмотренный для предъявления рекламаций.

26.2 Упаковка

Для упаковки используются только экологически чистые упаковочные материалы, соответствующие требованиям утилизации и, следовательно, подлежащие вторичной переработке.

Упаковка подлежит сохранению или утилизации с соблюдением мер безопасности для окружающей среды.

26.3 Утилизация старых приборов

Утилизированные электрические и электронные приборы часто содержат ценные материалы.

Эти устройства могут быть возвращены производителю для утилизации или должны быть утилизированы пользователем надлежащим образом.

За утилизацию приборов пользователем производитель ответственности не несет.



27 Информация о лицензиях

Portions of avr-libc are Copyright (c) 1999-2007

Keith Gudger,
Bjoern Haase,
Steinar Haugen,
Peter Jansen,
Reinhard Jessich,
Magnus Johansson,
Artur Lipowski,
Marek Michalkiewicz,
Colin O'Flynn,
Bob Paddock,
Reiner Patommel,
Michael Rickman,
Theodore A. Roth,
Juergen Schilling,
Philip Soeberg,
Anatoly Sokolov,
Nils Kristian Strom,
Michael Stumpf,
Stefan Swanepoel,
Eric B. Weddington,
Joerg Wunsch,
Dmitry Xmelkov,
The Regents of the University of California.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the copyright holders nor the names of contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

28 Стандартная конфигурация PA 83

28.1 Регистрация результатов измерений Канал соотношения коэффициентов излучения [Q] (Кодовая страница: с 00 i)

Параметр	Функция	Стандартная конфигурация	Собственная настройка
EP5.9	Соотношение коэффициентов излучения (Q)	100%	
ch.r.9	Режим функции Q-check	Min	
ch.r.-	Относительный миним. лимит	10%	
ch.r.-	Относительный максим. лимит	--	
ch.A.t	Абсолютный минимум температуры	Начало диапазона	
ch.A.i	Абсолютный минимум спектральной излучательной способности	50%	
L.in.9	Дополнительная линеаризация в произвольно конфигурируемой пользователем таблице	Off / Выкл.	
L.H.I	Точка отсчёта x 1..10	--	
L.Y.I	Точка отсчёта y 1..10	--	
F.L.9	Функция сглаживания	On / Вкл.	
F.L.t	Время фильтрации	0,5 сек	
PEP.9	Память предельных значений	Red d Функция ART	
PEP.t	Время удержания двойных макс. значений	--	
F.L.P	Функция сглаживания для памяти предельных значений*	--	
F.L.t	Время фильтрации	--	
CLr.P	Внешний вход для стирания памяти предельных значений*	--	
tdEL	Мёртвое время	1 с	
tdEt	Время измерения	0 с	
td.S	Время выбега	0 с	
tdUt	Timeout	2 мин	

L 1.1	Порог 1	1100 °C	
L 1.2	Порог 2	1200 °C	
F - P _r	Оценка среднего значения	90 %	
tSP ₋	Порог достоверности Нижний предел	50 К	
tSP ₊	Порог достоверности Верхний предел	150 К	
A _{no}	Отображение процесса измерений на выходах	t = 0	
chL2	Set Li2 check on tAct	Off / Выкл.	
A _r St	Автосброс	Off / Выкл.	
SA _o E	Сохранение		
ES _c	Отмена (Escape)	--	

* Параметры, доступные при памяти мин. / макс. или двойных максимальных значений

28.2 Регистрация результатов измерений Спектральный канал 1 и 2 (Кодовая страница: с 002 и с 003)

Параметр	Функция	Стандартная конфигурация	Собственная настройка
EPS ₁	Коэффициент излучения L1	99,6%*	
EAU ₁	Коэффициент трансмиссии L1	100 %	
BA _c 1	Компенс. фон	Off / Выкл.	
BA _c t	Фоновая температура	Off / Выкл.	
BA _c !	Влияние фона	--	
L _{in} 1	Дополнительная линеаризация в произвольно конфигурируемой пользователем таблице	Off / Выкл.	
L _x 1	Точка отсчёта x 1..10	--	
L _y 1	Точка отсчёта y 1..10	--	
F ₁ L1	Функция сглаживания	Off / Выкл.	
F ₁ Lt	Время фильтрации	0,1 сек.	
PEP ₁	Память предельных значений	Off / Выкл.	
PEPt	Время удержания двойных макс. значений	--	
F ₁ L _n	Функция сглаживания для памяти предельных значений*	--	
F ₁ L _t	Время фильтрации	--	
CL _r L	Внешний вход для стирания памяти предельных значений*	--	
t _d EL	Мёртвое время	--	

t_{Act}	Время измерения	--	
$t_{d.S}$	Время выбега	--	
t_{oUt}	Timeout	--	
$L_{.1}$	Порог 1	--	
$L_{.2}$	Порог 2	--	
$F - Pr$	Оценка среднего значения	--	
t_{SP-}	Порог достоверности Нижний предел	--	
t_{SP+}	Порог достоверности Верхний предел	--	
A_{no}	Отображение процесса измерений на выходах		
A_{rSt}	Автосброс	--	
SA_{oE}	Сохранение	--	
ESc	Отмена (Escape)	--	

* Параметры, доступные при памяти мин. / макс. или двойных максимальных значений

28.3 Конфигурация I/O ввод / вывод (Кодовая страница: $\text{с } \text{O } \text{I/O}$)

Параметр	Функция	Стандартная конфигурация	Собственная настройка
A_{o1S}	Ao1 Выбор источника	Канал соотношения [Q]	
$A_{o1.}$	Ao1 Калибровка Исходное значение	Начало диапазона измерений	
$A_{o1.}$	Ao1 Калибровка Окончательное значение	Конец диапазона измерений	
A_{o14}	Ao1 0/4..20мА	4 – 20 мА	
$A_{o2.}$	Аналоговый выход 2	Off / Выкл.	
A_{o2S}	Ao2 Выбор источника	--	
$A_{o2.}$	Ao2 Калибровка Исходное значение	--	
$A_{o2.}$	Ao2 Калибровка Окончательное значение	--	
A_{o24}	Ao2 0/4..20мА	--	
$do1.$	Переключающий выход 1	On / Вкл.	
$do1S$	Do1 Выбор источника	Сигнал статуса готовности	
$do1F$	Do1 Логическая функция	Level / сигнал	
$do1t$	Do1 Порог переключения	--	
$do1h$	Do1 Гистерезис	--	

	переключения		
do 1.	Do1 Начало диапазона	--	
do 1.	Do1 Конец диапазона	--	
do 1L	Do1 Время задержки	0,00 сек.	
do 1H	Do1 Время удержания	0,00 сек.	
do 2.	Переключаемый выход 2	Off / Выкл.	
do 2S	Do2 Выбор источника	--	
do 2F	Do2 Логическая функция	--	
do 2t	Do2 Порог переключения	--	
do 2h	Do2 Гистерезис переключения	--	
do 2.	Do2 Начало диапазона	--	
do 2.	Do2 Конец диапазона	--	
do 2L	Do2 Время задержки	--	
do 2H	Do2 Время удержания	--	
A .Fn	Функция Аналоговый вход	--	
A .U 1	Ain Калибровка Исходное значение	--	
A .U 2	Ain Калибровка Исходное значение	--	
A .u 1	Ain Калибровка	--	
A .u 2	Ain Калибровка	--	
SAUE	Сохранение		
ESC	Отмена (Escape)		

28.4 Общие функции (Кодовая страница: с 0 ! !)

Параметр	Функция	Стандартная конфигурация	Собственная настройка
L E d B	Функция зелёного светодиода для индикации статуса	d o !	
P ! L o .	Включение целеуказателя*	i n t	
P ! L t	Макс. время действия целеуказателя*	2 мин	
t E r P .	Терминал Присвоение	USB	
A S t r .	Автоматическая выдача измерит. значений	Off / Выкл.	
A c y c .	Цикл автоматической выдачи измерит. значений	0,1 сек	
A d d r .	Адрес прибора	001	
d ! S P .	Дисплей **	active	
U n ! t	Единица температуры	Градусы по Цельсию	
c o u L	Изображение температуры**	On / Вкл.	
c t b c	ТВС Регулировка экспозиции**	„o n“ Измерение яркости пятна	
c c o L	Баланс белого цвета**	„d a y L .“ Дневной свет	
S R u E	Сохранение		
E S c	Отмена (Escape)		

* Только у пирометров с лазерным целеуказателем

** Только у приборов с видеокамерой

29 Стандартная конфигурация PA 80 / 81

29.1 Регистрация результатов измерений Канал соотношения коэффициентов излучения [Q] (Кодовая страница: с 00 i)

Параметр	Функция	Стандартная конфигурация	Собственная настройка
EP5.9	Соотношение коэффициентов излучения (Q)	100%	
ch.r.9	Режим функции Q-check	Off / Мин	
ch.r.-	Относительный миним. лимит	5 %	
ch.r.-	Относительный максим. лимит	--	
ch.A.t	Абсолютный минимум температуры	Начало диапазона	
ch.A.i	Абсолютный минимум спектральной излучательной способности	50%	
L.in.9	Дополнительная линеаризация в произвольно конфигурируемой пользователем таблице	Off / Выкл.	
L.H.I	Точка отсчёта x 1..10	--	
L.Y.I	Точка отсчёта y 1..10	--	
F.L.9	Функция сглаживания	On / Вкл.	
F.L.t	Время фильтрации	0,5 сек	
PEP.9	Память предельных значений	ART / Функция ART	
PEP.t	Время удержания двойных макс. значений	--	
F.L.P	Функция сглаживания для памяти предельных значений*	--	
F.L.t	Время фильтрации	--	
CLr.P	Внешний вход для стирания памяти предельных значений*	--	
tdEL	Мёртвое время	1 с	
tdEt	Время измерения	0 с	
td.i.S	Время выбега	0 с	
tdOt	Timeout	2 мин	

L 1.1	Порог 1	1100 °C	
L 1.2	Порог 2	1200 °C	
F - P _r	Оценка среднего значения	75 %	
tSP ₋	Порог достоверности Нижний предел	50 К	
tSP ₊	Порог достоверности Верхний предел	150 К	
A _{no}	Отображение процесса измерений на выходах	t h L d	
c h L 2	Set Li2 check on tAct	Off / Выкл.	
A _r St	Автосброс	On / Вкл.	
SAR _E	Сохранение		
ESc	Отмена (Escape)	--	

* Параметры, доступные при памяти мин. / макс. или двойных максимальных значений

29.2 Регистрация результатов измерений Спектральный канал 1 и 2 (Кодовая страница: c 002 и c 003)

Параметр	Функция	Стандартная конфигурация	Собственная настройка
EPS 1	Коэффициент излучения L1	99,6%*	
EAU 1	Коэффициент трансмиссии L1	100 %	
BAc 1	Компенс. фон	Off / Выкл.	
BAc t	Фоновая температура	Off / Выкл.	
BAc !	Влияние фона	--	
L in 1	Дополнительная линеаризация в произвольно конфигурируемой пользователем таблице	Off / Выкл.	
L H 1	Точка отсчёта x 1..10	--	
L Y 1	Точка отсчёта y 1..10	--	
F i L 1	Функция сглаживания	Off / Выкл.	
F i L t	Время фильтрации	0,1 сек.	
PEP 1	Память предельных значений	Off / Выкл.	
PEP t	Время удержания двойных макс. значений	--	
F i L n	Функция сглаживания для памяти предельных значений*	--	
F i L t	Время фильтрации	--	
c L r n	Внешний вход для стирания памяти предельных значений*	--	
t d E L	Мёртвое время	--	

t_{Act}	Время измерения	--	
$t_{d.S}$	Время выбега	--	
t_{out}	Timeout	--	
$L_{.1}$	Порог 1	--	
$L_{.2}$	Порог 2	--	
$F - Pr$	Оценка среднего значения	--	
t_{SP-}	Порог достоверности Нижний предел	--	
t_{SP+}	Порог достоверности Верхний предел	--	
A_{no}	Отображение процесса измерений на выходах		
A_{rst}	Автосброс	--	
SA_{UE}	Сохранение	--	
ES_c	Отмена (Escape)	--	

* Параметры, доступные при памяти мин. / макс. или двойных максимальных значений

29.3 Конфигурация I/O ввод / вывод (Кодовая страница: $\text{с } \text{O } \text{IO}$)

Параметр	Функция	Стандартная конфигурация	Собственная настройка
$A_{o1.S}$	Ao1 Выбор источника	Канал соотношения [Q]	
$A_{o1.}$	Ao1 Калибровка Исходное значение	Начало диапазона измерений	
$A_{o1.}$	Ao1 Калибровка Окончательное значение	Конец диапазона измерений	
$A_{o1.4}$	Ao1 0/4..20мА	4 – 20 мА	
$A_{o2.}$	Аналоговый выход 2	Off / Выкл.	
$A_{o2.S}$	Ao2 Выбор источника	--	
$A_{o2.}$	Ao2 Калибровка Исходное значение	--	
$A_{o2.}$	Ao2 Калибровка Окончательное значение	--	
$A_{o2.4}$	Ao2 0/4..20мА	--	
$do1.$	Переключающий выход 1	On / Вкл.	
$do1.S$	Do1 Выбор источника	Сигнал статуса готовности	
$do1.F$	Do1 Логическая функция	Level / сигнал	
$do1.t$	Do1 Порог переключения	--	
$do1.h$	Do1 Гистерезис	--	

	переключения		
do 1.	Do1 Начало диапазона	--	
do 1.	Do1 Конец диапазона	--	
do 1L	Do1 Время задержки	0,00 сек.	
do 1H	Do1 Время удержания	0,00 сек.	
do 2.	Переключаемый выход 2	Off / Выкл.	
do 2S	Do2 Выбор источника	--	
do 2F	Do2 Логическая функция	--	
do 2t	Do2 Порог переключения	--	
do 2h	Do2 Гистерезис переключения	--	
do 2.	Do2 Начало диапазона	--	
do 2.	Do2 Конец диапазона	--	
do 2L	Do2 Время задержки	--	
do 2H	Do2 Время удержания	--	
A .Fn	Функция Аналоговый вход	--	
A .U 1	Ain Калибровка Исходное значение	--	
A .U 2	Ain Калибровка Исходное значение	--	
A .u 1	Ain Калибровка	--	
A .u 2	Ain Калибровка	--	
SAvE	Сохранение		
ESC	Отмена (Escape)		

29.4 Общие функции (Кодовая страница: c 0 ! !)

Параметр	Функция	Стандартная конфигурация	Собственная настройка
L E d B	Функция зелёного светодиода для индикации статуса	d o !	
P ! L o .	Включение целеуказателя*	i n t	
P ! L t	Макс. время действия целеуказателя*	2 мин	
t E r P .	Терминал Присвоение	USB	
A S t r .	Автоматическая выдача измерит. значений	Off / Выкл.	
A c y c .	Цикл автоматической выдачи измерит. значений	0,1 сек	
A d d r .	Адрес прибора	001	
d i s P .	Дисплей **	active	
U n i t	Единица температуры	Градусы по Цельсию	
c o u L	Изображение температуры**	On / Вкл.	
c t b c	ТВС Регулировка экспозиции**	„o n“ Измерение яркости пятна	
c c o L	Баланс белого цвета**	„d a y L .“ Дневной свет	
S R u E	Сохранение		
E S c	Отмена (Escape)		

* Только у пирометров с лазерным целеуказателем

** Только у приборов с видеокамерой

